


Charge scan (THR: 212, 1000 events)

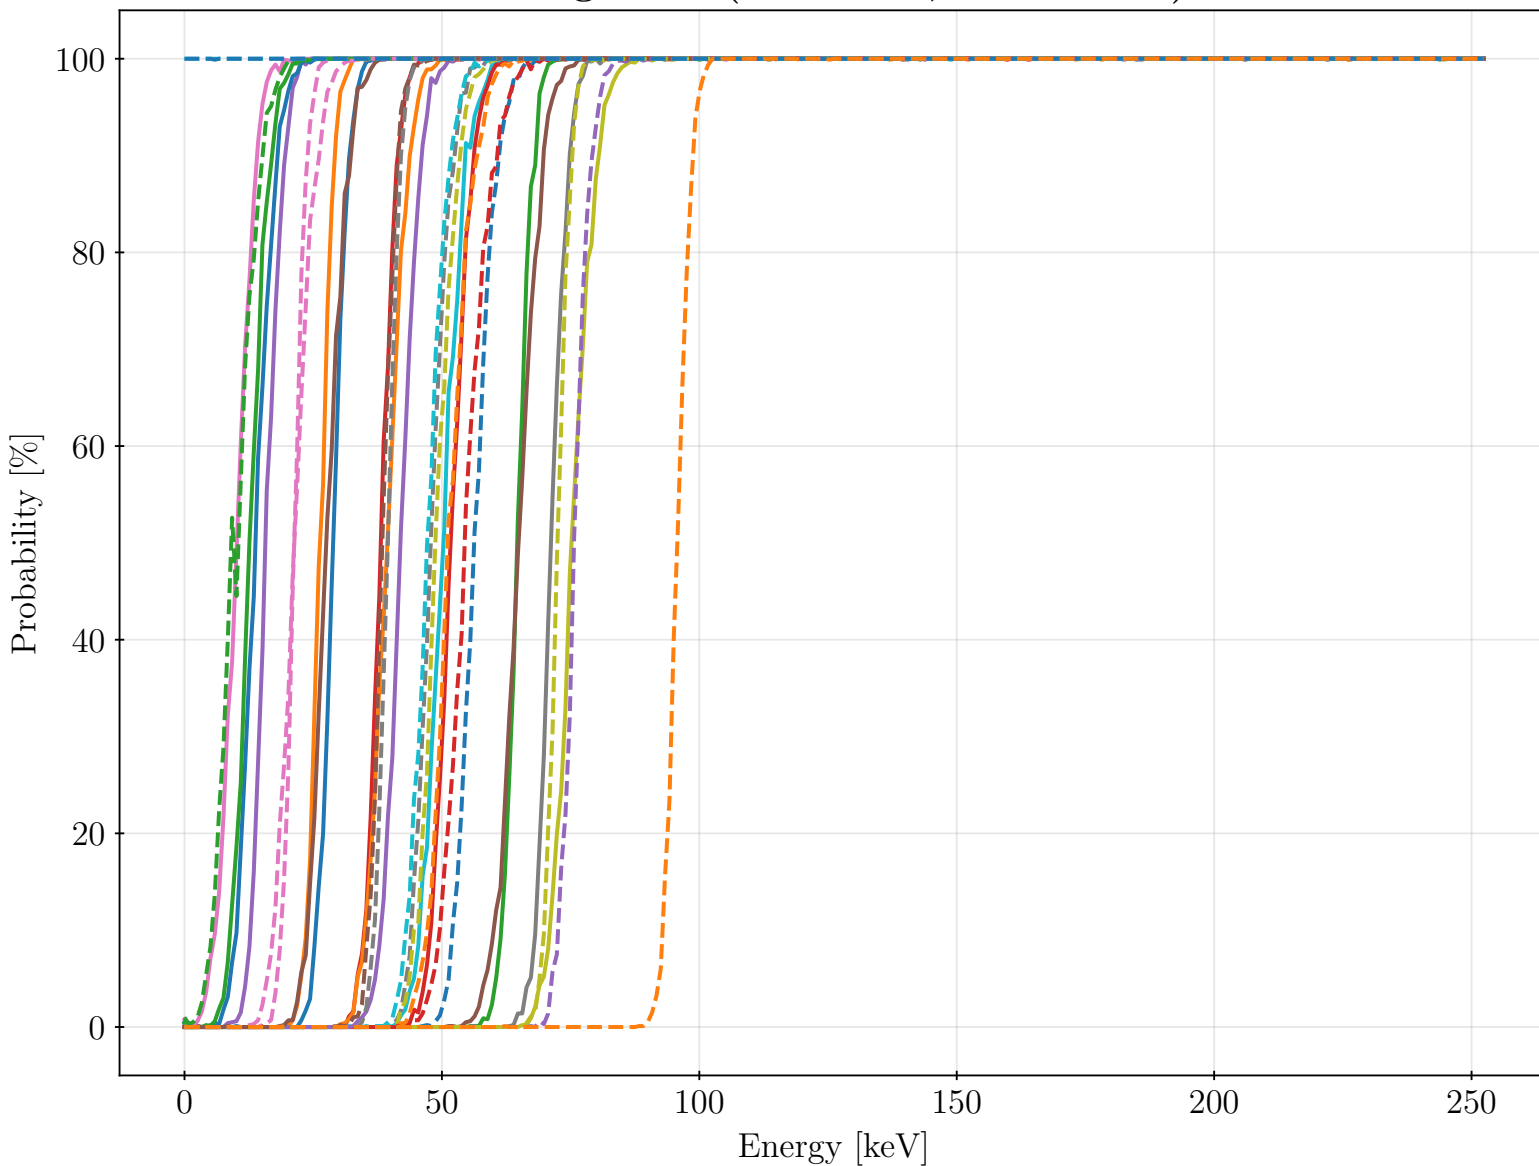

Channel			
0	THR: 28.87 keV ENC: 5.79 keV	16	THR: 21.4 keV ENC: 7.88 keV
1	THR: 26.36 keV ENC: 5.22 keV	17	THR: 47.93 keV ENC: 7.49 keV
2	THR: 64.68 keV ENC: 5.76 keV	18	THR: 48.98 keV ENC: 7.79 keV
3	THR: 38.15 keV ENC: 6.09 keV	19	THR: 47.26 keV ENC: 7.87 keV
4	THR: 15.92 keV ENC: 6.19 keV	20	THR: 56.4 keV ENC: 8.09 keV
5	THR: 64.97 keV ENC: 8.89 keV	21	THR: 51.53 keV ENC: 8.73 keV
6	THR: 10.1 keV ENC: 7.53 keV	22	THR: 9.93 keV ENC: 9.44 keV
7	THR: 71.29 keV ENC: 6.26 keV	23	THR: 54.62 keV ENC: 9.85 keV
8	THR: 75.43 keV ENC: 8.59 keV	24	THR: 75.78 keV ENC: 5.84 keV
9	THR: 50.21 keV ENC: 8.73 keV	25	THR: 38.52 keV ENC: 5.31 keV
10	THR: 13.83 keV ENC: 7.54 keV	26	THR: 21.32 keV ENC: 4.58 keV
11	THR: 39.35 keV ENC: 8.02 keV	27	THR: 39.46 keV ENC: 4.9 keV
12	THR: 12.76 keV ENC: 7.1 keV	28	THR: 72.48 keV ENC: 5.0 keV
13	THR: 51.83 keV ENC: 7.86 keV	29	THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
14	THR: 42.05 keV ENC: 7.28 keV	30	THR: -196.09 keV ENC: 121.96 keV
15	THR: 27.72 keV ENC: 7.72 keV	31	THR: 95.75 keV ENC: 5.39 keV