


Charge scan (THR: 220, 1000 events)

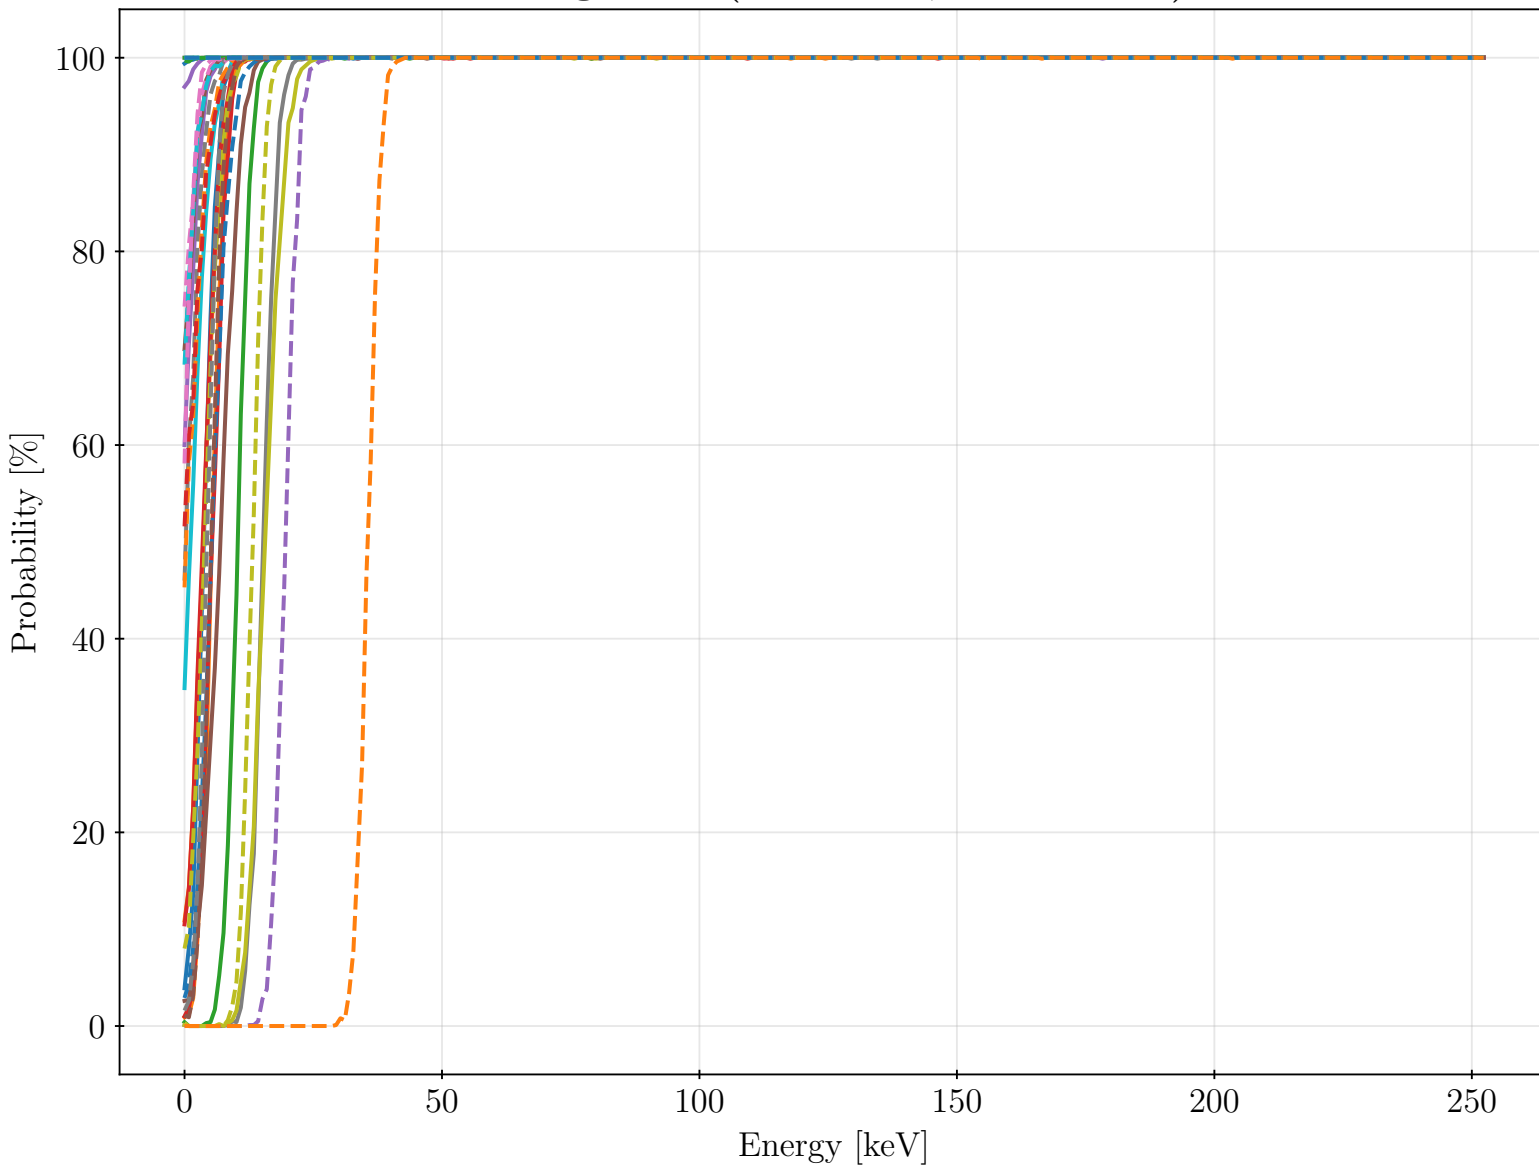

Channel

0 THR: 3.77 keV ENC: 4.89 keV	16 THR: -2.05 keV ENC: 7.71 keV
1 THR: 5.34 keV ENC: 4.77 keV	17 THR: 0.25 keV ENC: 6.46 keV
2 THR: 10.3 keV ENC: 4.95 keV	18 THR: 3.92 keV ENC: 6.1 keV
3 THR: 5.41 keV ENC: 5.44 keV	19 THR: -1.37 keV ENC: 6.9 keV
4 THR: -7.54 keV ENC: 9.57 keV	20 THR: 5.34 keV ENC: 6.46 keV
5 THR: 6.85 keV ENC: 7.63 keV	21 THR: 0.37 keV ENC: 7.72 keV
6 THR: -82.74 keV ENC: 54.13 keV	22 THR: -13.69 keV ENC: 11.98 keV
7 THR: 15.3 keV ENC: 5.21 keV	23 THR: -0.1 keV ENC: 9.14 keV
8 THR: 15.71 keV ENC: 6.98 keV	24 THR: 19.56 keV ENC: 5.09 keV
9 THR: 1.16 keV ENC: 7.23 keV	25 THR: 5.21 keV ENC: 4.66 keV
10 THR: -9.6 keV ENC: 8.97 keV	26 THR: -0.39 keV ENC: 4.35 keV
11 THR: 3.65 keV ENC: 6.63 keV	27 THR: 4.39 keV ENC: 4.19 keV
12 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV	28 THR: 13.22 keV ENC: 4.61 keV
13 THR: 3.55 keV ENC: 6.26 keV	29 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
14 THR: -0.69 keV ENC: 6.76 keV	30 THR: -65.61 keV ENC: 23.77 keV
15 THR: -1.49 keV ENC: 7.32 keV	31 THR: 35.62 keV ENC: 4.72 keV