


Charge scan (THR: 211, 1000 events, parasitic injection removed)

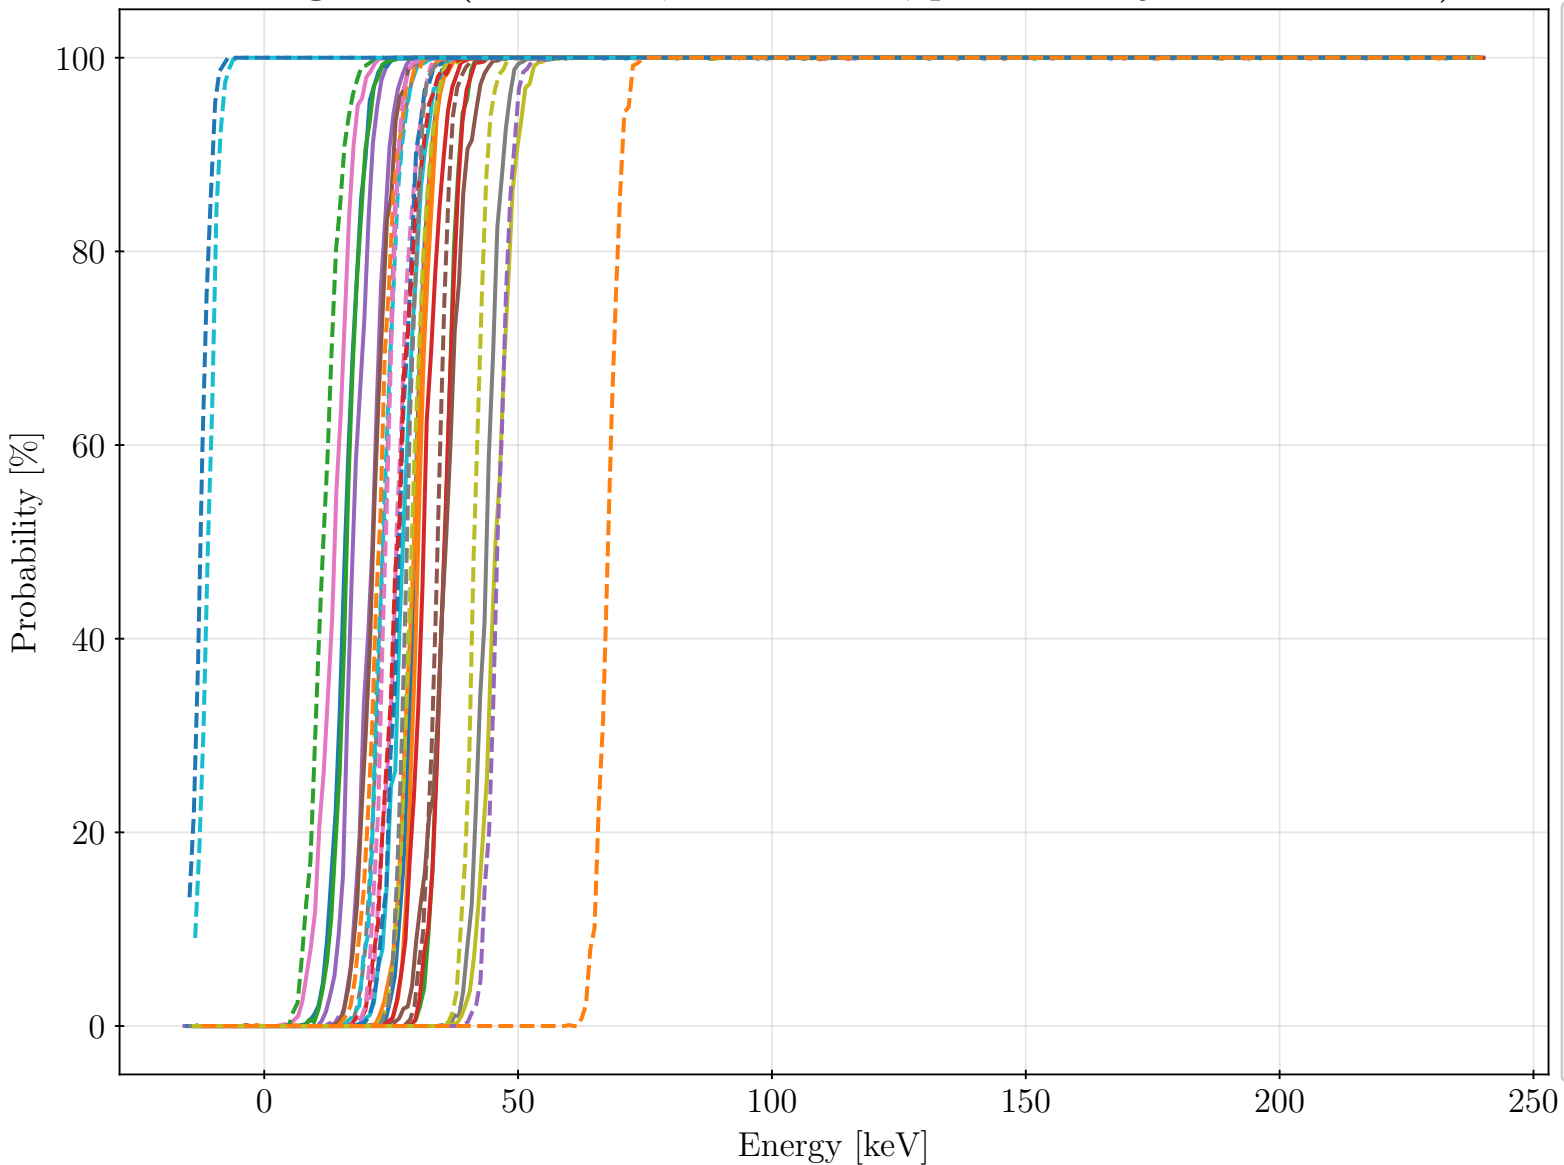

Channel			
0	THR: 29.62 keV ENC: 5.49 keV	16	THR: 26.08 keV ENC: 6.98 keV
1	THR: 30.39 keV ENC: 5.34 keV	17	THR: 23.49 keV ENC: 6.07 keV
2	THR: 35.47 keV ENC: 5.58 keV	18	THR: 29.16 keV ENC: 6.13 keV
3	THR: 35.5 keV ENC: 5.81 keV	19	THR: 23.45 keV ENC: 6.25 keV
4	THR: 17.77 keV ENC: 6.25 keV	20	THR: 26.64 keV ENC: 6.33 keV
5	THR: 35.63 keV ENC: 8.68 keV	21	THR: 22.56 keV ENC: 6.55 keV
6	THR: 13.81 keV ENC: 7.48 keV	22	THR: 11.72 keV ENC: 7.04 keV
7	THR: 43.73 keV ENC: 6.05 keV	23	THR: 26.31 keV ENC: 8.16 keV
8	THR: 45.73 keV ENC: 7.23 keV	24	THR: 46.07 keV ENC: 5.35 keV
9	THR: 27.43 keV ENC: 7.41 keV	25	THR: 34.1 keV ENC: 4.97 keV
10	THR: 16.07 keV ENC: 6.54 keV	26	THR: 23.9 keV ENC: 4.74 keV
11	THR: 29.42 keV ENC: 6.7 keV	27	THR: 28.17 keV ENC: 4.71 keV
12	THR: 16.35 keV ENC: 6.16 keV	28	THR: 41.45 keV ENC: 4.74 keV
13	THR: 31.46 keV ENC: 6.66 keV	29	THR: -11.06 keV ENC: 4.28 keV
14	THR: 21.13 keV ENC: 6.52 keV	30	THR: -12.55 keV ENC: 4.19 keV
15	THR: 21.5 keV ENC: 6.84 keV	31	THR: 67.71 keV ENC: 5.23 keV