


CONTROL TH - Dureté de l'eau

Utilisation + interprétation rapide

Contrôle de la qualité de l'eau

FICHE VISUELLE SIMPLIFIÉE

Kit CONTROL - TH
Mesure de la dureté de l'eau

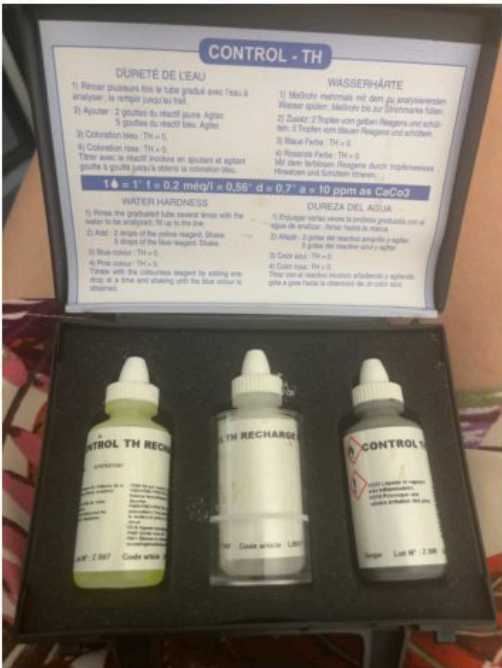

RÉSULTAT : le nombre de gouttes incolores nécessaires pour revenir au bleu
= le TH en °f.

1. COMMENT FAIRE ?



COULEUR OBTENUE ?		
BLEU	TH = 0 eau très douce	FIN DU TEST
ROSE	Ajouter le réactif INCOLORE goutte à goutte en agitant	Arrêter dès que la couleur redevient BLEUE

MÉMO EXPRESS : 2 jaunes + 5 bleues → si rose : incolore jusqu'au bleu → compter les gouttes.

2. COMMENT LIRE LE RÉSULTAT ?

Nombre de gouttes incolores	Résultat	Équivalence
0	0 °f	0 ppm CaCO ₃
1	1 °f	10 ppm CaCO ₃
5	5 °f	50 ppm CaCO ₃
10	10 °f	100 ppm CaCO ₃
20	20 °f	200 ppm CaCO ₃
30	30 °f	300 ppm CaCO ₃

3. INTERPRÉTATION SIMPLE

TH	Niveau	Ce que cela veut dire
0 à 7 °f	Très douce	Très peu de calcaire
8 à 15 °f	Douce	Peu d'entartrage
15 à 30 °f	Moyennement dure	Eau assez équilibrée
30 à 42 °f	Dure	Entartrage important
> 42 °f	Très dure	Eau très calcaire

EXEMPLE : si vous ajoutez **18 gouttes** de réactif incolore avant de retrouver le bleu, le résultat est **TH = 18 °f ≈ 180 ppm CaCO₃** → eau **moyennement dure**.

4. PRÉCAUTIONS

- Bien agiter après chaque ajout.
- Compter les gouttes avec précision.
- Lire le résultat au moment exact du retour au bleu.
- Rincer le tube entre deux échantillons.
- Certains réactifs sont irritants / inflammables : éviter peau et yeux.

Fiche simplifiée basée sur les informations visibles sur votre kit CONTROL - TH.