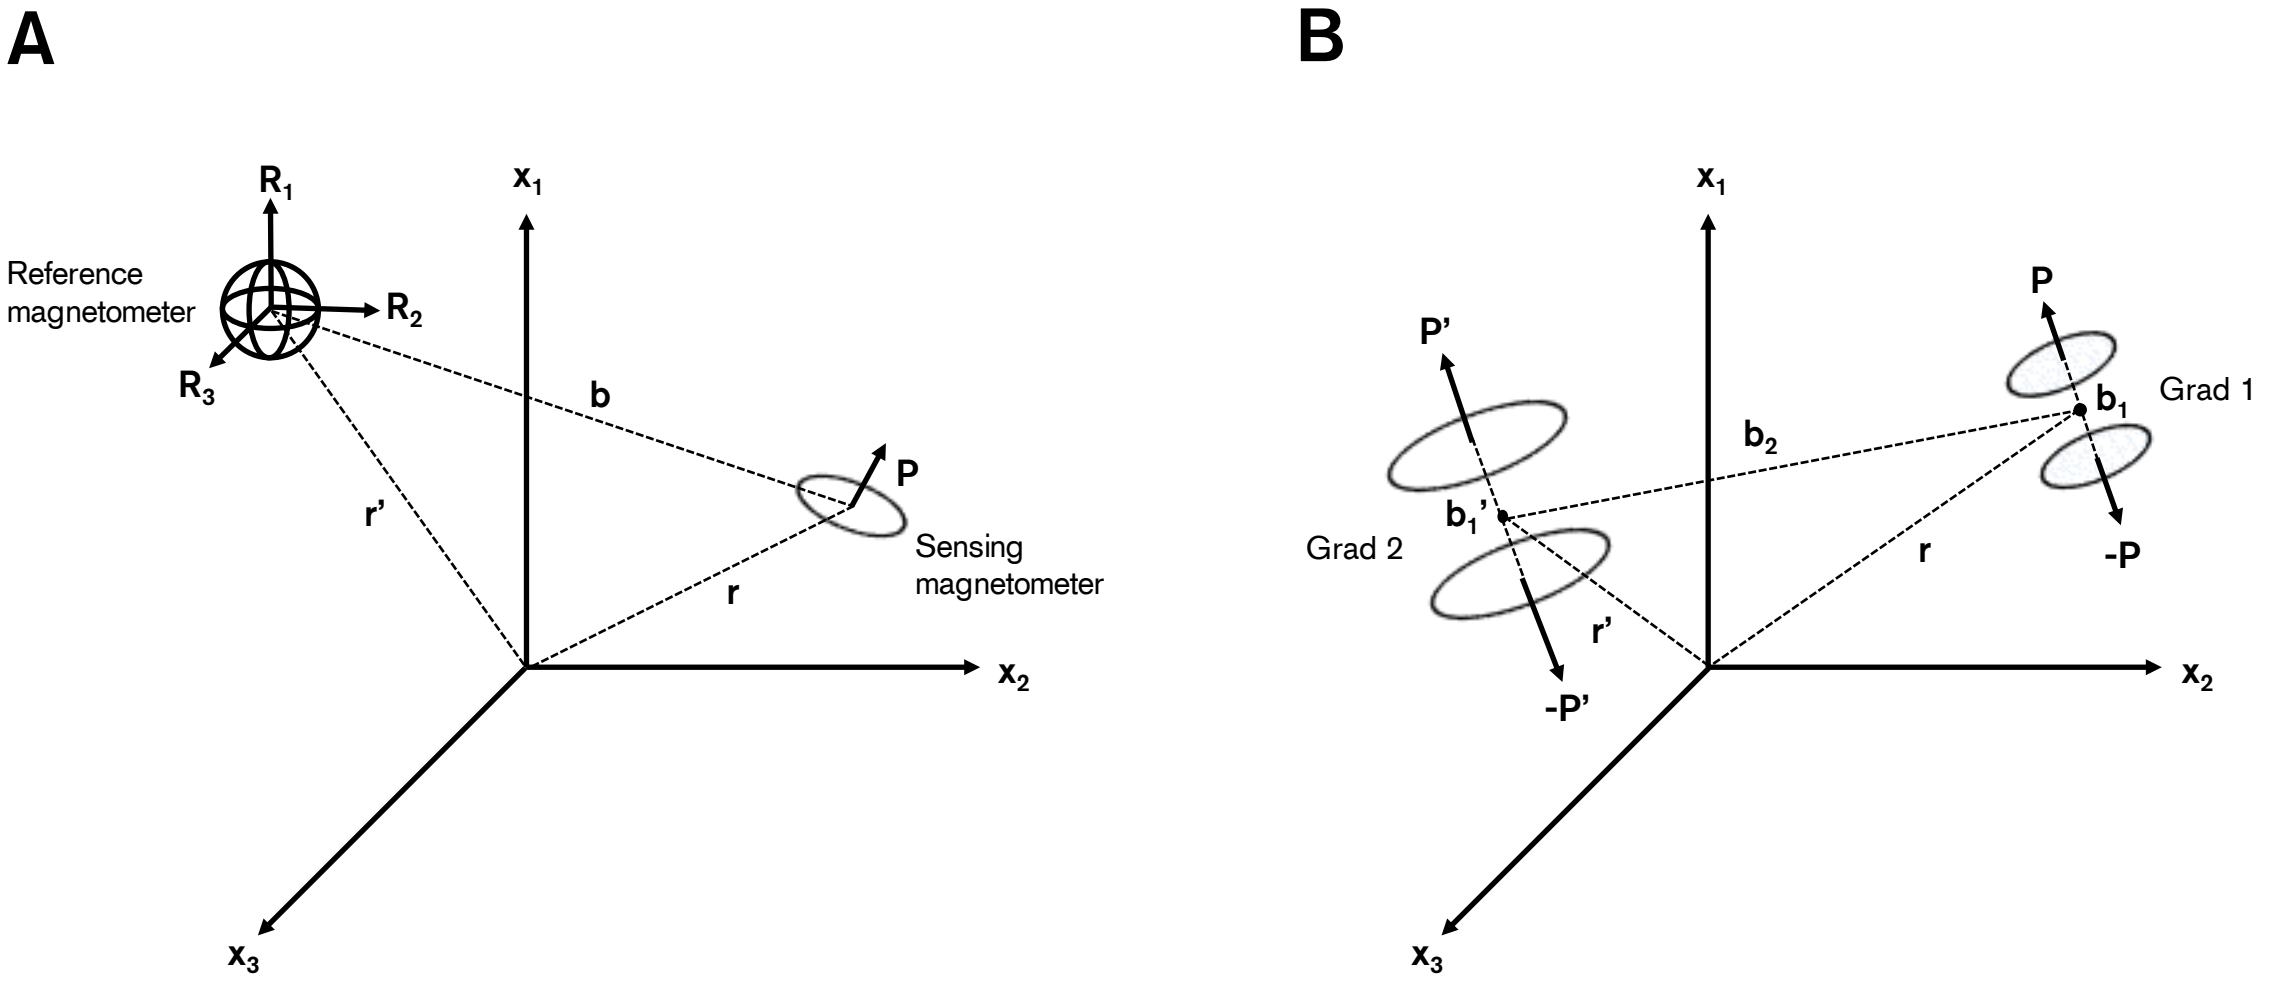
A
R1
x1
Reference
magnetometer
R2
R3
b
P
r'
r
Sensing
magnetometer
x2
x3
B
x1
P
P'
b1
Grad 1
b2
b1'
Grad 2
r
-P
r'
-P'
x2
x3