



200515100173

检测报告

TEST REPORT

报告编号: PDJC-2026BG-2201-1



普迪检测

PUDI Testing Center

项目名称: 呼和浩特宏钰医院生物安全柜、灭菌器性能验证

检测对象: 检验室设备编号为 JZ2021020633 的生物安全柜

检测类型: 现场检测

委托单位: 呼和浩特宏钰医院有限责任公司

内蒙古普迪检测技术有限公司



声 明

- 1.本报告页码、“检验检测专用章”、“公章”、“骑缝章”、“CMA 章”齐全时生效。
- 2.未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。
- 3.报告无审核、批准人签字无效。
- 4.检测报告仅对检测当时的现场环境负责。
- 5.对检测报告若有异议，可在收到报告 15 日内向检测单位提出，逾期则视为认可。

普迪检测
PUOI Testing Center

通讯资料

地 址	内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期 2 号写字楼 902 室
网 址	www.pudi-test.com
E-mail	puditest001@163.com
业务电话	16647183666
投诉电话	15848916138

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-2201-1

委托单位	呼和浩特宏钰医院有限责任公司		
项目地址	新城区赛马场北路与气象局西路交汇处		
联系方式	13847166169	检验日期	2026.05.25
样品名称	生物安全柜	生产厂家	苏州安泰空气技术有限公司
级别类型	II 级 A2	型号	BSC-1604 II 级 A2
设备编号	JZ2021020633	工作区尺寸	(1604*630*630)mm
设备状态	可正常启动	检测类型	现场检测
流入气流标称值: 0.55m/s		下降气流标称值: 0.35m/s	
所在房间	检验室		
检测环境	温度: 22.3℃ 相对湿度: 45.1%		
检测依据	《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011		
判定依据	《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T 199-2015 《生物安全柜》GB 41918-2022		
检测结论	本次检测的编号为 JZ2021020633 的生物安全柜所测参数符合判定依据中的相应规定。 签发日期: 2026 年 5 月 28 日 		

编制人: 党凯强

审核人: 宋程程

批准人: 刘国毅 刘国毅

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-2201-1

序号	检测参数	检测方法	检测仪器			
			设备名称	设备编号	不确定度	检/校证书编号
1	下降气流流速	GB 50346-2011 中 10.2.4	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	$U=0.15\text{m/s}$ ($k=2$)	JZSJLS2600016
2	风速不均匀度	GB 50346-2011 中 10.2.4	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	$U=0.15\text{m/s}$ ($k=2$)	JZSJLS2600016
3	流入气流流速	GB 50346-2011 中 10.2.6	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	$U=0.15\text{m/s}$ ($k=2$)	JZSJLS2600016
4	气流模式	GB 50346-2011 中 10.2.5	纯水烟雾发生器	PDJC/YQ-005	/	/
5	高效过滤器完整性 (漏过率)	GB 50346-2011 中 10.2.10	气溶胶光度计	PDJC/YQ-006	$U=12\%$ ($k=2$)	802793617
			气溶胶发生器	PDJC/YQ-040	/	/
6	工作区洁净度 (悬浮粒子数)	GB 50346-2011 中 10.2.7	激光尘埃粒子计数器	PDJC/YQ-004	粒径浓度 $U=14\%(k=2)$	DN250684200002
					粒径分布 $U=10\%(k=2)$	
7	噪声	GB 50346-2011 中 10.2.8	声级计	PDJC/YQ-002	检定合格	JDSJLS26000084
8	照度	GB 50346-2011 中 10.2.8	照度计	PDJC/YQ-032	$U=2.5\%$ ($k=2$)	JZSJJC26000364

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-2201-1

检测参数	单位	标准 (设计) 要求	检测结果	单项结论
下降气流流速	m/s	0.25 ~ 0.5	0.33	合格
风速不均匀度	%	≤20	13	合格
流入气流流速	m/s	≥0.5	0.62	合格
气流烟雾模式	/	安全柜工作区内的气流应向下, 应不产生 漩涡和向上气流且无死点	符合要求	合格
		气流应不从安全柜中逸出;	符合要求	
		安全柜前窗操作口整个周边气流应向内, 无向外逸出的气流;	符合要求	
		安全柜的前窗操作口流入气流应不进入工 作区	符合要求	
高效过滤器 完整性 (漏过率)	%	≤0.01	0.0002	合格


检测报告


报告编号: PDJC-2026BG-2201-1

检测项目	单位	标准 (设计) 要求		检测结果		单项结论	
工作区 洁净度级别 (悬浮粒子数)	pc/m³	悬浮粒子最大允许数	洁净度	悬浮粒子数		合格	
		≥0.5 μm: ≤3520	ISO-5	最大值	0		ISO-5
				95%置信度	0		
		≥5 μm: ≤29		最大值	0		
				95%置信度	0		
		噪声		dB(A)	≤67		65.6
照度	lx	平均照度 ≥650		1007		合格	
		每个照度实测值 ≥430		1 [#] (测点)	987	合格	
				2 [#] (测点)	1065		
				3 [#] (测点)	1097		
				4 [#] (测点)	1023		
				5 [#] (测点)	954		
				6 [#] (测点)	919		


报告编号: PDJC-2026BG-2201-1

附件一: 编号为 JZ2021020633 的生物安全柜外观及设备铭牌。

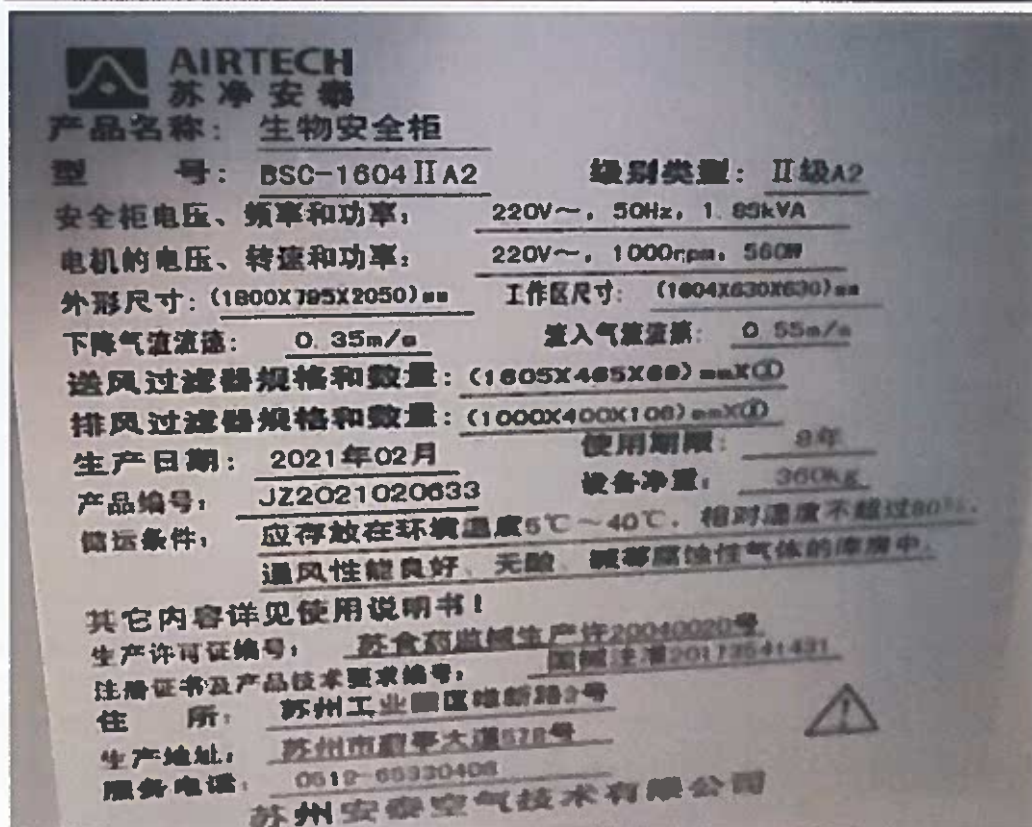


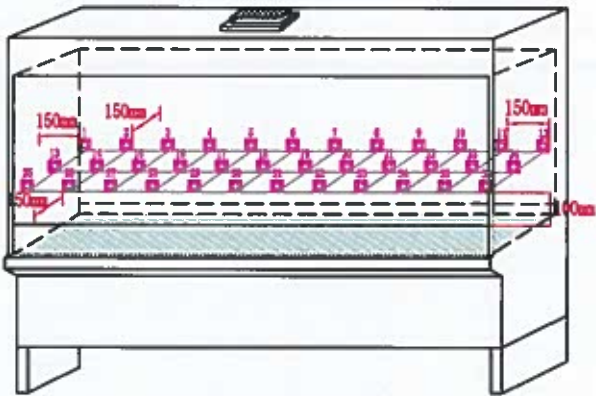


下降气流检测点位图

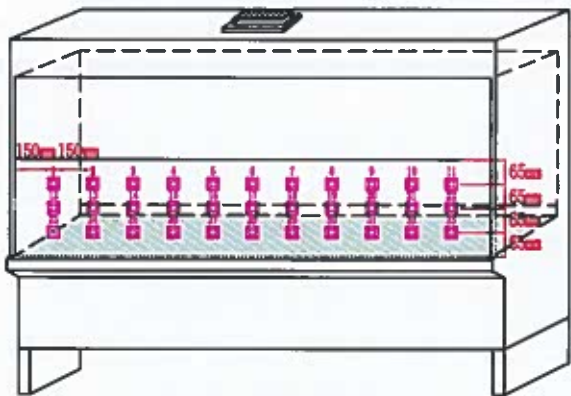

流入气流检测点位图

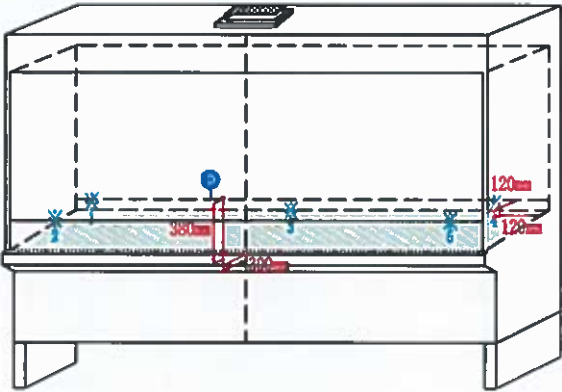

工作区悬浮粒子、噪声检测点位图

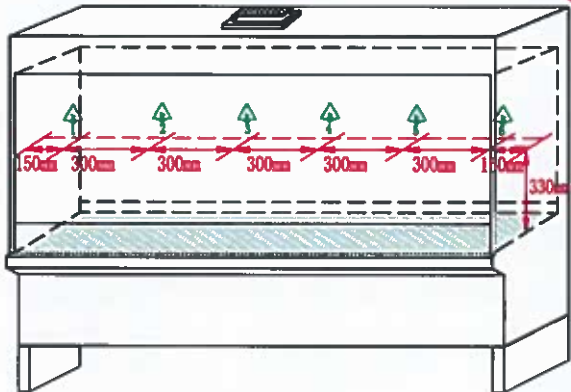

工作区照度检测点位图

内蒙古普迪检测技术有限公司
专用章

