



200515100173

检测报告

TEST REPORT

报告编号: PDJC-2026BG-1102



项目名称: 乌兰察布医专附属医院生物安全柜检测

检测对象: 检验科编号为 2401001 的生物安全柜

检测类型: 现场检测

委托单位: 乌兰察布医专附属医院

内蒙古普迪检测技术服务有限公司

声 明

- 1.本报告页码、“检验检测专用章”、“公章”、“骑缝章”、“CMA 章”齐全时生效。
- 2.未经本公司批准不得复制本报告，全文复制除外。
- 3.报告无审核、批准人签字无效。
- 4.检测报告仅对检测当时的现场环境负责。
- 5.对检测报告若有异议，可在收到报告 15 日内向检测单位提出，逾期则视为认可。

普迪检测
PUDI Testing Center

通讯资料

地 址	内蒙古呼和浩特通道北路天府花园四期 2 号写字楼 902 室
网 址	www.pudi-test.com
E-mail	puditest001@163.com
业务电话	16647183666
投诉电话	15848916138

检测 报 告

报告编号：PDJC-2026BG-1102

委托单位	乌兰察布医专附属医院		
项目地址	乌兰察布市集宁区工农北路 16 号		
联系方式	13484747959	检验日期	2026.03.11
样品名称	生物安全柜	生产厂家	北京东联哈尔仪器制造有限公司
级别类型	Ⅱ 级 A2	型号	BSC-1100 Ⅱ A2
受控编号	/	工作区尺寸	915mm*510mm*630mm
设备状态	可正常启动	检测类型	现场检测
流入气流标称值：0.56m/s		下降气流标称值：0.30m/s	
所在房间	检验科感染排查室		
检测环境	温度：27.3℃ 相对湿度：13.4%		
检测依据	《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011		
判定依据	《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T 199-2015 《生物安全柜》GB 41918-2022		
检测结论	本次检测的检验科编号为 2401001 的生物安全柜所测参数符合判定依据中的相应规定。 检验检测专用章 签发日期：2026年3月11日 检验检测专用章		

编制人：党凯强

审核人：宋祥霞

批准人：刘国毅

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1102

序号	检测参数	检测方法	检测仪器			
			设备名称	设备编号	不确定度	检/校证书编号
1	下降气流流速	GB 50346-2011 中 10.2.4	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	$U=0.15\text{m/s}$ ($k=2$)	JZSJLS2600016
2	风速不均匀度	GB 50346-2011 中 10.2.4	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	$U=0.15\text{m/s}$ ($k=2$)	JZSJLS2600016
3	流入气流流速	GB 50346-2011 中 10.2.6	多功能风速仪	PDJC/YQ-028	$U=0.15\text{m/s}$ ($k=2$)	JZSJLS2600016
4	气流模式	GB 50346-2011 中 10.2.5	纯水烟雾发生器	PDJC/YQ-005	/	/
5	高效过滤器完整性 (漏过率)	GB 50346-2011 中 10.2.10	气溶胶光度计	PDJC/YQ-006	$U=12\%$ ($k=2$)	802793617
			气溶胶发生器	PDJC/YQ-040	/	/
6	工作区洁净度 (悬浮粒子数)	GB 50346-2011 中 10.2.7	激光尘埃粒子计数器	PDJC/YQ-004	粒径浓度 $U=14\%(k=2)$	DN250684200002
					粒径分布 $U=10\%(k=2)$	
7	噪声	GB 50346-2011 中 10.2.8	声级计	PDJC/YQ-002	检定合格	JDSJLS26000084
8	照度	GB 50346-2011 中 10.2.8	照度计	PDJC/YQ-032	$U=2.5\%$ ($k=2$)	JZSJCJ26000364

检测报告

报告编号: PDJC-2026BG-1102

检测参数	单位	标准 (设计) 要求	检测结果	单项结论
下降气流流速	m/s	0.25 ~ 0.5	0.27	合格
风速不均匀度	%	≤20	19	合格
流入气流流速	m/s	≥0.5	0.58	合格
气流烟雾模式	/	安全柜工作区内的气流应向下, 应不产生旋涡和向上气流且无死点	符合要求	合格
		气流应不从安全柜中逸出;	符合要求	
		安全柜前窗操作口整个周边气流应向内, 无向外逸出的气流;	符合要求	
		安全柜的前窗操作口流入气流应不进入工作区	符合要求	
高效过滤器完整性 (漏过率)	%	≤0.01	0.0009	合格

检测报告

报告编号：PDJC-2026BG-1102


检测项目	单位	标准（设计）要求		检测结果		单项结论	
工作区 洁净度级别 (悬浮粒子数)	pc/m³	悬浮粒子最大允许数	洁净度	悬浮粒子数		合格	
		≥0.5 μm: ≤3520	ISO-5	最大值	141		ISO-5
				95%置信度	88		
		≥5 μm: ≤29		最大值	35		
				95%置信度	22		
噪声	dB(A)	≤67		66.3		合格	
照度	lx	平均照度≥650		893		合格	
		每个照度实测值≥430		1 [#] （测点）	782	合格	
				2 [#] （测点）	936		
				3 [#] （测点）	1014		
				4 [#] （测点）	937		
				5 [#] （测点）	838		
				6 [#] （测点）	853		

报告编号: PDJC-2026BG-1102


附件一: 检验科编号为 2401001 的生物安全柜外观




产品名称: 生物安全柜 产品型号/规格: BSC-1100 II A2
级别类型: II 级 A2 输入功率: 1850W (其中插座 1000W)
电源: AC220V 50Hz 电机转速: 1350r/min 电机功率: 700W
上过滤器型号: GKYS 上过滤器规格及数量: 295 mm×440 mm×90 mm×①
下过滤器型号: GKYS 下过滤器规格及数量: 910 mm×500 mm×35 mm×①
外形尺寸: 1080 mm×790 mm×2150mm
工作区尺寸: 915 mm×510 mm×630mm 净重: 265kg
下降气流流速: 0.30 m/s 流入气流流速: 0.56 m/s
生产日期: 2024 年 1 月 日 产品编号: Z401001: 2401001
产品技术要求编号: 国械注准 20183221750
生产许可证编号: 京药监械生产许 20040139 号
医疗器械注册证编号: 国械注准 20183221750
生产地址: 北京市昌平区马池口镇昌流路 (神牛环岛东侧)
注册地址: 北京市昌平区马池口镇昌流路 (神牛环岛东侧)
公司名称: 北京东联哈尔仪器制造有限公司
公司电话: 010-60767878 传真: 010-60755777
使用期限: 8 年 其他内容详见使用说明书

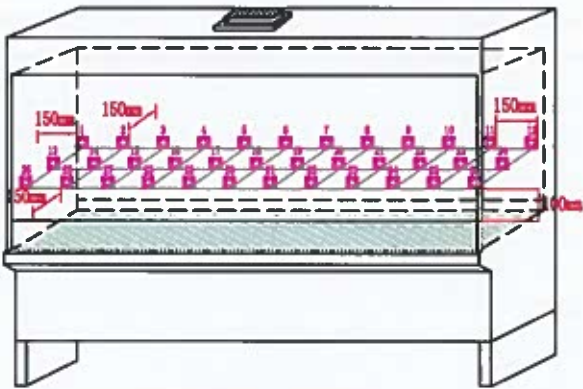


下降气流检测点位图

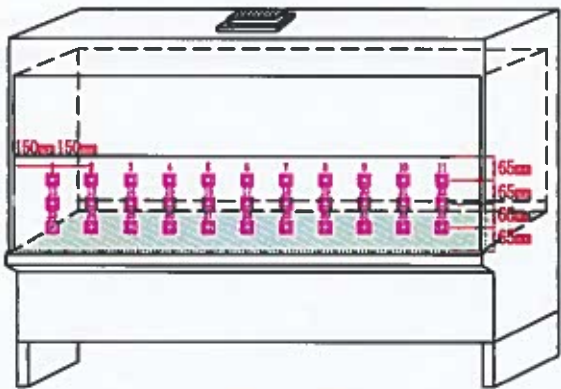

流入气流检测点位图

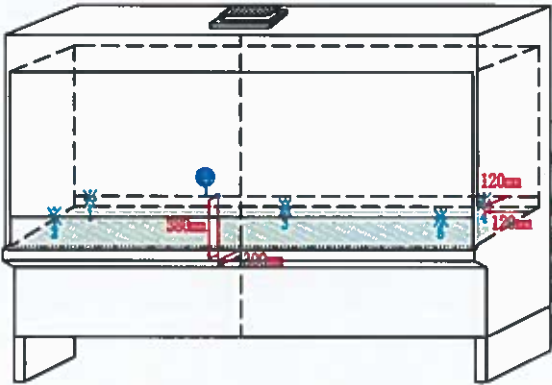

工作区悬浮粒子、噪声检测点位图

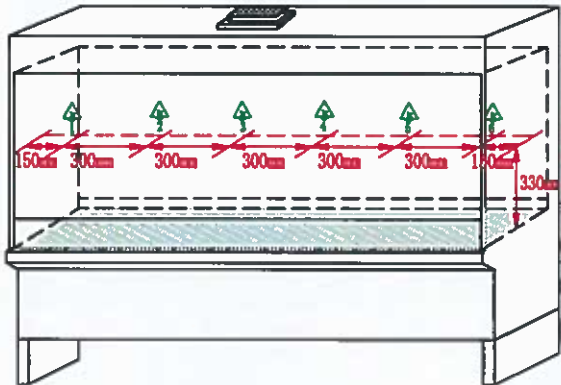

工作区照度检测点位图

 内蒙古普迪检测技术服务有限公司 Inner Mongolia Pudi Testing Technology Service Co., Ltd	图 例	 风速测点	 噪声测点	 温度/相对湿度测点	 沉降菌/浮游菌测点
		 悬浮粒子数测点	 静压差测点	 照度测点	 辐照强度测点