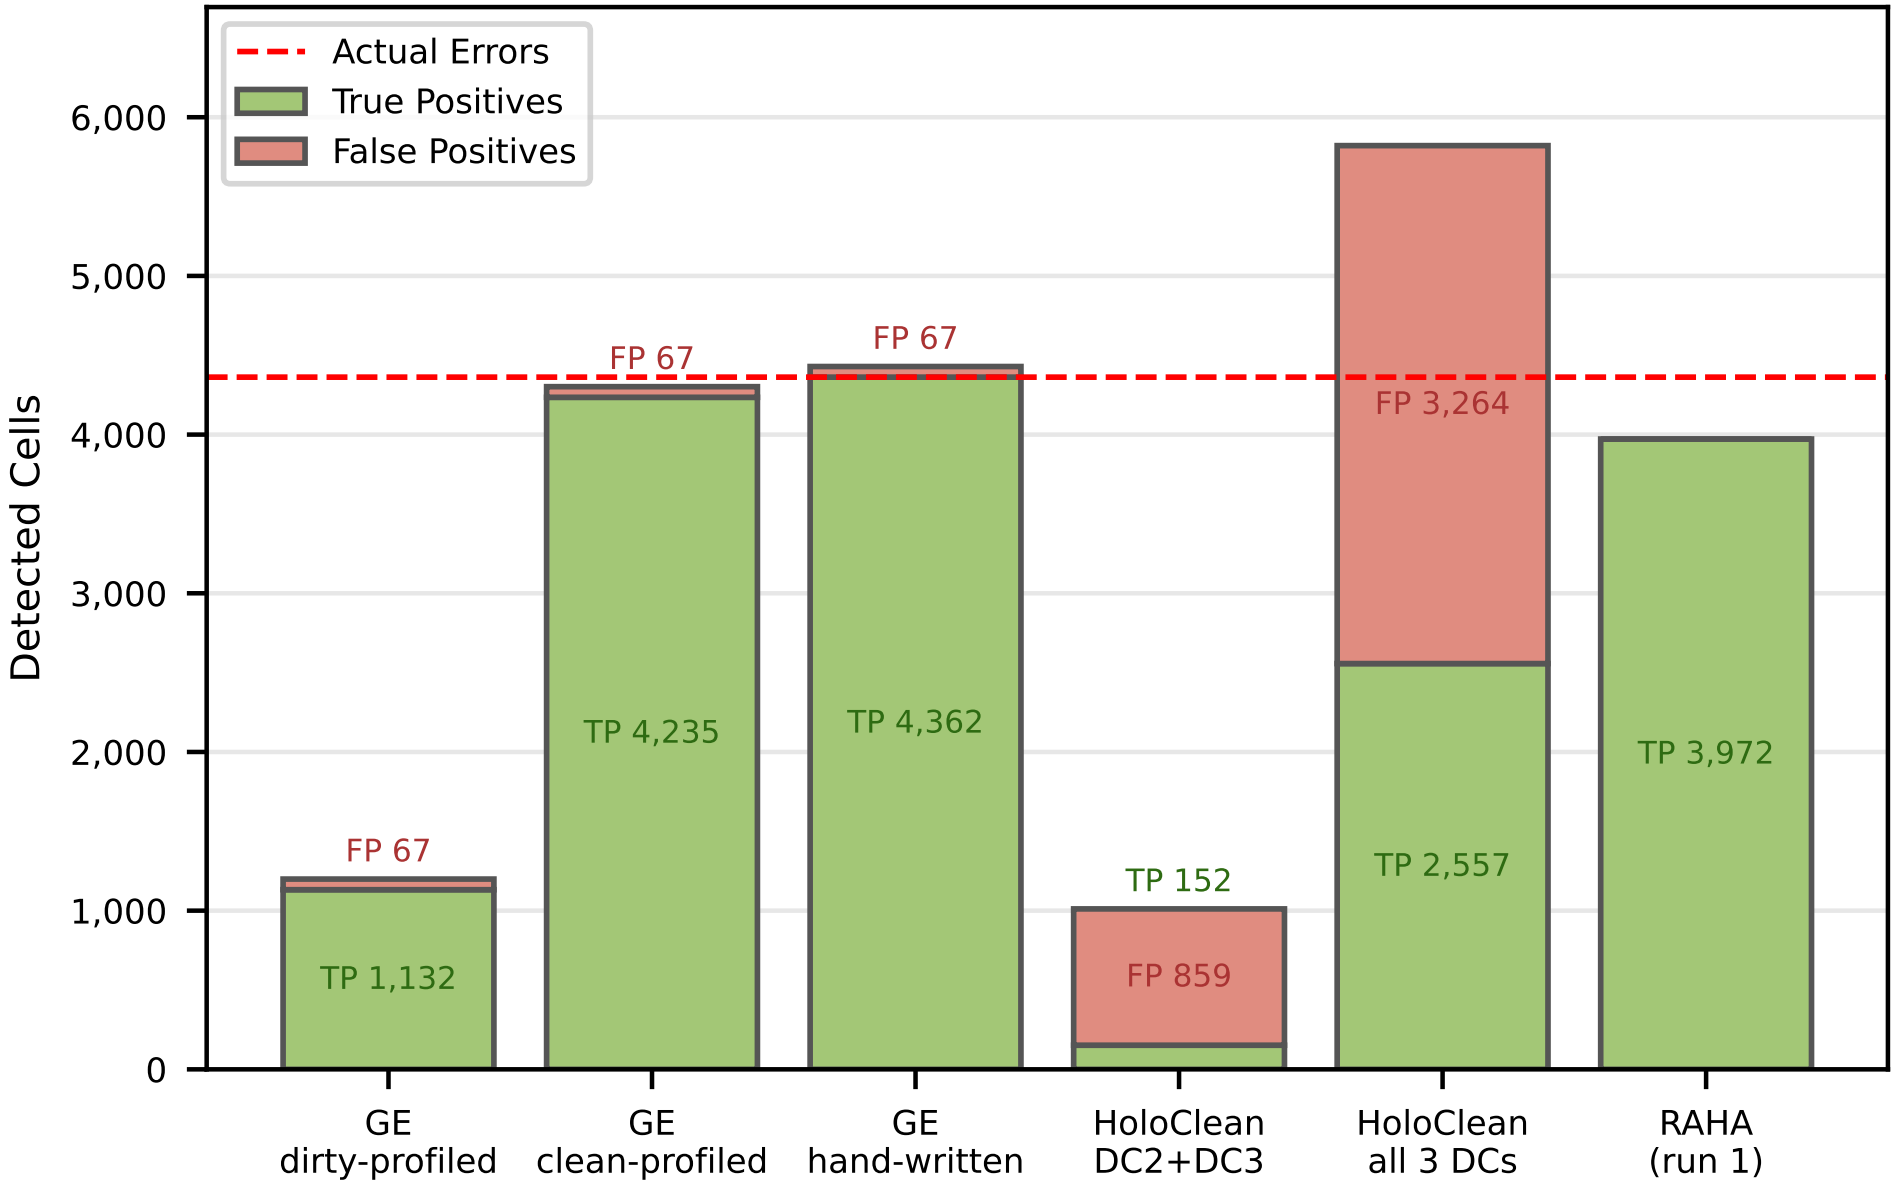
Actual Errors
True Positives
False Positives
Detected Cells
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
FP 67
TP 1,132
FP 67
TP 4,235
FP 67
TP 4,362
TP 152
FP 859
FP 3,264
TP 2,557
TP 3,972
GE
dirty-profiled
GE
clean-profiled
GE
hand-written
HoloClean
DC2+DC3
HoloClean
all 3 DCs
RAHA
(run 1)