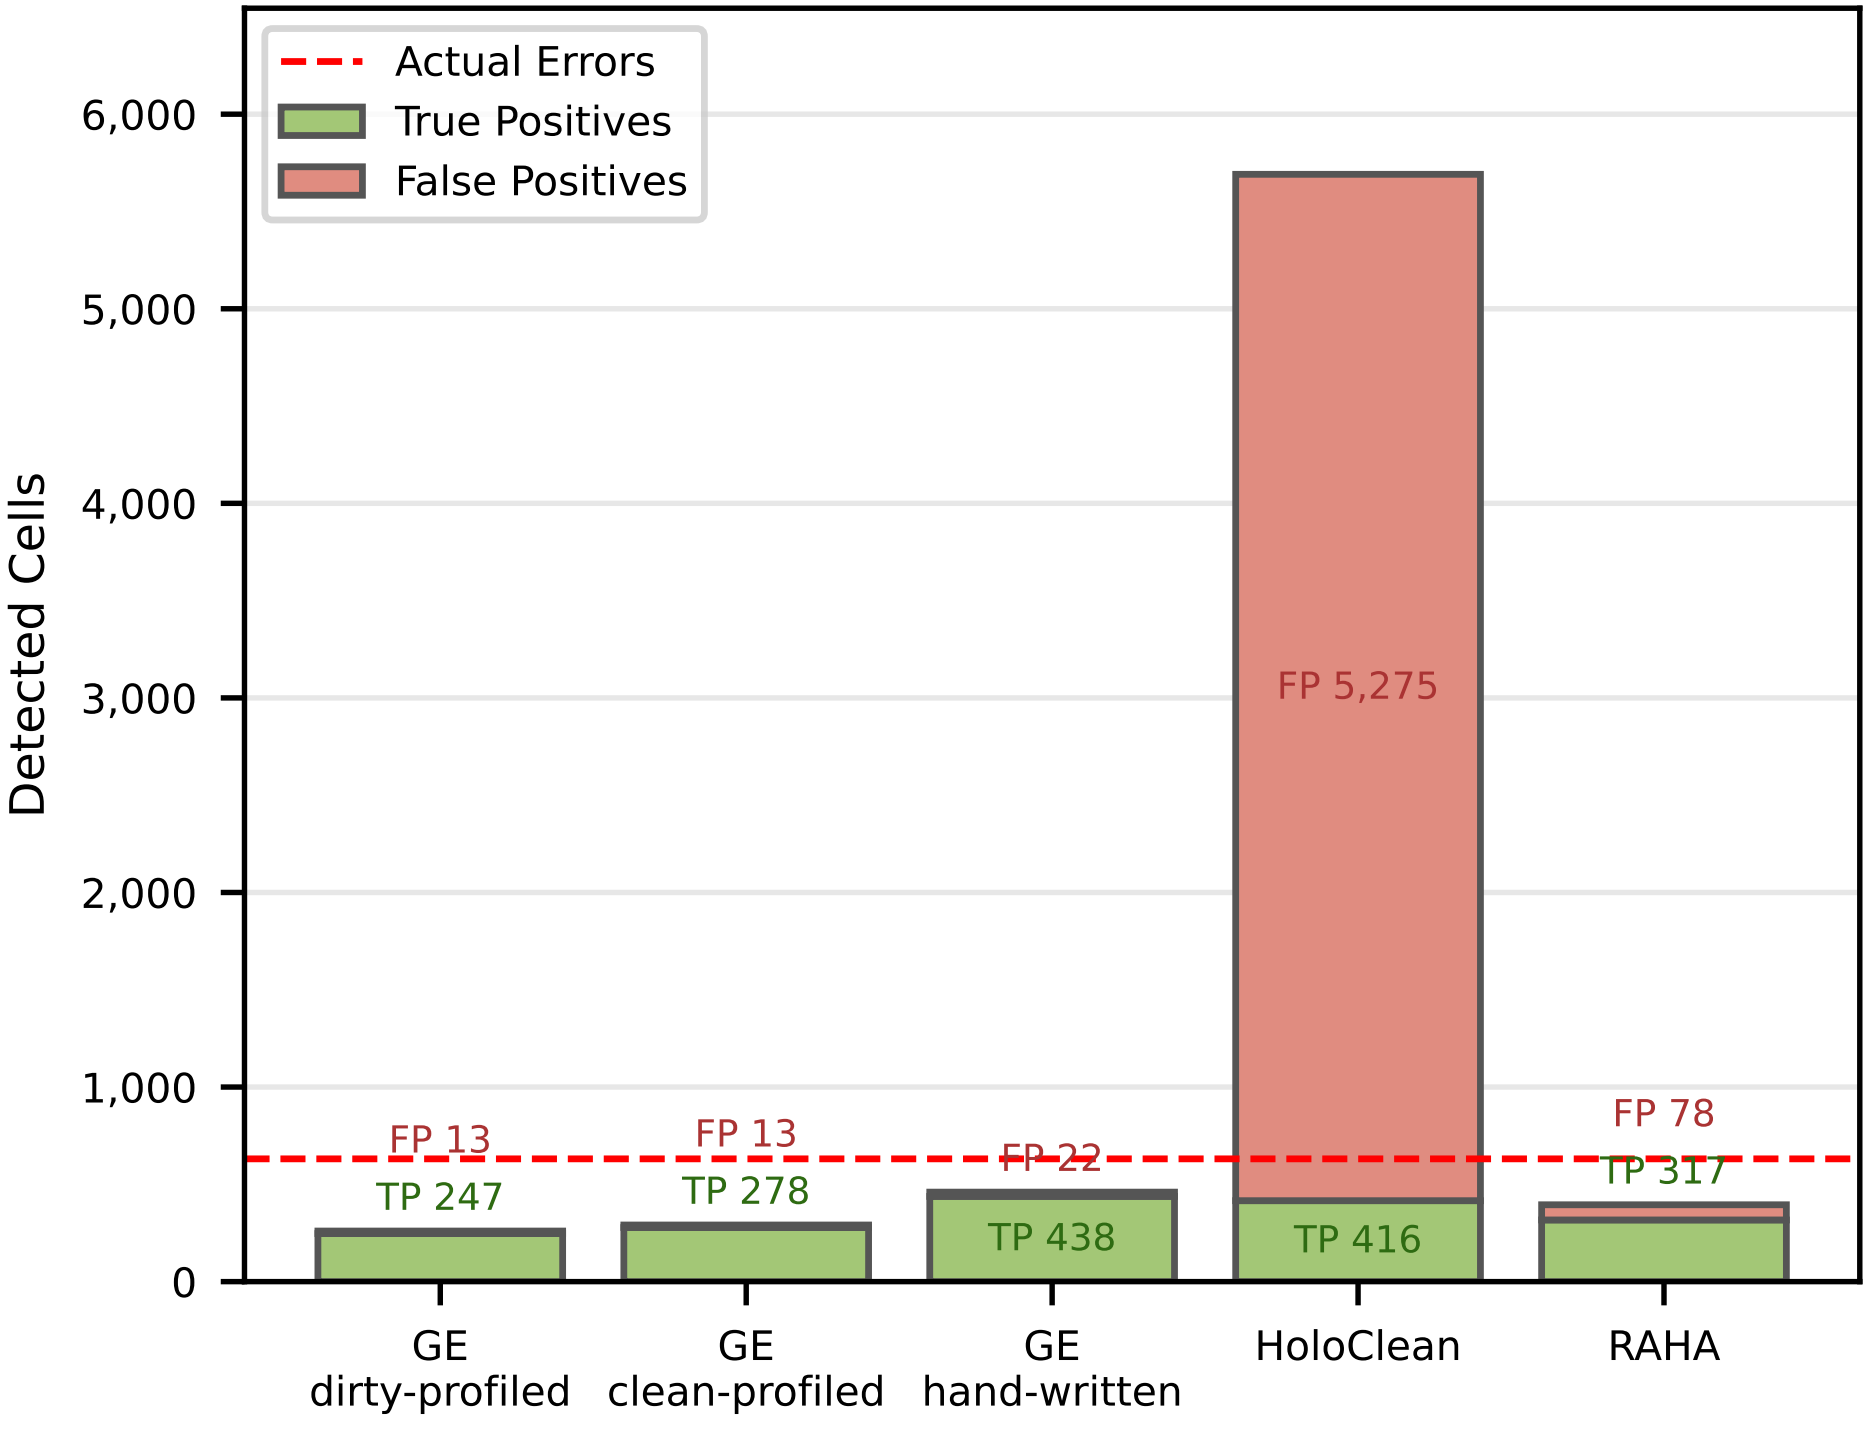
Actual Errors
True Positives
False Positives
Detected Cells
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
FP 13
TP 247
FP 13
TP 278
FP 22
TP 438
FP 5,275
TP 416
FP 78
TP 317
GE
dirty-profiled
GE
clean-profiled
GE
hand-written
HoloClean
RAHA