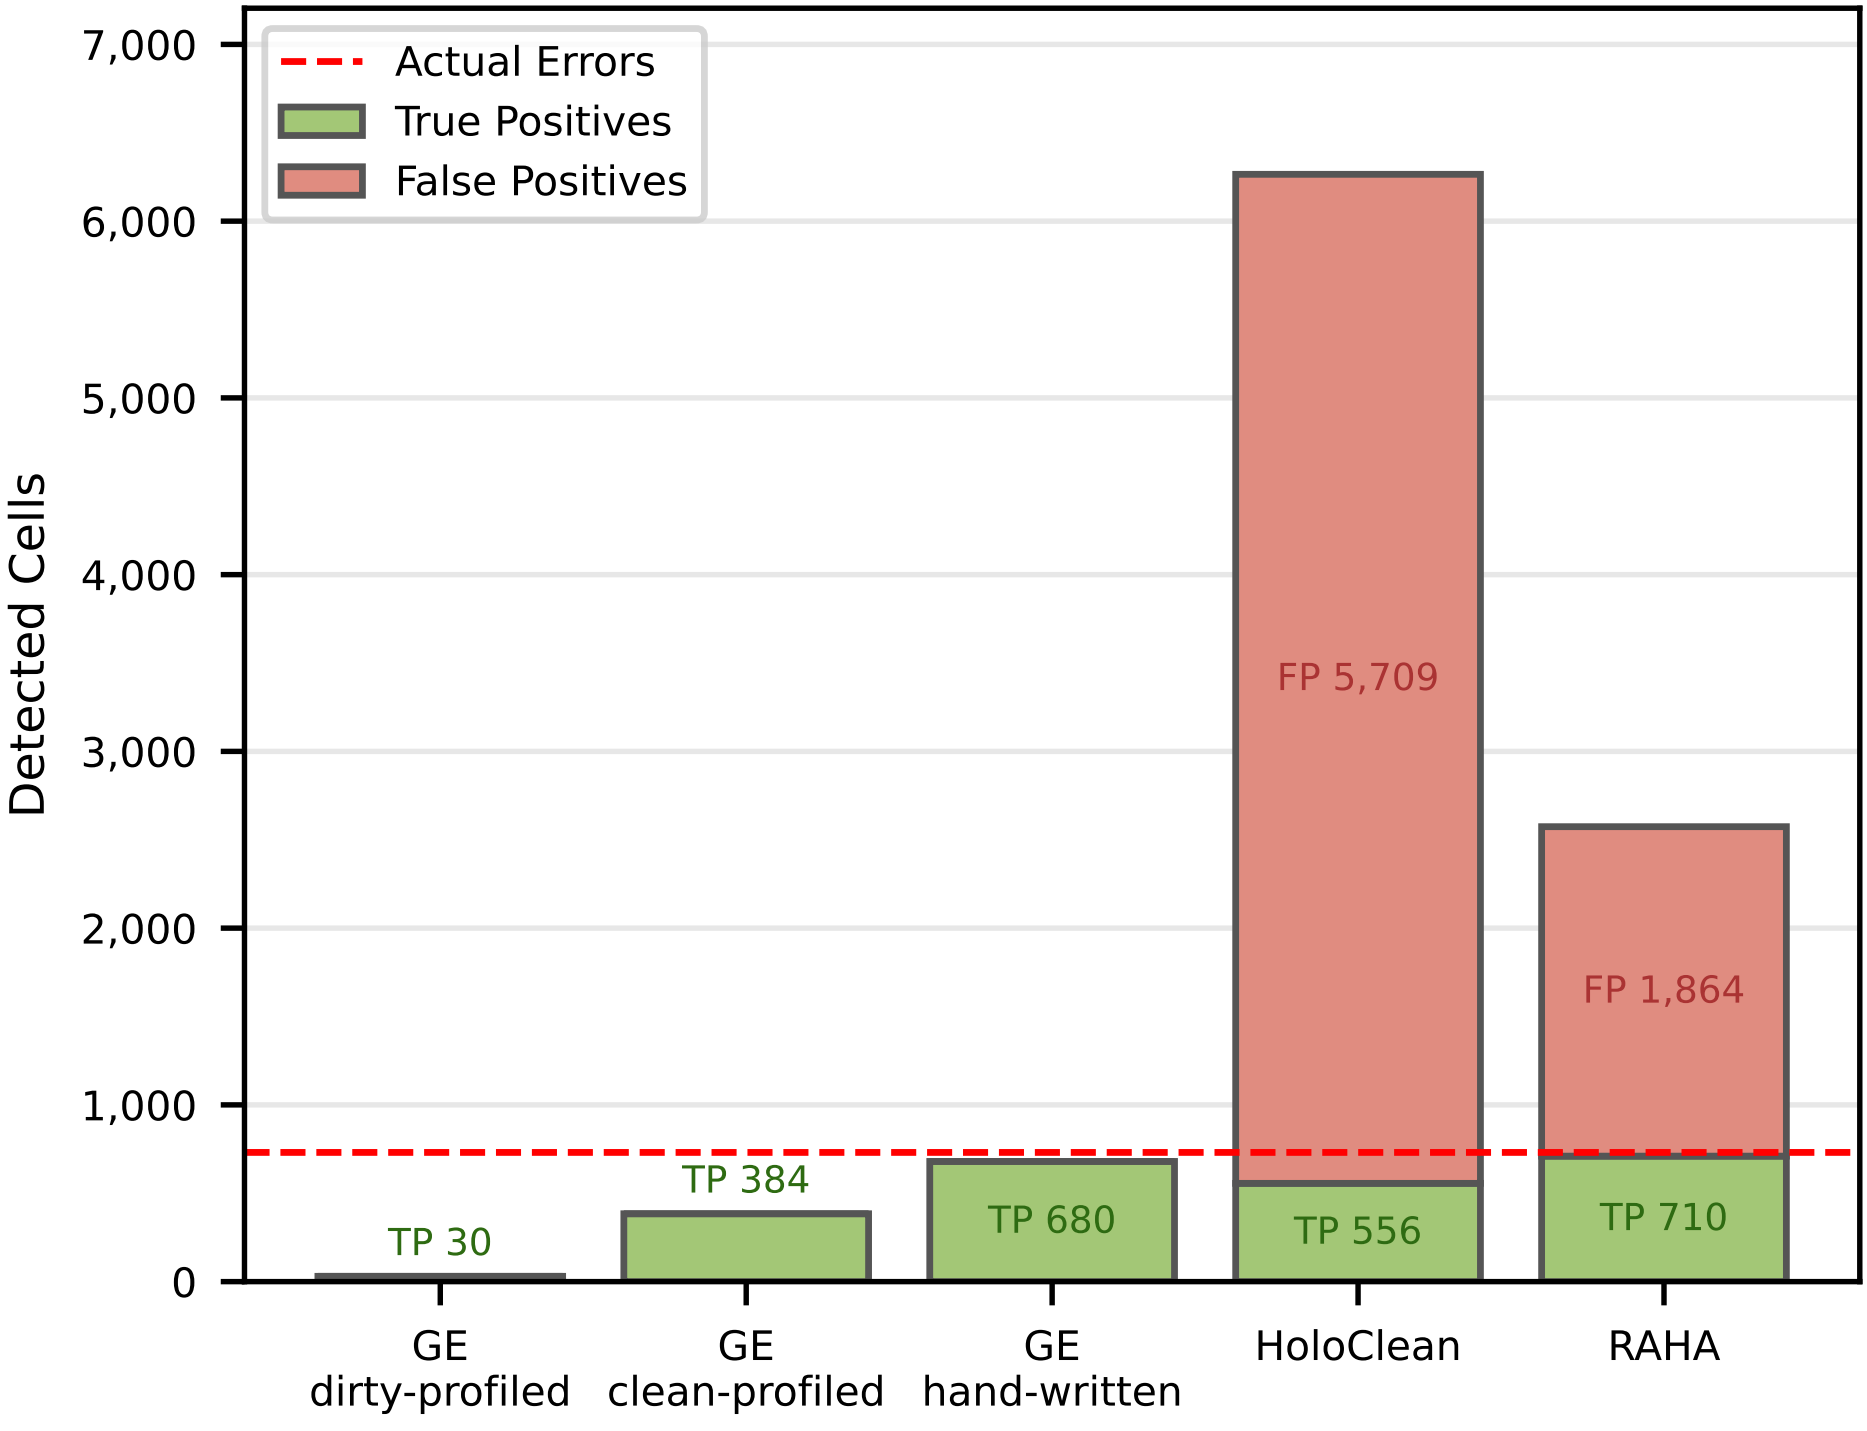
Actual Errors
True Positives
False Positives
Detected Cells
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
TP 30
TP 384
TP 680
TP 556
FP 5,709
TP 710
FP 1,864
GE dirty-profiled
GE clean-profiled
GE hand-written
HoloClean
RAHA