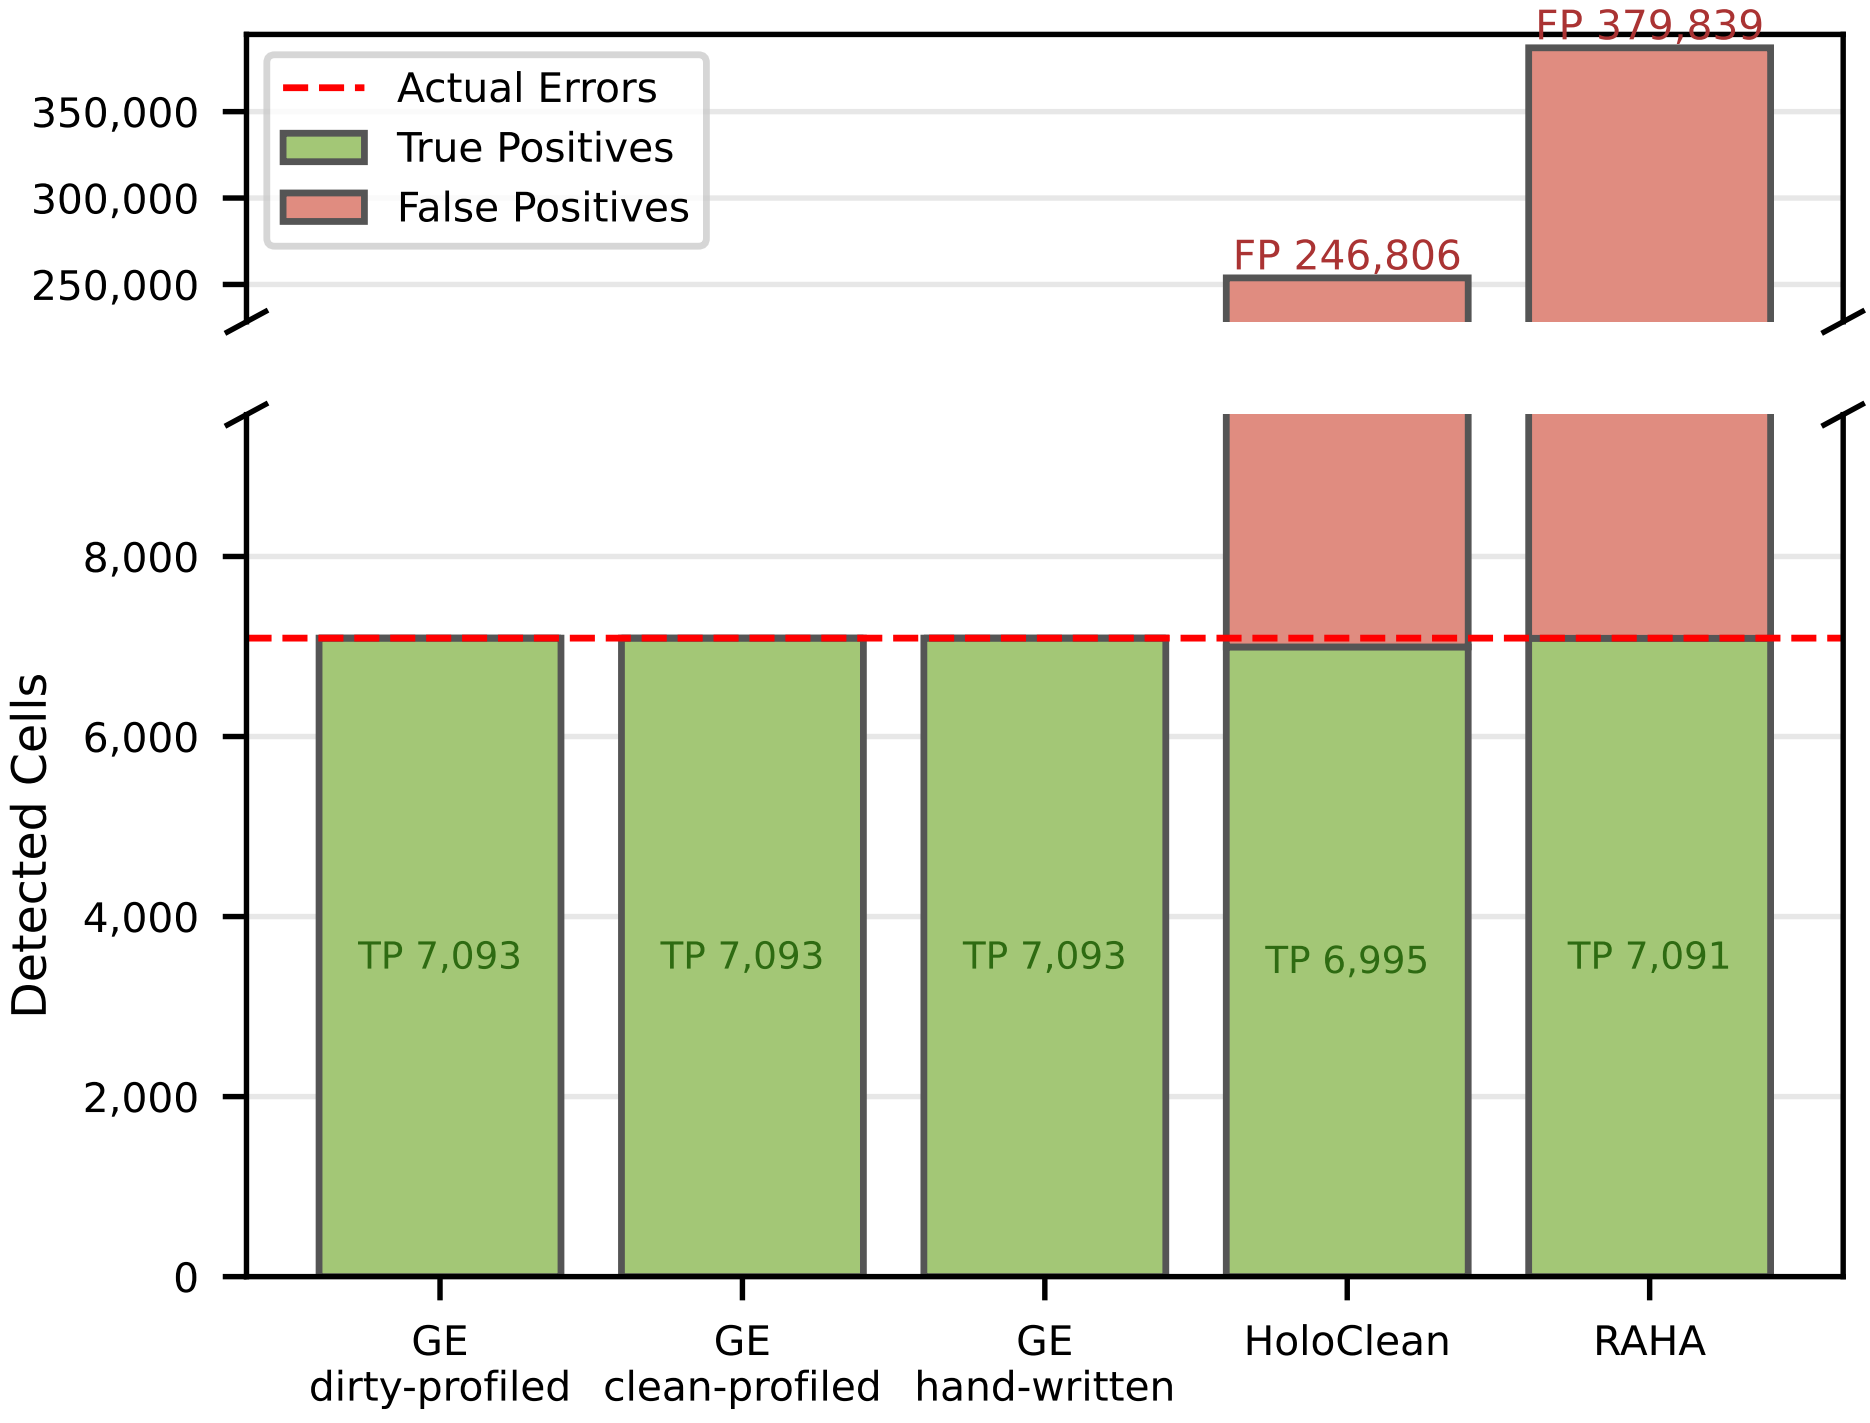
Actual Errors
True Positives
False Positives
350,000
300,000
250,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Detected Cells
FP 379,839
FP 246,806
TP 7,093
TP 7,093
TP 7,093
TP 6,995
TP 7,091
GE
dirty-profiled
GE
clean-profiled
GE
hand-written
HoloClean
RAHA