

Teste de Desenvolvimento - Medcloud

Relatório de Bugs encontrados no Website QA Medcloud

Gustavo Henrique Salina

Computador utilizado para testes: i5-8265U CPU 1.60GHz 1.80 GHz 16GB RAM Windows 10 Pro.

Navegador utilizado para testes: Google Chrome versão Versão 133.0.6943.60 (Versão oficial) 64 bits

Bugs encontrados na visualização geral:

- Seção portal não funciona: prioridade alta, ao clicar na seção “Portal” no header, não gera nenhum tipo de ação;
- Seção planos funciona incorretamente: prioridade alta, ao clicar na seção “Planos” no header o usuário é direcionado para a seção “PACS”;
- Modal de teste grátis: prioridade média
 - Botão de “solicitar conta grátis” fica disponível mesmo sem dados inseridos;
 - Campo nome aceita números e símbolos;
 - Campo e-mail aceita formatos inválidos;
 - Campo telefone permite inserir letras e símbolos após o usuário inserir pelo menos um número;
 - Campo de posição na clínica ou hospital não é obrigatório;

Experimente por 14 dias! X

Solicitar uma conta para clínica ou hospital

Nome:

123

E-mail:

123@123.123

Telefone:

4 joao da silva #


Posição da clínica ou hospital:

Selecione v

Solicitar uma conta grátis para clínica ou hospital

Já tem uma conta? [Entrar](#)


- Clicar no botão “entrar” gera loop e trava o navegador, prioridade alta;




- Entre a visualização da seção PACS e seção Portal o header se confunde e diz que o usuário está visualizando ambos ao mesmo tempo, prioridade baixa;



- O início da seção PACS não segue o mesmo estilo de modo escuro utilizado na descrição do sistema de renderização 3D, prioridade baixa;

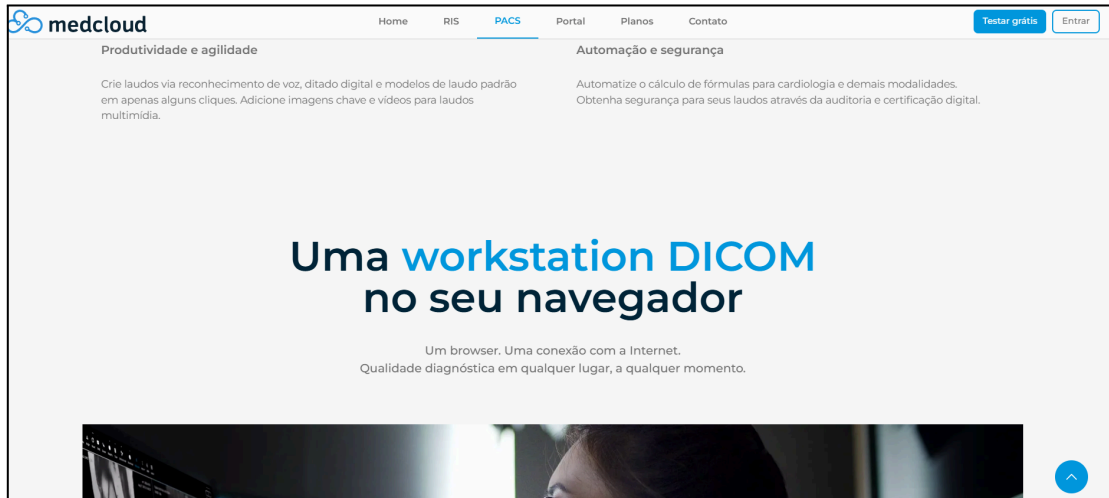


- No modo escuro PACS o botão que leva ao topo da página não sofre alteração no estilo, considerando que os outros elementos da tela são alterados, seria interessante que esse elemento também se modificasse, prioridade baixa;

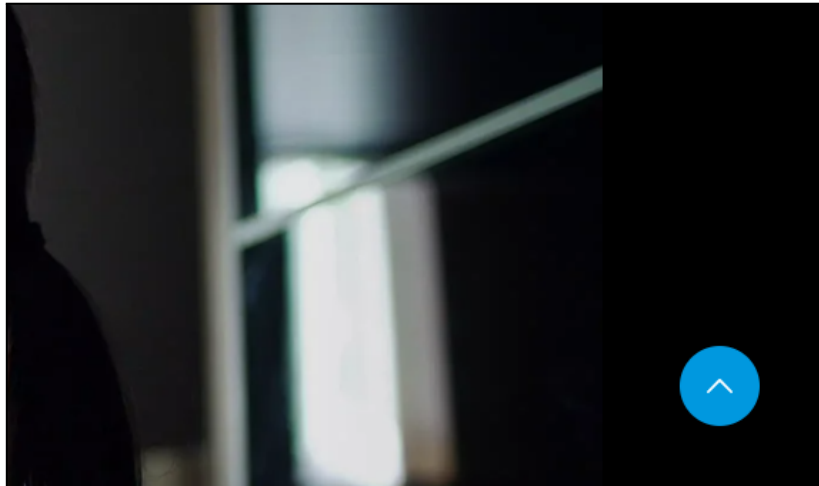

- Após o primeiro scroll a animação do notebook no topo da página não ocorre mais, sempre fica estática, prioridade baixa;
- Descrição de acesso do portal através da Smart TV não mostra uma imagem de televisão, mas sim de um smartphone, prioridade média;



- O FAQ inicializa aberto, mas o botão ainda exibe o “Abrir FAQ”, por conta disso para fechar o FAQ é necessário realizar dois cliques, prioridade baixa.

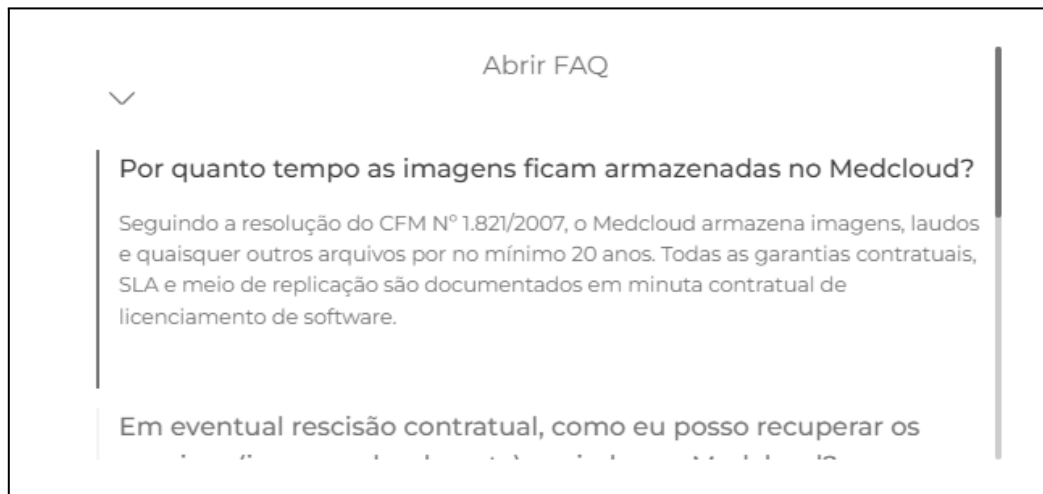


- É possível inserir caracteres inválidos no formulário de contato, como números e símbolos no nome, formatos inválidos de e-mail e letras no telefone. Além disso, não existe nenhum tipo de limitação de tamanho de mensagem. Prioridade alta.

The screenshot shows a contact form titled "Entre em contato". It includes a message prompt: "Deixe uma mensagem, pergunta ou comentário abaixo. Se preferir, entre em contato com nossa central de atendimento: +55 (11) 3382-7992." The form fields are:

- Nome: 123 #####
- E-mail: 123@123.com
- Telefone: joaozinho
- Mensagem: Becomes the field, but here shows much amiss. Go, bid the soldiers shoot. A dead march. Exeunt, bearing off the dead bodies; after which a peal of ordnance is shot off

 An "Enviar" button is at the bottom.

- O botão do Twitter está com o link da página no Facebook, prioridade média;

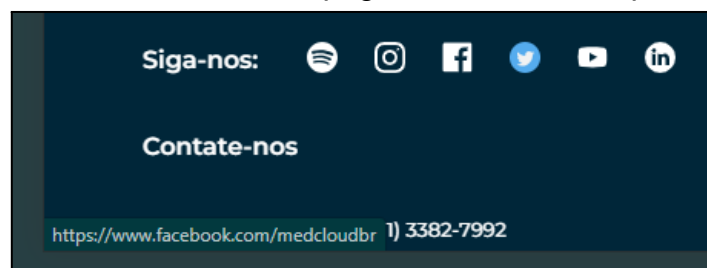

- Comparando o endereço de São Paulo no site QA com o oficial constatei que o endereço no QA está incorreto, prioridade média;
- A opção de idioma em inglês não funciona corretamente, ao clicar nela o site fica em espanhol, prioridade alta;
- O termo de uso e política de privacidade sempre são em português, mesmo que o usuário selecione o idioma inglês ou espanhol, prioridade baixa;
- O registro anvisa apresentado no footer não existe/não está mais registrado, prioridade média;
- Ao abrir o modal de teste grátis ou um vídeo, o botão de direcionar até o topo continua disponível para o usuário clicar. Prioridade baixa;

Experimente por 14 dias! X

Solicitar uma conta para clínica ou hospital

Nome:
Informe seu nome

E-mail:
Informe seu e-mail

Telefone:
Informe seu telefone

Posição da clínica ou hospital:
Selecione

[Solicitar uma conta grátis para clínica ou hospital](#)

Já tem uma conta? [Entrar](#)

Baixe o app

[Baixar na App Store](#)


[Baixar no Google Play](#)

no - São Paulo, SP


Política de privacidade

ina, Ponta Grossa, PR

Termos de uso

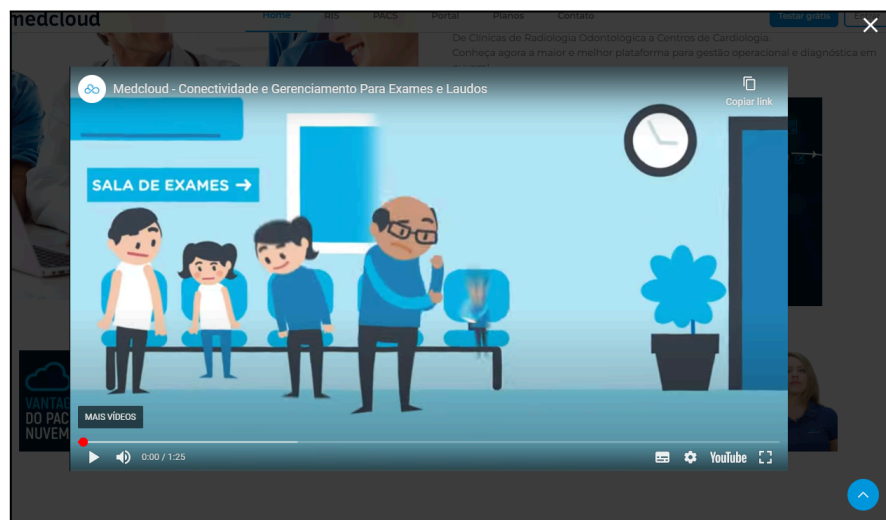

- Na página de carreiras, ao clicar em “Voltar ao site” no topo superior esquerdo da tela, a página tenta redirecionar para a url <https://qa.medcloud.link/careers>, isso gera uma tela de acesso negado, prioridade alta;

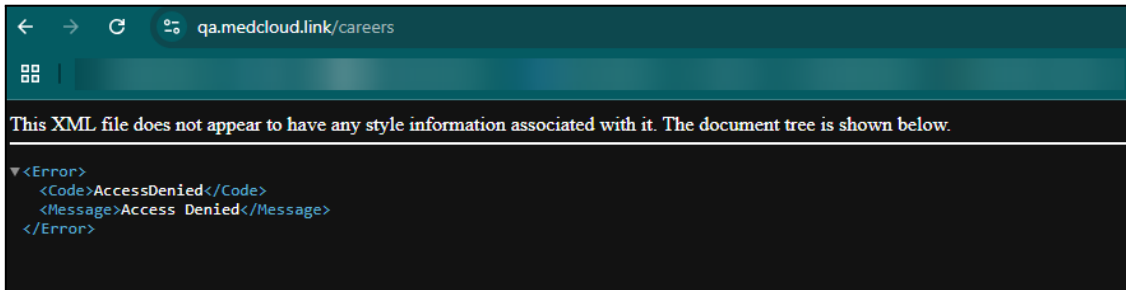

- O depoimento do usuário Eric Plugge não possui foto, prioridade baixa;



- Todos os formulários de candidatura têm o nome “João da Silva Sauro” inserido no campo de nome. Além disso, é possível inserir números e símbolos no sobrenome, email inválido, letras no telefone, sobre você sem limitação de caracteres e é possível inserir um arquivo que não seja no formato PDF, prioridade alta.

Candidate-se

Nome:

João da Silva Sauro

Sobrenome:

123

E-mail:

123@123.com

Telefone:

1 joaozinho

Sobre você:

Becomes the field, but here shows much amiss.
Go, bid the soldiers shoot.
A dead march. Exeunt, bearing off the dead bodies; after which a peal of ordnance is shot off

vOiwZjMA_400x400.jpg

Enviar

- Selecionar um outro idioma no footer não altera o idioma da página de carreiras, todas as informações ainda continuam em português, prioridade alta;

[< Ver todas as vagas](#)



informe seu telefone

Sobre você:

Conte-nos um pouco sobre você e por que você está interessado em trabalhar na Medcloud

Anexar currículo...

Enviar

Síganos:      

Contáctenos

Equipo comercial | +55 (11) 3382-7992

contato@medcloud.com.br

Av. Presidente Epitácio Lima, 3155 - Sala 310 - Jardim Paulistano - São Paulo, SP

Sobre Medcloud

Sobre

Carreras

Política de privacidad

Baje la app


 




Bugs encontrados em resoluções específicas:

Aqui irei considerar algumas resoluções padrão, é muito difícil garantir que um website ou aplicativo esteja adequado para qualquer tipo de tela, a cada dia surgem novas resoluções e tamanhos de tela. Além disso, por padrão, os testes foram realizados com 100% de zoom no navegador. As resoluções que irei utilizar são: 1366x768, 1920x1080, iPhone 14 Pro Max 430x932 e iPad Air 820x1180. Dessa forma é possível cobrir a maior parte das necessidades dos usuários.


- Em 1366x768 e 1920x1080 não encontrei nenhum bug visual de alinhamento ou sobreposição de itens. Os itens descritos anteriormente foram visualizados nessas resoluções;
- Para os testes mobile também utilizei meu próprio aparelho, porém os prints são simulando a funcionalidade pelo *devtools*. Na visualização mobile e tablet temos duas possibilidades de usabilidade, modo paisagem e modo retrato;
- Tela inicial mobile:
 - O carrossel de sistemas no topo da home não tem as descrições de cada um dos sistemas no modo retrato, prioridade baixa;

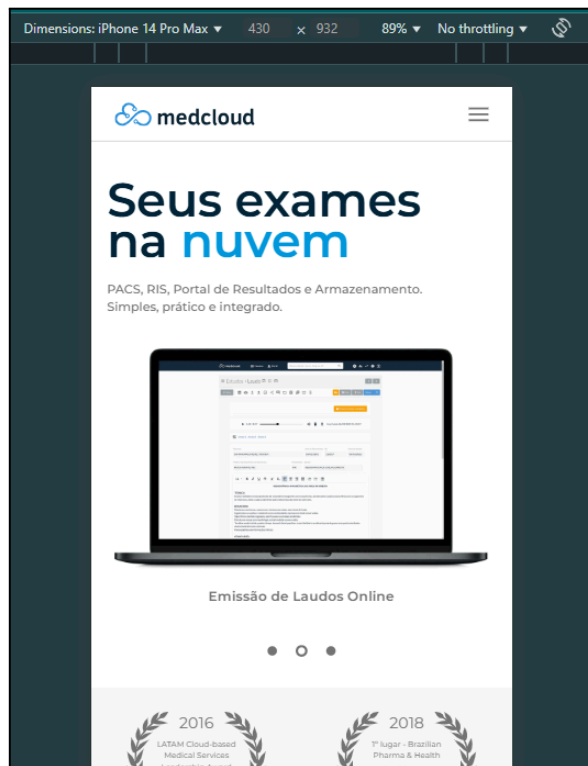

- O menu de sistemas não possui a opção de “Entrar”, somente a de “Testar grátis”, além disso, é possível scrollar e realizar operações na página enquanto o menu lateral está aberto, prioridade alta;

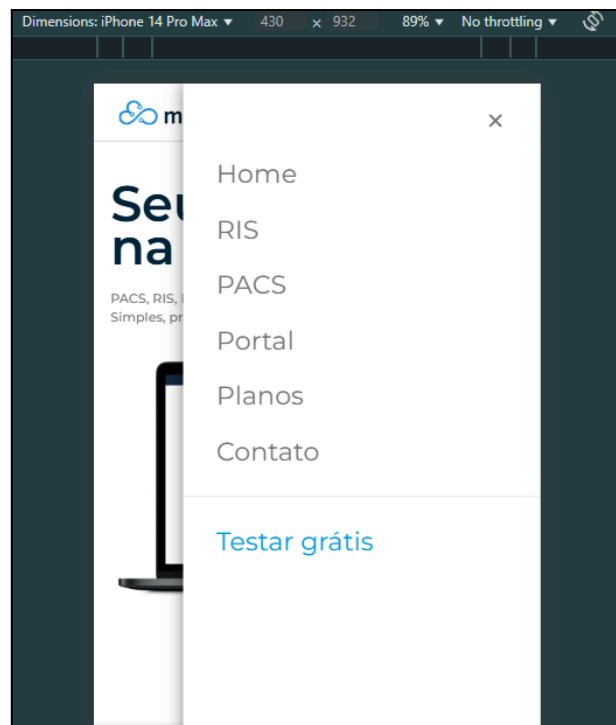

- O carrossel de clientes não funciona corretamente no mobile, primeiro o usuário precisa dar um clique para mostrar as informações do cliente e mais um para acessar a página. Isso provavelmente acontece por conta da animação feita no desktop, prioridade baixa.

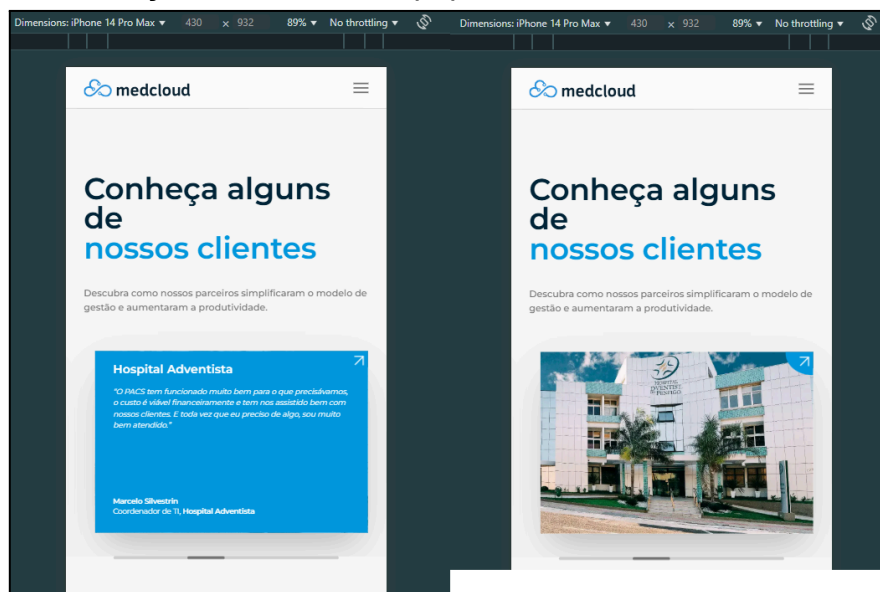


- A galeria de vídeos na seção de “Radiologia inteligente” não aparece na visualização mobile retrato, prioridade média;




- A galeria de vídeos para os diversos dispositivos suportados não aparece na visualização mobile retrato, prioridade baixa;


- O botão de retornar ao topo fica disponível mesmo quando temos modais abertos, caso o usuário aperte, ao fechar o modal estará no topo da página, prioridade baixa;

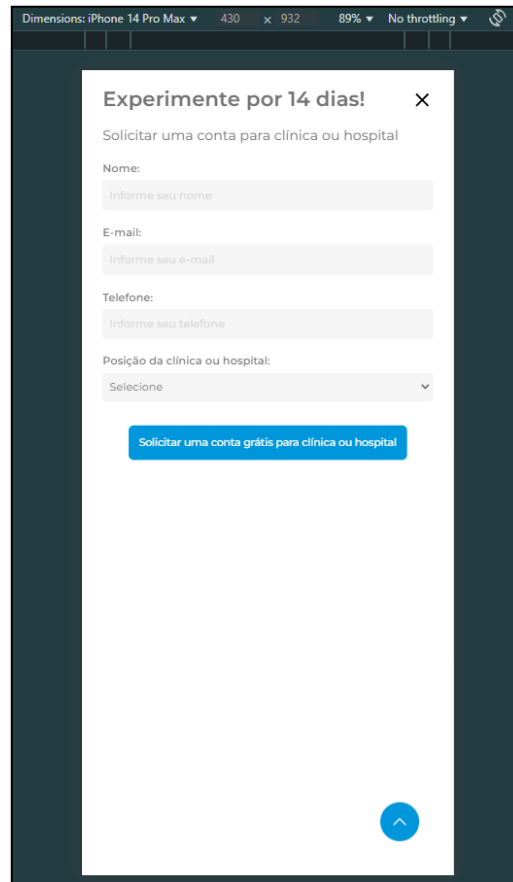


- O player de vídeo do 3D Volume Rendering permite que o usuário use o scroll para cima ou baixo, gerando bug visual, prioridade média;

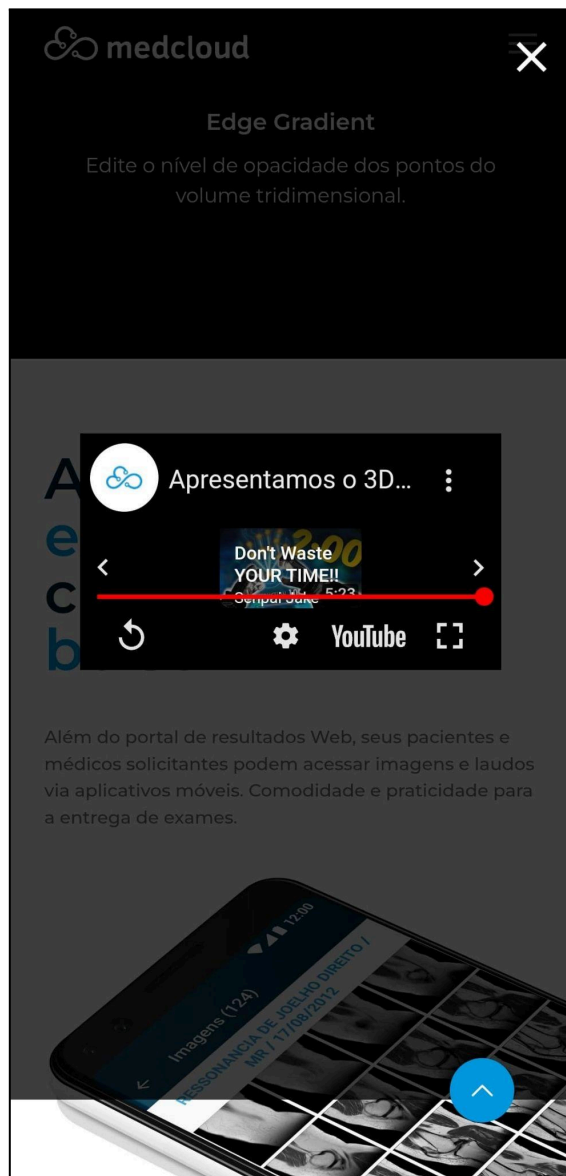


- As conquistas de Medcloud se sobrepõem na visualização mobile paisagem, prioridade baixa;

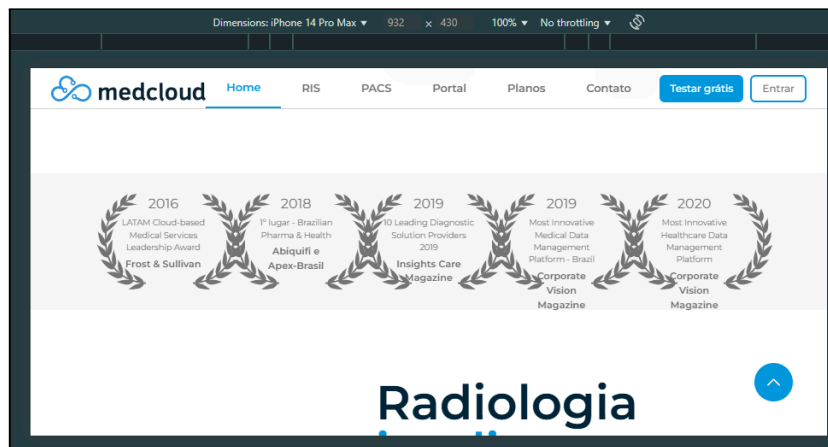


- O modal de teste grátis não fica cortado na visualização mobile paisagem, prioridade alta;

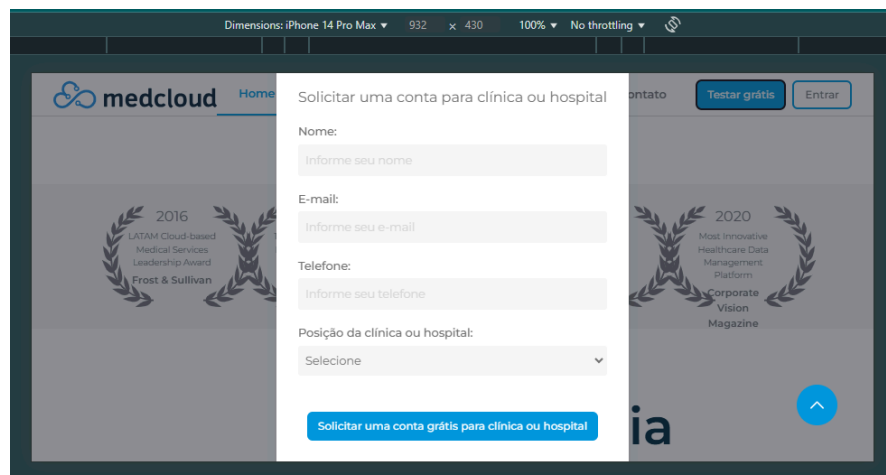


- Os vídeos aparecem desalinhados no modo paisagem, prioridade baixa;

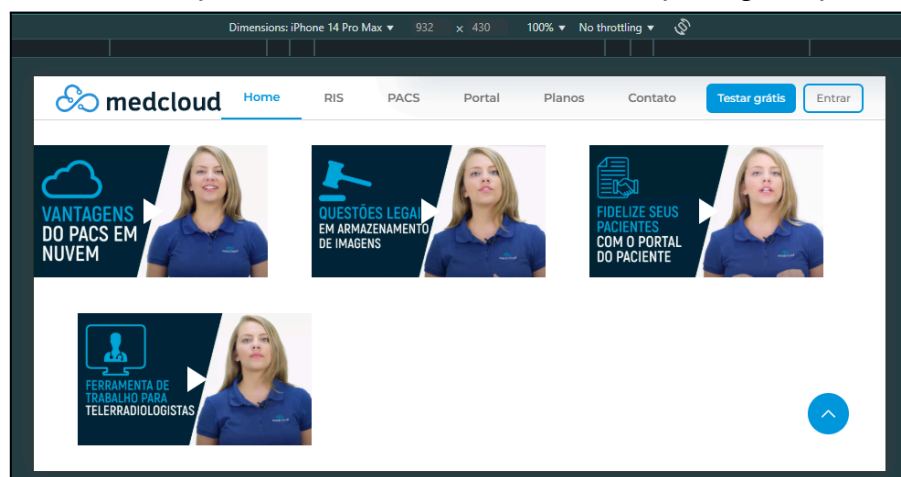


- Os cards de planos não possuem o mesmo tamanho na visualização paisagem, isso também acontece em tablets, prioridade baixa;

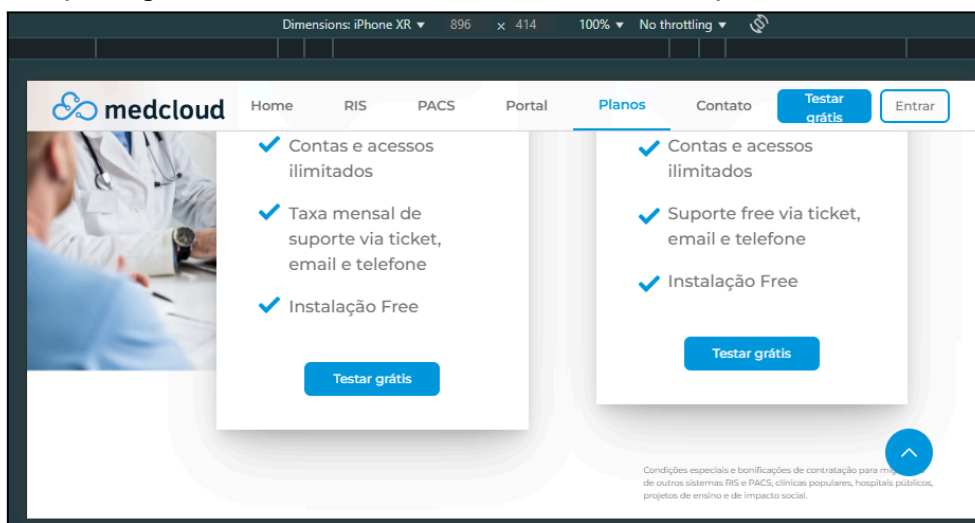

- Página de carreiras mobile:
 - Por conta das animações nos cards de vagas, caso o usuário role muito rápido a tela é possível *bugar* a resolução, causando um espaço em branco na lateral. Caso o usuário volte para o topo da tela o espaçamento é ajustado. Prioridade baixa;

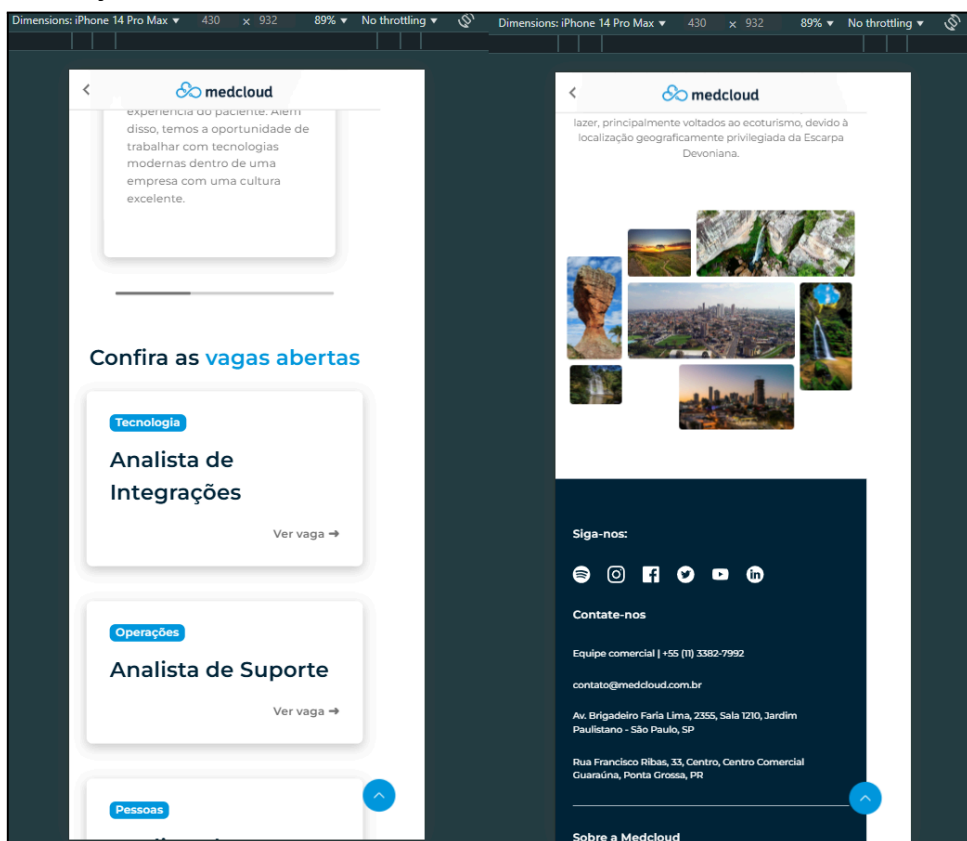


- Inserir um arquivo com um nome grande quebra o layout do site, o nome ultrapassa a tela, prioridade baixa;

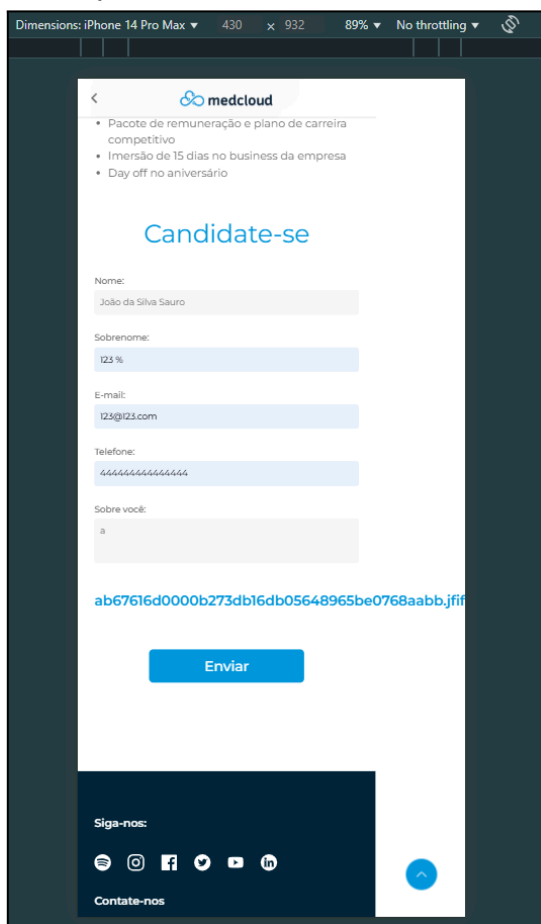

- Na seção “No que acreditamos” na visualização em paisagem existe a repetição da imagem, isso também acontece no tablet paisagem e retrato, prioridade baixa;



- O nome das vagas ultrapassa o tamanho do card na visualização mobile em paisagem, prioridade média;

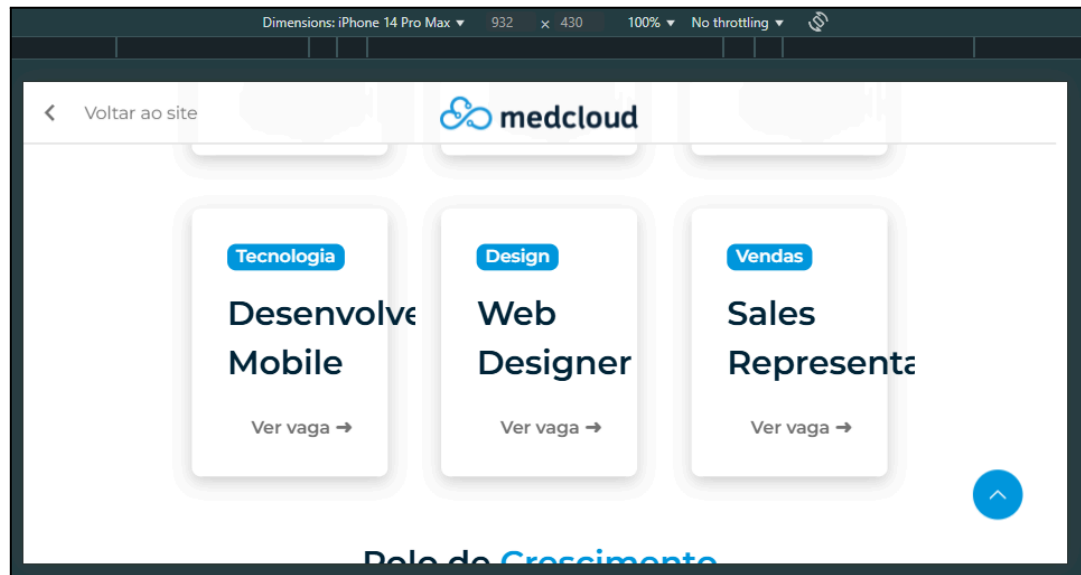

- Tela inicial tablet:
 - As conquistas da Medcloud se sobrepõem na visualização retrato e os vídeos da seção “Radiologia inteligente” estão desalinhados, prioridade baixa;



- Os prints e descrições estão pequenos, provavelmente por conta da resolução o sistema fica entre a visualização mobile e a de desktop, causando esse problema. Isso também acontece na seção de clientes da Medcloud;

Dimensions: iPad Air
820
x
1180
70%
No throttling


medcloud
Home
RIS
PACS
Portal
Planos
Contato
Testar grátis
Entrar

Faturamento

Automatize o faturamento TISS/TUSS, controlando glosas e a geração de lotes de forma simples e prática. Programe regras de repasse médico e diversas formas de pagamento para que sua clínica cresça cada vez mais.



- TISS/TUSS
- Histórico de lotes
- Integração CBHPM
- Gestão de convênios
- Controle de glosas
- Repasse médico

Business Analytics

Monitore o volume de agendamentos e exames realizados através de relatórios estruturados. Gerencie o caixa da sua clínica e obtenha insights através de indicadores de suporte à tomada de decisão.




- Produtividade
- Indicadores
- Assertividade
- Performance
- Projeções otimizadas
- Preditividade

Prontuários

Controle toda a jornada dos seus pacientes em um único lugar. Envie lembretes e felicitações de forma automatizada. Gerencie o histórico médico, protocolos e laudos anteriores de seus pacientes já



- A “indecisão” entre mobile e desktop também ocorre na página “Sobre nós”, os dados ficam em uma coluna pequena e centralizada, prioridade alta;

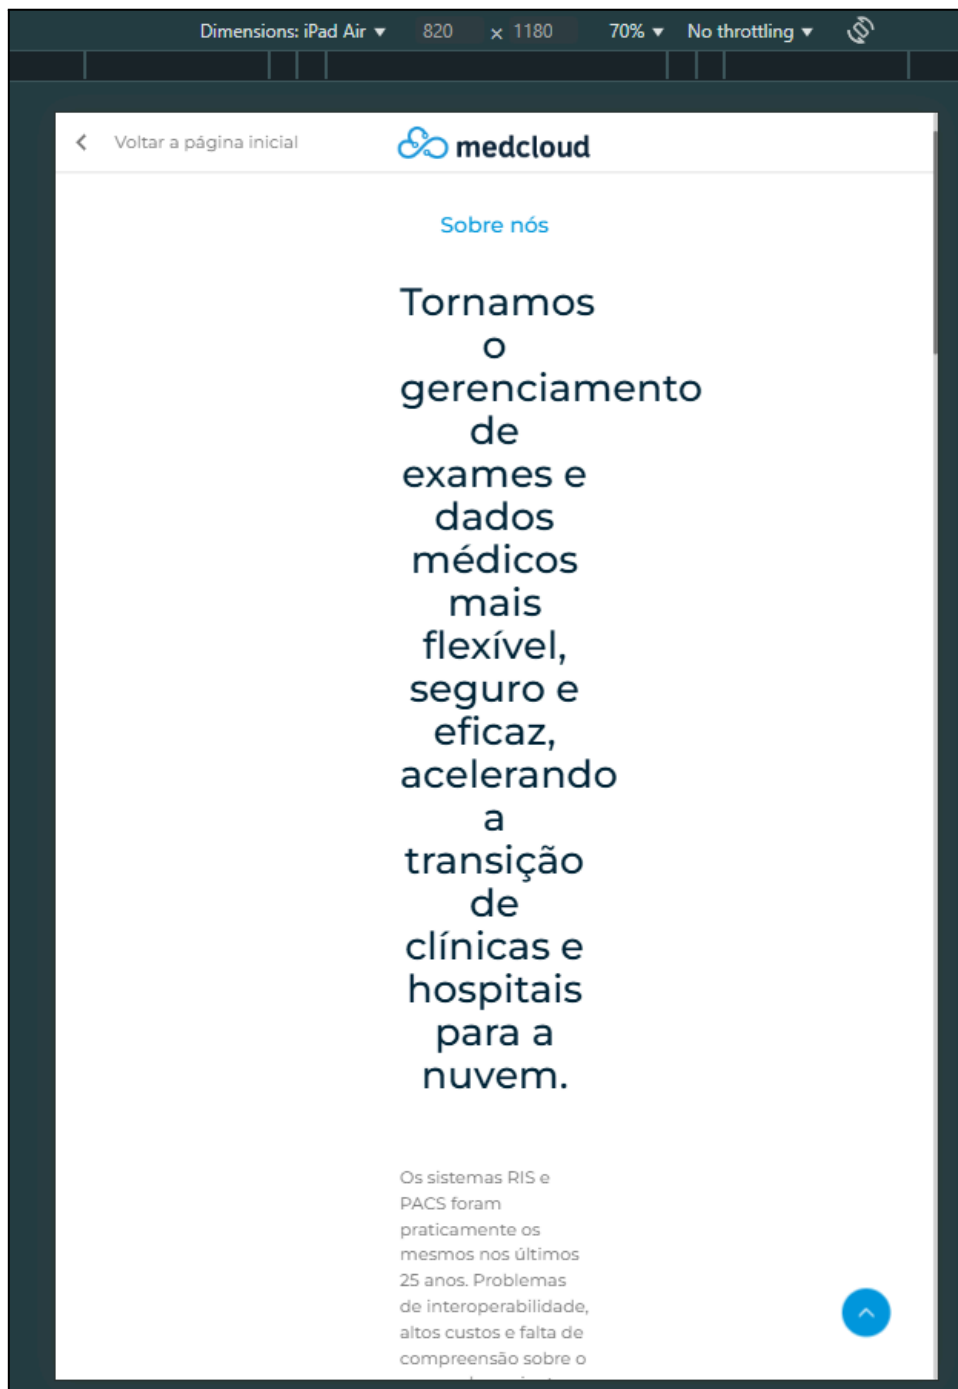


- Na visualização de paisagem o tablet se comporta quase como um notebook de tela pequena, por conta disso não há quase nenhum bug visual;


Bugs encontrados no *devtools*:

Aqui irei descrever os bugs encontrados na funcionalidade de inspecionar elementos, ou *devtools*. Essa ferramenta não é utilizada pelos usuários mais comuns, porém é importante assegurar que console logs de desenvolvimento não estejam presentes na versão de produção. Além disso alguns erros são silenciosos, o usuário não percebe, mas o console reporta.


- Ao abrir o inspecionar elementos na página inicial é possível visualizar uma mensagem de “ISSO É UM BUG” no console, prioridade média;

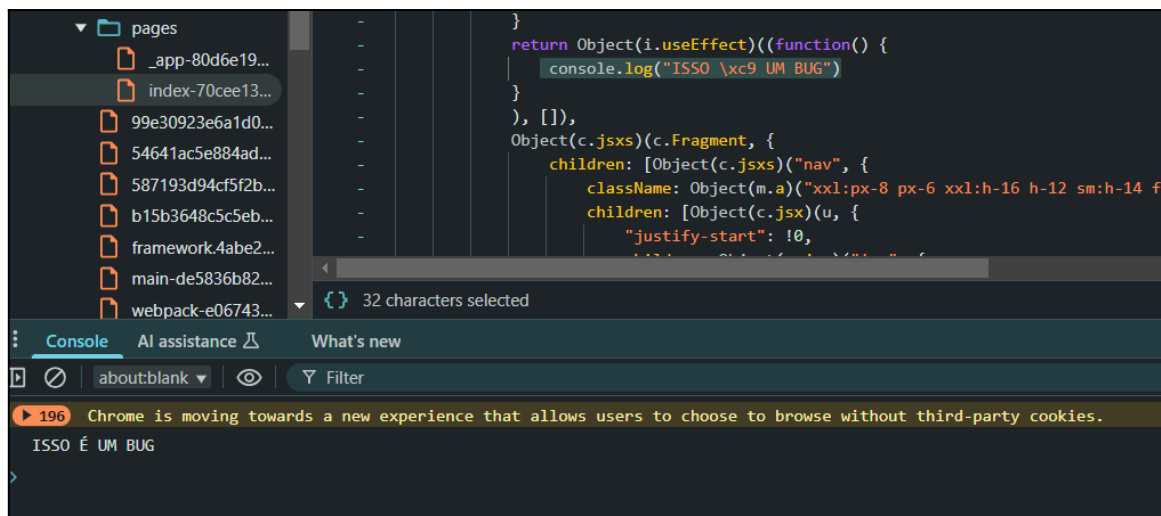


- Ao clicar no botão entrar na página inicial é imprimido em loop a mensagem “bug” no console, prioridade alta;

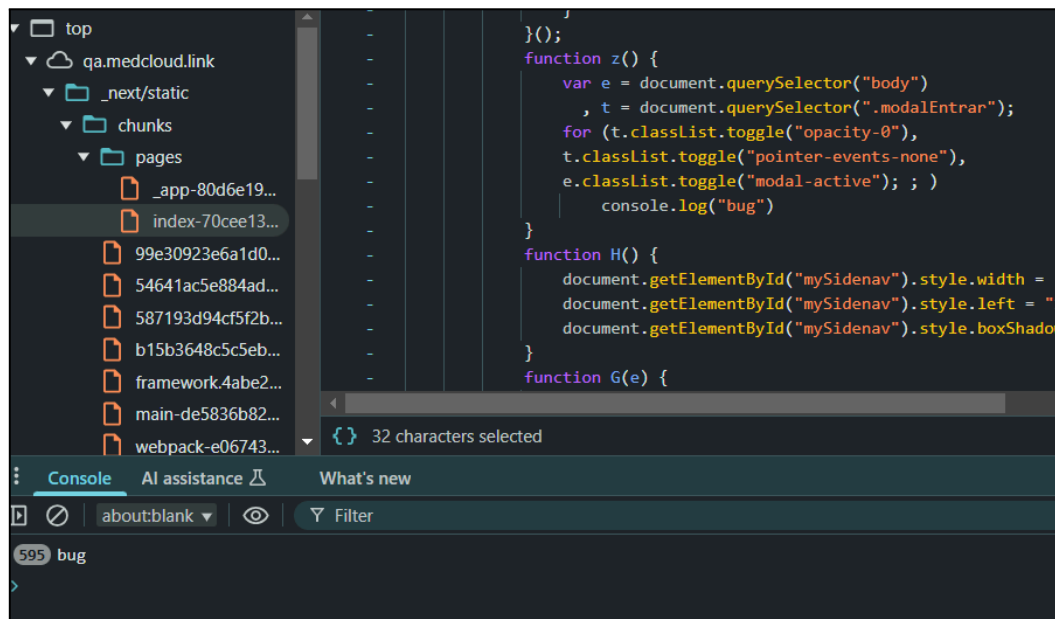


- No local storage novamente temos a mensagem “isso é um bug”, prioridade média;

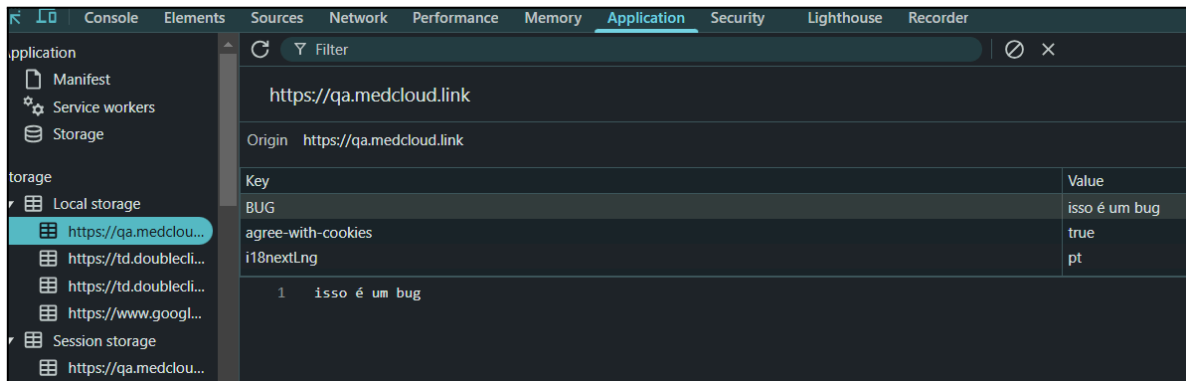


- Ao clicar em “Entre em contato” na página sobre o console imprime a seguinte mensagem, prioridade baixa;

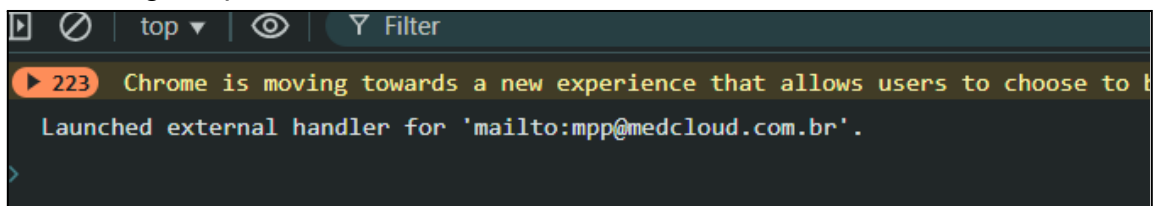



- Ao acessar a página de vagas abertas o console dispara diversos erros 403 para as carreiras, prioridade alta;

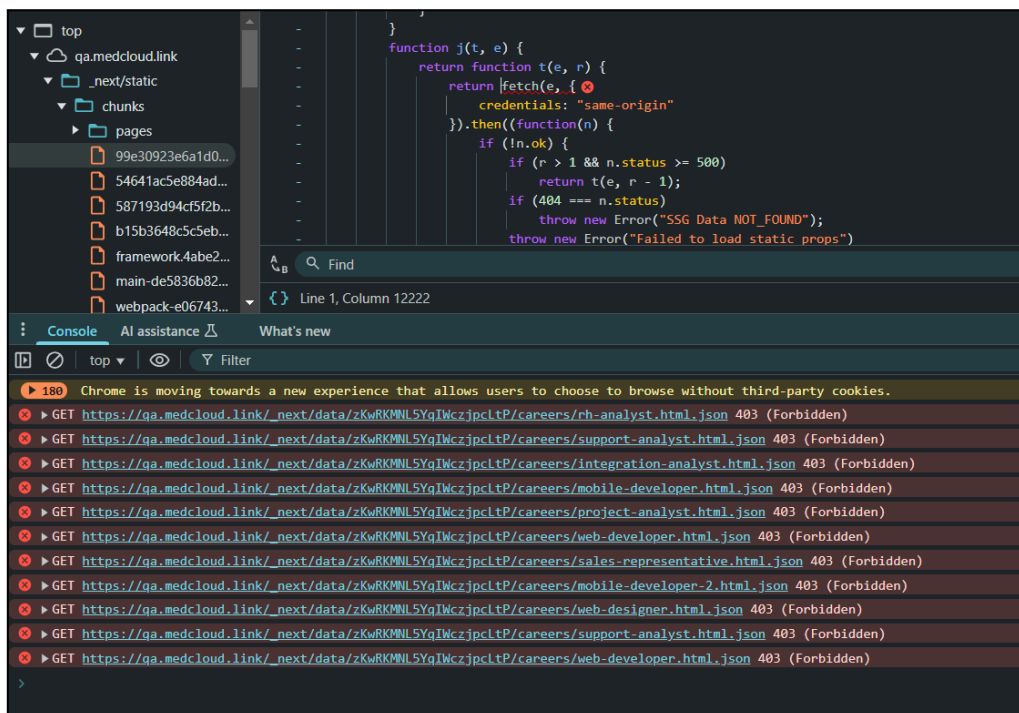

- No footer da descrição de cada uma das vagas o console exibe erro 403 para o “about” e “careers”, prioridade alta;

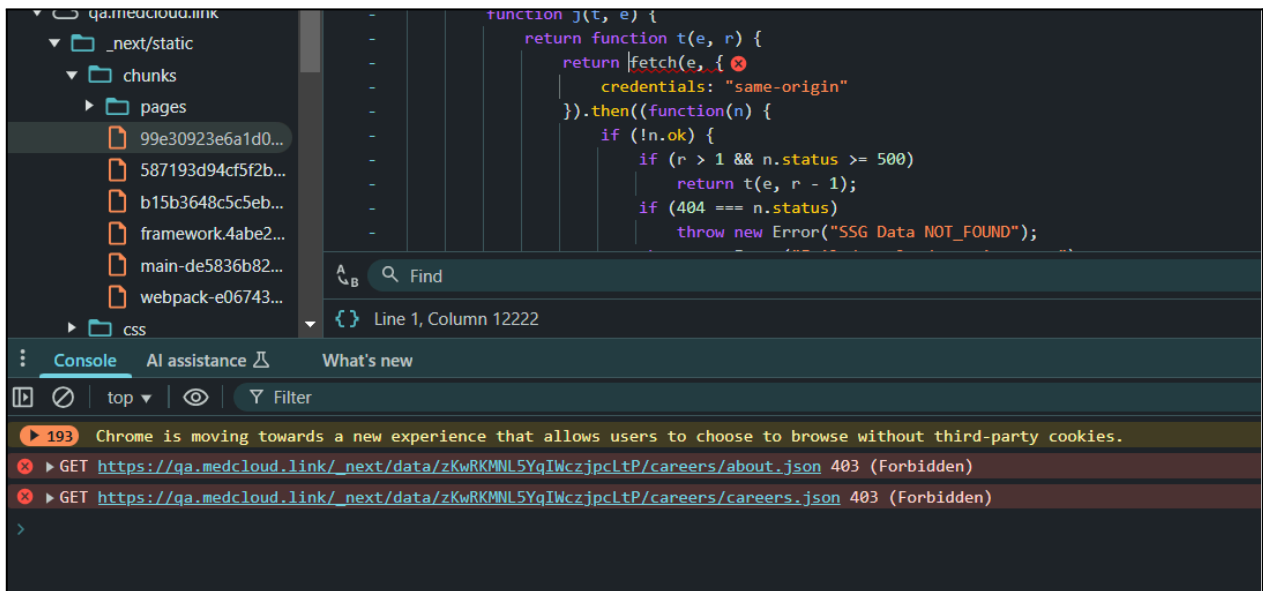

Por conta disso, quando o usuário tenta acessar a página sobre ou carreira via rodapé de uma descrição de vaga a página não carrega e exibe erro de acesso negado para o usuário.

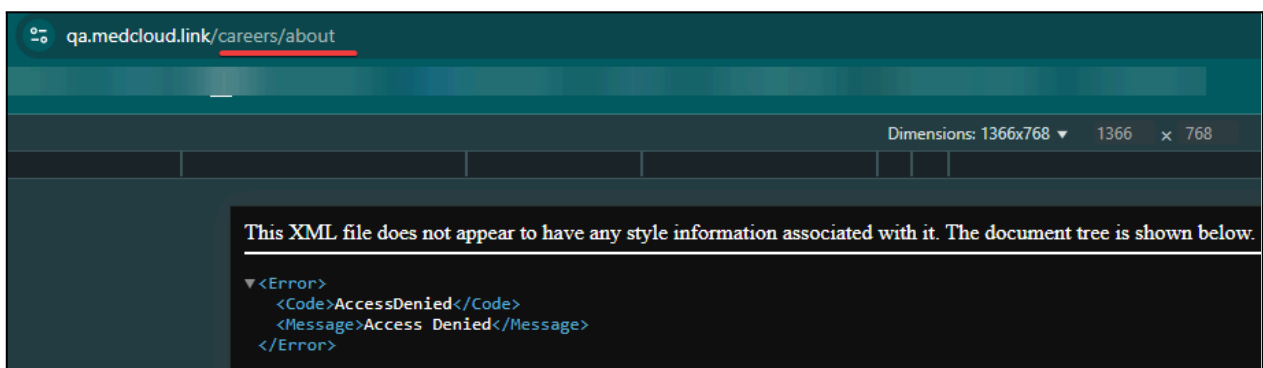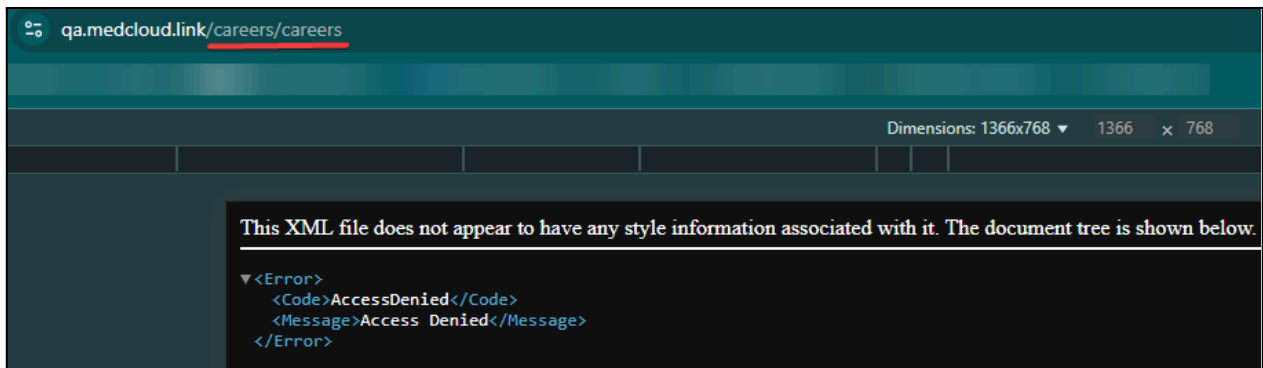


Bug de scroll de modal teste grátis:

Esse bug aparece quando o usuário realiza uma combinação de ações específicas, por ser algo relativamente escondido e de difícil reprodução eu decidi separar uma seção para falar especificamente dele. Esse tipo de bug é um dos mais complicados de serem tratados pois dependem de passos específicos e geralmente são encontrados por acaso.

O primeiro passo para acontecer o bug é abrir um dos vídeos da seção “Radiologia inteligente”.



Quando o usuário abre algum desses vídeos ele é reproduzido em uma sobreposição da tela e o scroll da home é desativado.

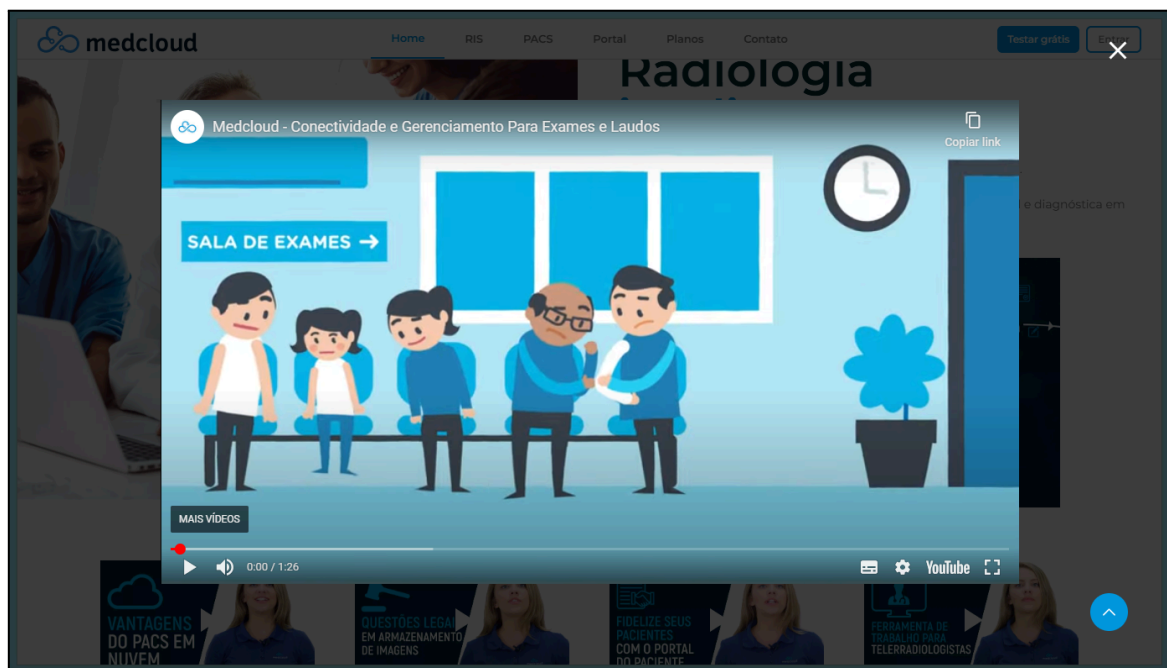

Depois, basta fechar o vídeo e abrir o modal de “Testar grátis”, dessa forma o scroll da página inicial continua disponível com o modal aberto, permitindo que o usuário role a página enquanto o formulário de teste fica aberto.



Os outros vídeos não ocasionam esse bug, acredito que tenha relação com o fato de que ao abrir os vídeos da seção “Renderização Volumétrica 3D” e “Acesse com vários dispositivos.” o scroll da página principal ainda fica disponível. O sistema provavelmente se confunde ao comparar o estado inicial do scroll com o estado ao abrir uma sobreposição. Mas isso é apenas uma suposição e para encontrar mais pistas seria necessário estudar melhor o código fonte. Porém, achei bem interessante o comportamento. A prioridade para esse bug é média.