FX-MAB-01 기술이전 보고서 Rev.2 (2026-05-10) (가상)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. 목표 titer는 4.0 g/L이다. Rev.2에서 용존산소(DO) 설정을 35%에서 40%로 바꾸었다 (2025년 구조도의 35%는 옛 값). 주요 공정 조건은 아래 표와 같다.

항목	설정	허용 범위
배양 온도	36.5 °C	±0.5
용존산소(DO)	40%	±5%
교반	120 rpm	±10
pH	7.0	±0.1

2. 공정 흐름

하류 공정 흐름은 그림 4와 같다. Protein A 다음 단계는 바이러스 불활화(VI-310)이다.

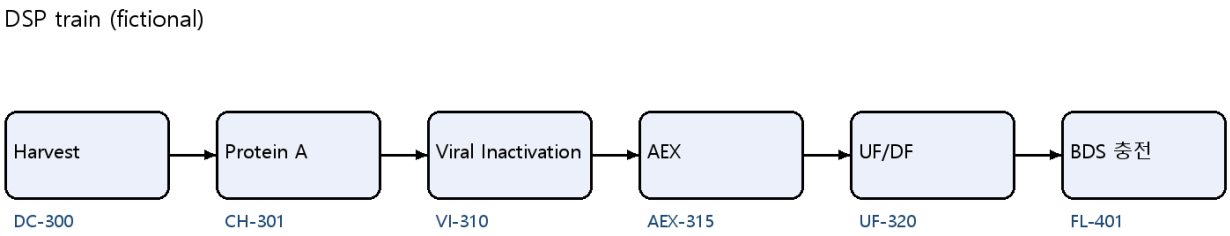


그림 4. FX-MAB-01 하류 공정 흐름

3. 공정 파라미터 목록 (1/3)

코드	구분	파라미터	설정값	분류
PP-001	DSP	파라미터 1	10.37	CPP
PP-002	QC	파라미터 2	10.74	KPP
PP-003	USP	파라미터 3	11.11	
PP-004	DSP	파라미터 4	11.48	CPP
PP-005	QC	파라미터 5	11.85	KPP
PP-006	USP	파라미터 6	12.22	
PP-007	DSP	파라미터 7	12.59	CPP
PP-008	QC	파라미터 8	12.96	KPP
PP-009	USP	파라미터 9	13.33	
PP-010	DSP	파라미터 10	13.7	CPP
PP-011	QC	파라미터 11	14.07	KPP
PP-012	USP	파라미터 12	14.44	
PP-013	DSP	파라미터 13	14.81	CPP
PP-014	QC	파라미터 14	15.18	KPP
PP-015	USP	파라미터 15	15.55	
PP-016	DSP	파라미터 16	15.92	CPP
PP-017	QC	파라미터 17	16.29	KPP
PP-018	USP	파라미터 18	16.66	
PP-019	DSP	파라미터 19	17.03	CPP
PP-020	QC	파라미터 20	17.4	KPP
PP-021	USP	파라미터 21	17.77	
PP-022	DSP	파라미터 22	18.14	CPP
PP-023	QC	파라미터 23	18.51	KPP
PP-024	USP	파라미터 24	18.88	
PP-025	DSP	파라미터 25	19.25	CPP

3. 공정 파라미터 목록 (2/3)

PP-026	QC	파라미터 26	19.62	KPP
PP-027	USP	파라미터 27	19.99	
PP-028	DSP	파라미터 28	20.36	CPP
PP-029	QC	파라미터 29	20.73	KPP
PP-030	USP	파라미터 30	21.1	
PP-031	DSP	파라미터 31	21.47	CPP
PP-032	QC	파라미터 32	21.84	KPP
PP-033	USP	파라미터 33	22.21	
PP-034	DSP	파라미터 34	22.58	CPP
PP-035	QC	파라미터 35	22.95	KPP
PP-036	USP	파라미터 36	23.32	
PP-037	DSP	파라미터 37	23.69	CPP
PP-038	QC	파라미터 38	24.06	KPP
PP-039	USP	파라미터 39	24.43	
PP-040	DSP	파라미터 40	24.8	CPP
PP-041	QC	파라미터 41	25.17	KPP
PP-042	USP	파라미터 42	25.54	
PP-043	DSP	파라미터 43	25.91	CPP
PP-044	QC	파라미터 44	26.28	KPP
PP-045	USP	파라미터 45	26.65	
PP-046	DSP	파라미터 46	27.02	CPP
PP-047	QC	파라미터 47	27.39	KPP
PP-048	USP	파라미터 48	27.76	
PP-049	DSP	파라미터 49	28.13	CPP
PP-050	QC	파라미터 50	28.5	KPP
PP-051	USP	파라미터 51	28.87	

3. 공정 파라미터 목록 (3/3)

PP-052	DSP	파라미터 52	29.24	CPP
PP-053	QC	파라미터 53	29.61	KPP
PP-054	USP	파라미터 54	29.98	
PP-055	DSP	파라미터 55	30.35	CPP
PP-056	QC	파라미터 56	30.72	KPP
PP-057	USP	파라미터 57	31.09	
PP-058	DSP	파라미터 58	31.46	CPP
PP-059	QC	파라미터 59	31.83	KPP
PP-060	USP	파라미터 60	32.2	
PP-061	DSP	파라미터 61	32.57	CPP
PP-062	QC	파라미터 62	32.94	KPP
PP-063	USP	파라미터 63	33.31	
PP-064	DSP	파라미터 64	33.68	CPP
PP-065	QC	파라미터 65	34.05	KPP
PP-066	USP	파라미터 66	34.42	
PP-067	DSP	파라미터 67	34.79	CPP
PP-068	QC	파라미터 68	35.16	KPP
PP-069	USP	파라미터 69	35.53	
PP-070	DSP	파라미터 70	35.9	CPP

4. 결론

3월 BR-2001 배치 평균 titer는 배치 기록서(Summary 시트)를 따른다. 목표 4.0 g/L 대비 차이를 다음 분기에 점검한다.