

ZYKLUSZEIT

00:33:28

H : MIN : SEK

STERILISATIONSDAUER

3:30

STERILISATION TEMP.

134.8 / 135.6

MIN / MAX °C

PROGRAMM

Bowie Dick Test

Nr. 5 / PR: 07.03.2018 SW: 103

BENUTZER

User

PROZESSDATEN

| Uhrzeit  | Proz.zeit | Phase              | T2 °C | T3 °C | P2 mbar |
|----------|-----------|--------------------|-------|-------|---------|
| 07:34:01 | 0:01      | 1. Vorvakuum       | 38.2  | 31.1  | 1011    |
| 07:36:31 | 2:31      | 1. Druck           | 69.1  | 31.0  | 82      |
| 07:37:35 | 3:35      | 2. Vorvakuum       | 52.1  | 31.5  | 871     |
| 07:38:27 | 4:27      | 2. Druck           | 72.3  | 31.1  | 102     |
| 07:39:24 | 5:24      | 3. Vorvakuum       | 82.1  | 31.5  | 803     |
| 07:40:13 | 6:13      | 3. Druck           | 54.5  | 31.2  | 100     |
| 07:41:14 | 7:14      | 4. Vorvakuum       | 92.1  | 31.5  | 856     |
| 07:42:04 | 8:04      | 4. Druck           | 66.7  | 31.3  | 99      |
| 07:43:20 | 9:20      | Luftdruck erreicht | 97.8  | 98.7  | 1016    |
| 07:44:34 | 10:34     | 5. Vorvakuum       | 116.2 | 116.2 | 1823    |
| 07:45:20 | 11:20     | 5. Druck           | 107.4 | 103.1 | 1080    |
| 07:46:18 | 12:18     | 6. Vorvakuum       | 116.4 | 116.6 | 1810    |
| 07:47:04 | 13:04     | 6. Druck           | 105.1 | 104.1 | 1085    |
| 07:48:07 | 14:07     | 7. Vorvakuum       | 117.1 | 117.1 | 1869    |
| 07:48:51 | 14:51     | 7. Druck           | 109.0 | 104.8 | 1111    |
| 07:49:50 | 15:50     | Vorvakuum          | 116.7 | 116.7 | 1817    |
| 07:50:35 | 16:35     | Druck              | 110.3 | 104.9 | 1086    |
| 07:51:38 | 17:38     | Vorvakuum          | 117.4 | 116.9 | 1853    |
| 07:52:24 | 18:24     | Aufheizen          | 110.2 | 105.2 | 1080    |
| 07:55:54 | 21:54     | Sterilisation      | 134.5 | 134.4 | 3101    |
| 07:56:53 | 22:53     | Sterilisation      | 135.2 | 134.9 | 3094    |
| 07:57:53 | 23:53     | Sterilisation      | 135.1 | 135.1 | 3101    |
| 07:58:53 | 24:53     | Sterilisation      | 135.1 | 135.2 | 3111    |

| Uhrzeit  | Proz.zeit | Phase         | T2 °C | T3 °C | P2 mbar |
|----------|-----------|---------------|-------|-------|---------|
| 08:07:29 | 33:29     | Programm Ende | 48.5  | 84.7  | 966     |

OPERATOR

User

CHARGE

freigegeben

☐


ja

☐

nein

UNTERSCHRIFT

Prozessverlauf - Messwerte

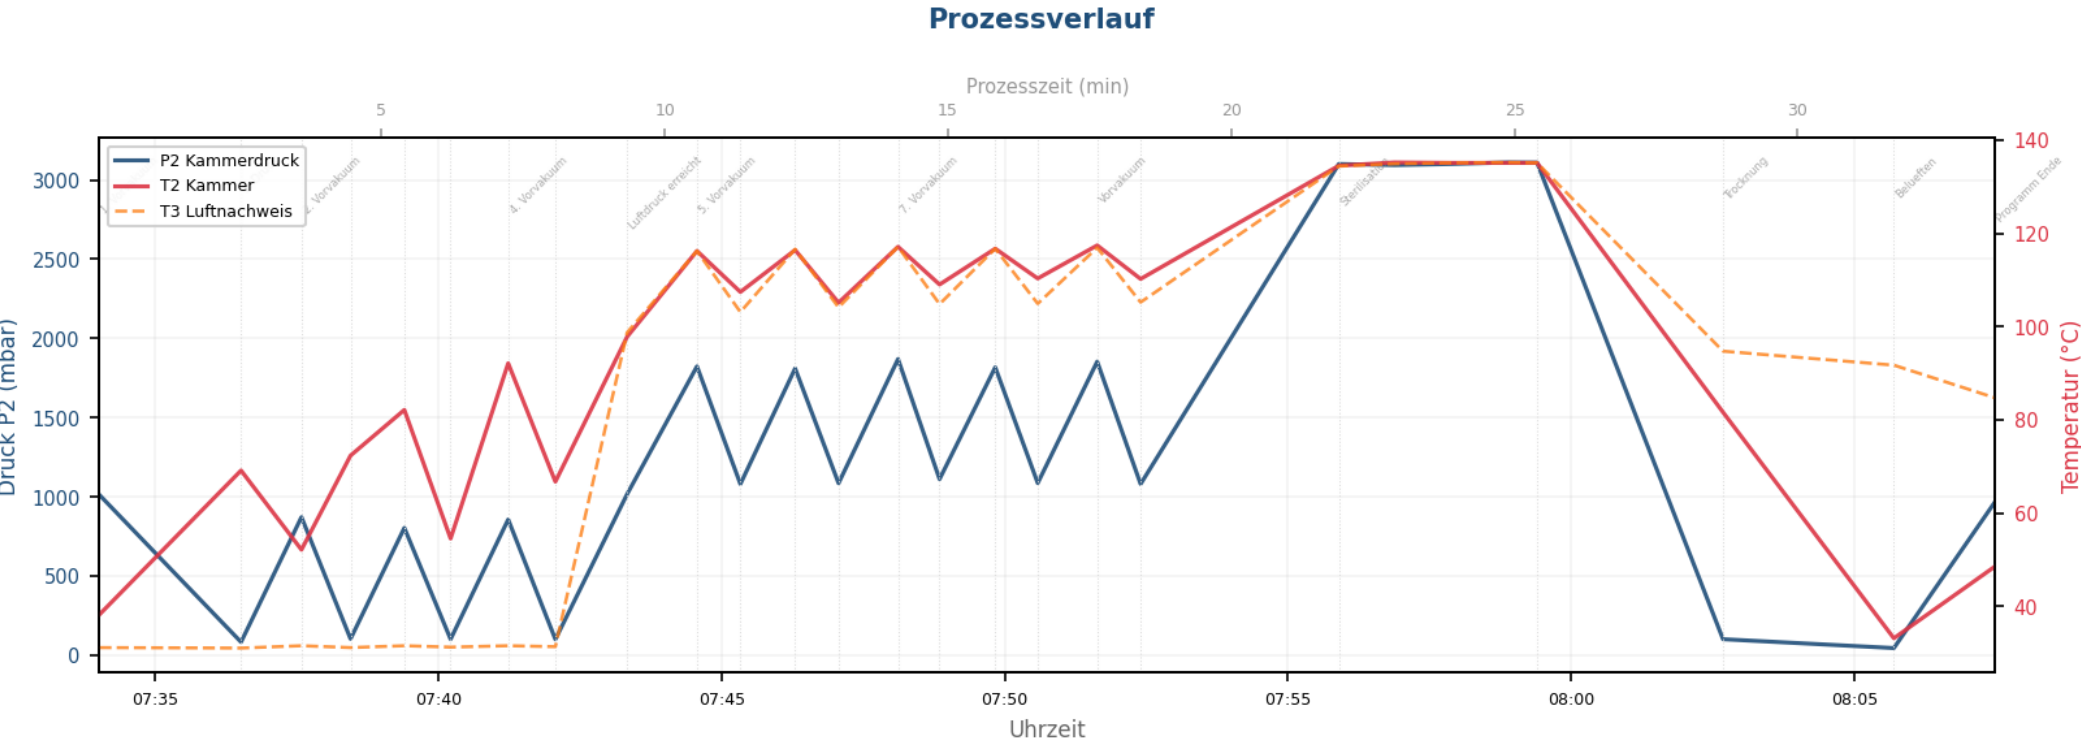

HANDSCHRIFTLICHE DOKUMENTATION (NOTFALLKONZEPT)

STERILISIERTE CONTAINER / SIEBE / INSTRUMENTE

| Nr. | Container / Sieb / Instrument | Verpackungsart | SIE-Nr. | Indikator OK | Bemerkung |
|-----|-------------------------------|----------------|---------|--------------|-----------|
| 1   |                               |                |         |              |           |
| 2   |                               |                |         |              |           |
| 3   |                               |                |         |              |           |
| 4   |                               |                |         |              |           |
| 5   |                               |                |         |              |           |
| 6   |                               |                |         |              |           |
| 7   |                               |                |         |              |           |
| 8   |                               |                |         |              |           |
| 9   |                               |                |         |              |           |
| 10  |                               |                |         |              |           |
| 11  |                               |                |         |              |           |
| 12  |                               |                |         |              |           |
| 13  |                               |                |         |              |           |
| 14  |                               |                |         |              |           |
| 15  |                               |                |         |              |           |
| 16  |                               |                |         |              |           |
| 17  |                               |                |         |              |           |
| 18  |                               |                |         |              |           |

STERILGUT-FREIGABE

☐ Freigegeben ☐ Nicht freigegeben

DATUM / UNTERSCHRIFT: