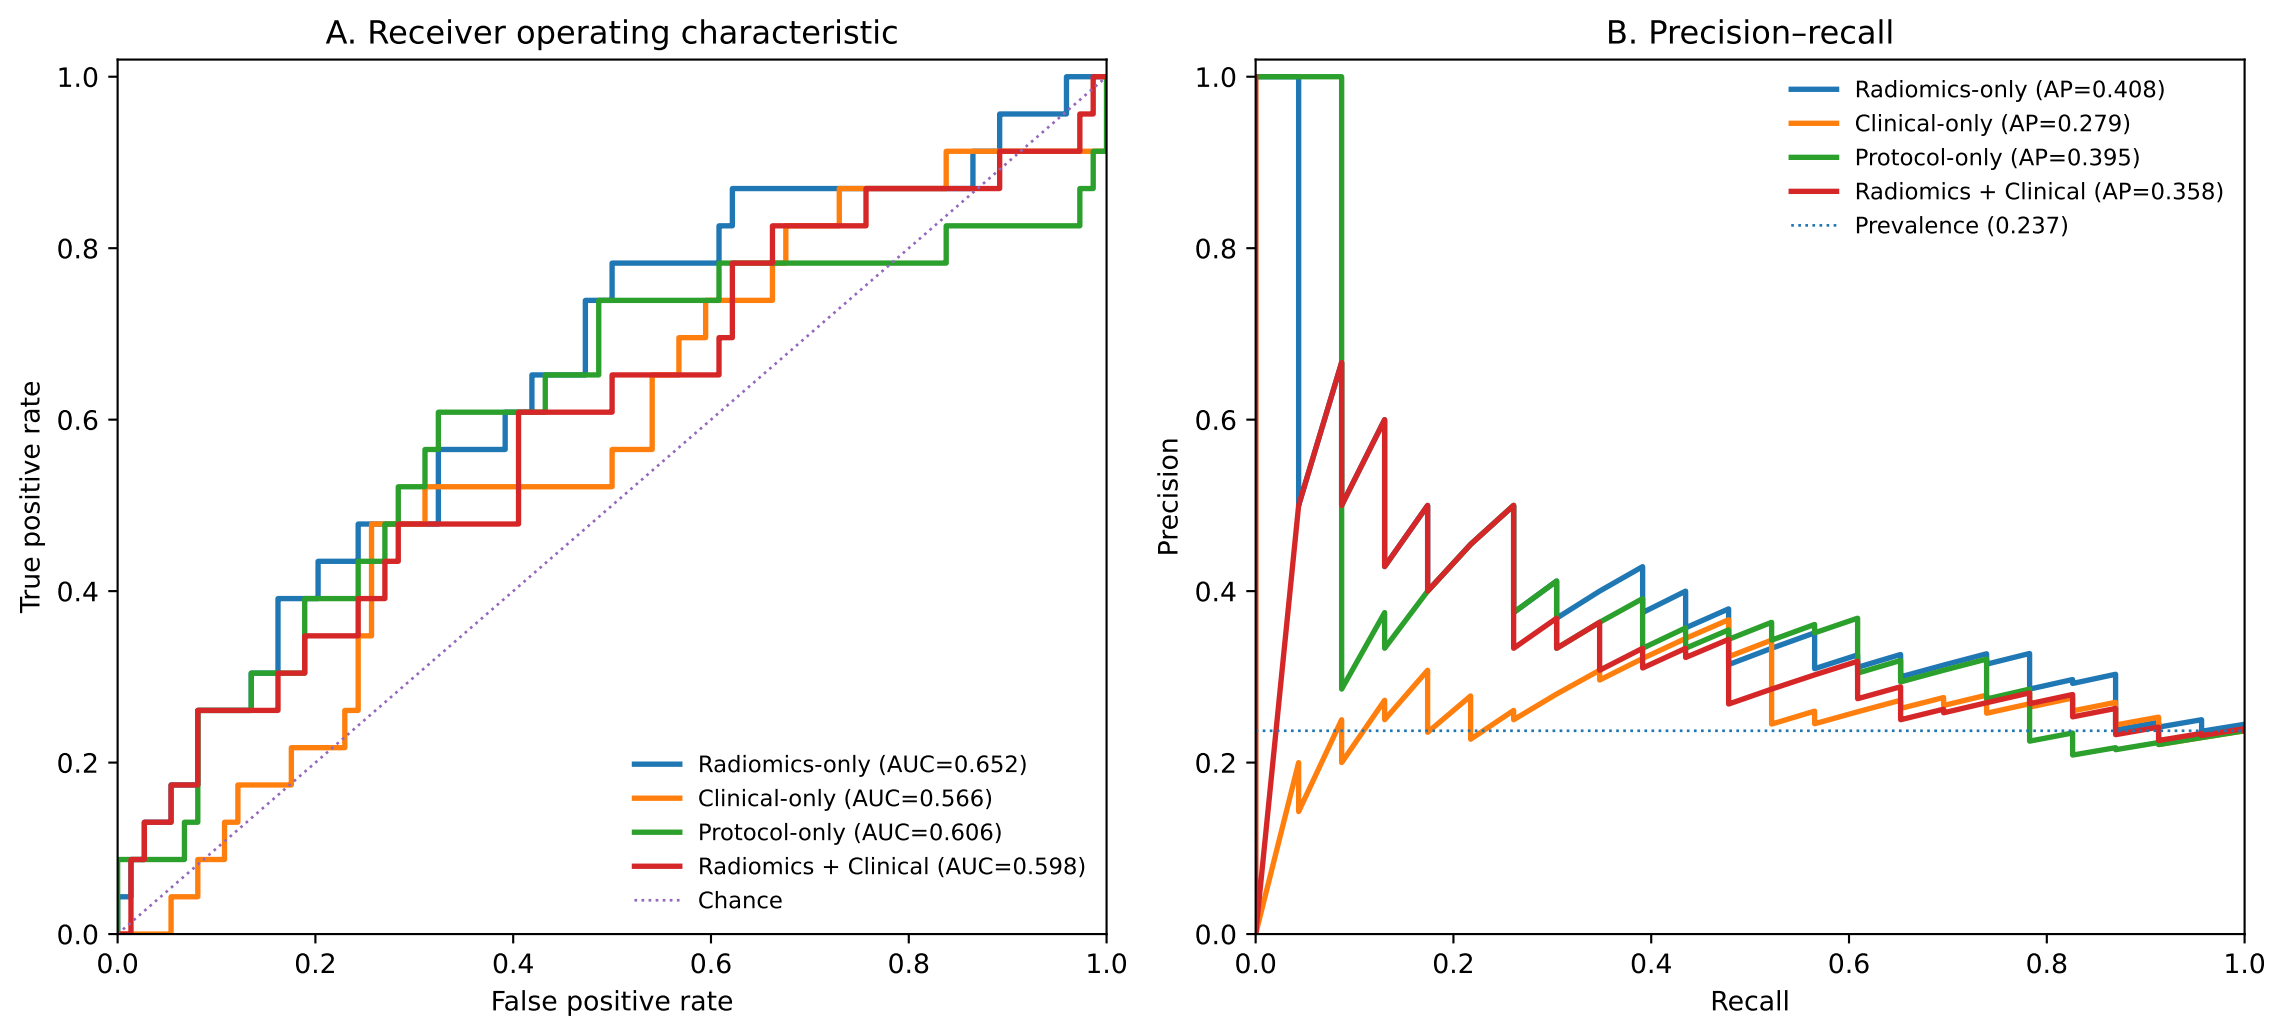
A. Receiver operating characteristic
True positive rate
False positive rate
Radiomics-only (AUC=0.652)
Clinical-only (AUC=0.566)
Protocol-only (AUC=0.606)
Radiomics + Clinical (AUC=0.598)
Chance
B. Precision–recall
Precision
Recall
Radiomics-only (AP=0.408)
Clinical-only (AP=0.279)
Protocol-only (AP=0.395)
Radiomics + Clinical (AP=0.358)
Prevalence (0.237)