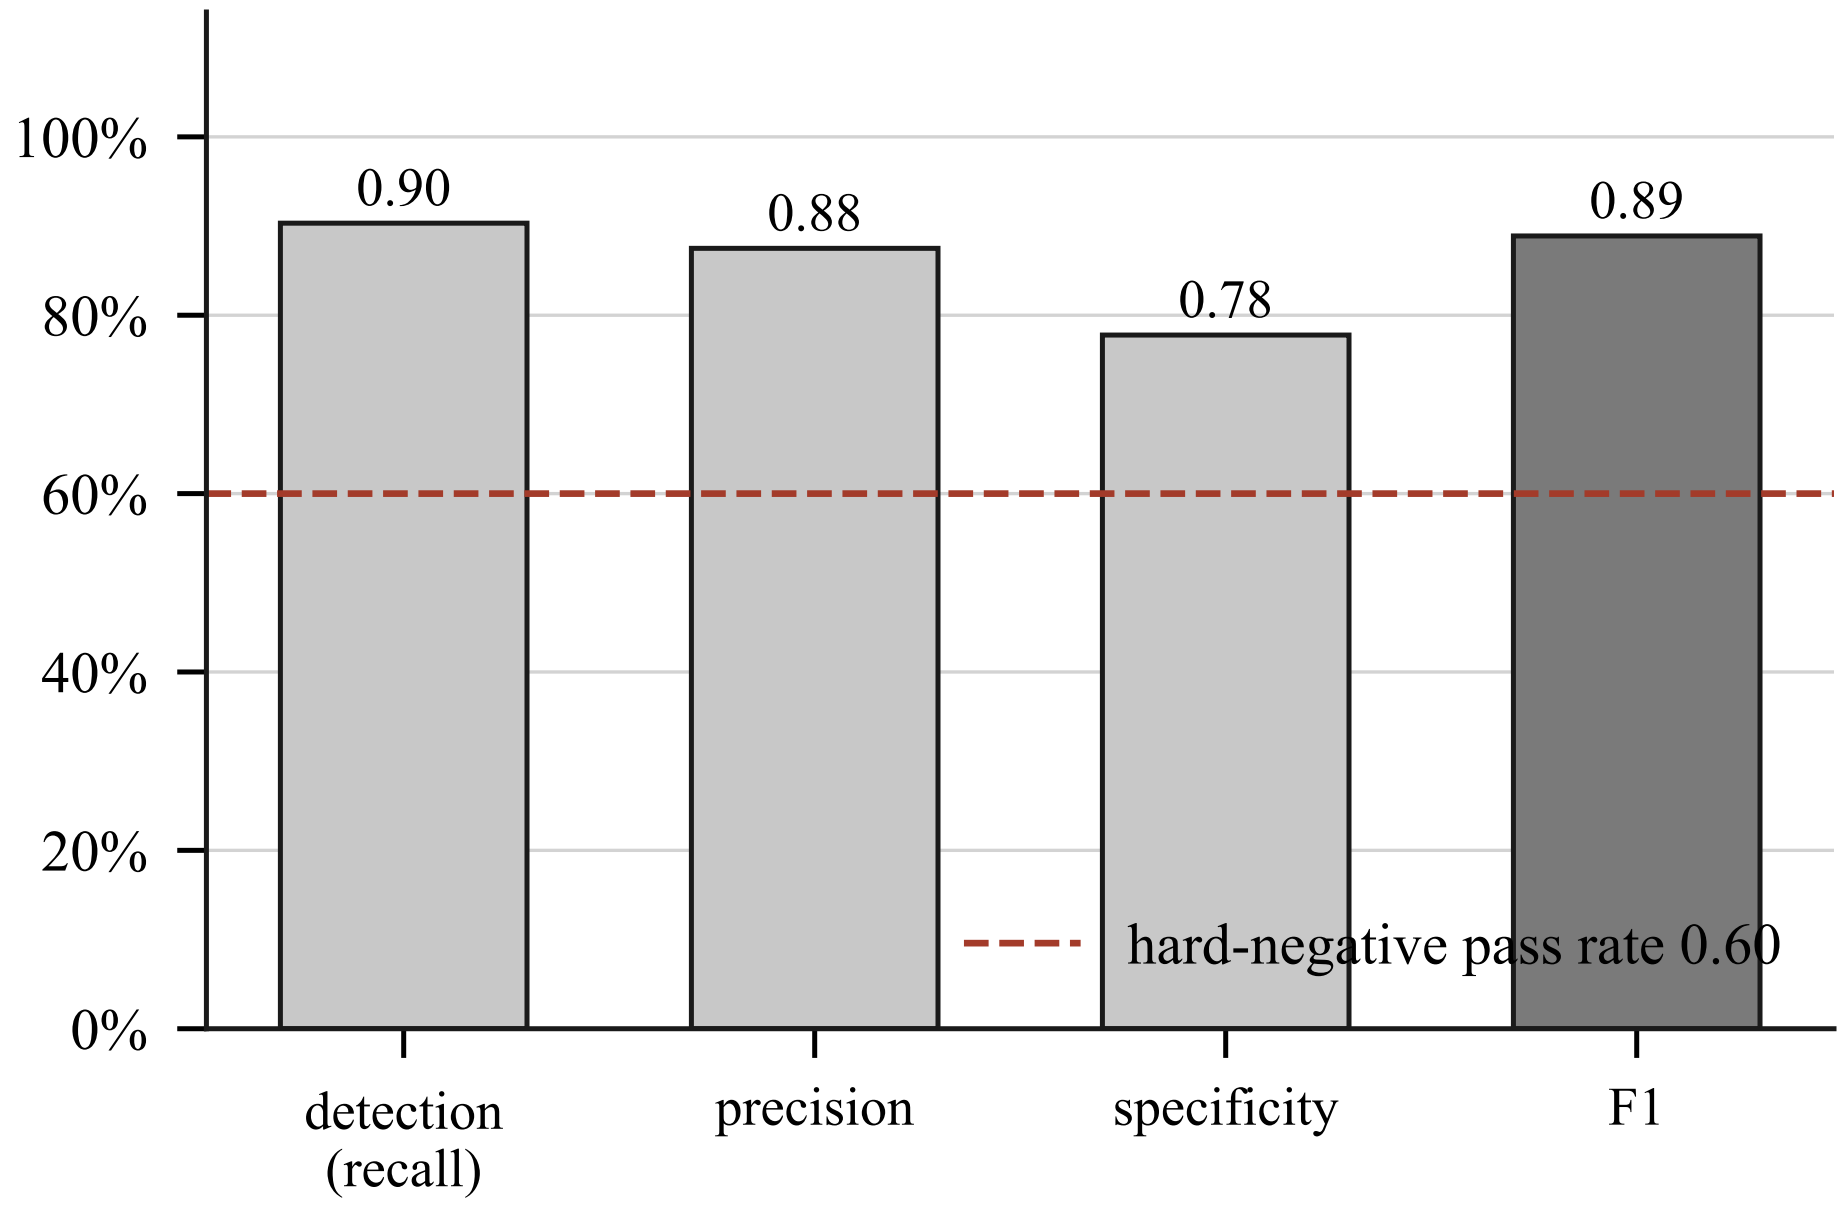
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0.90
0.88
0.78
0.89
hard-negative pass rate 0.60
detection (recall)
precision
specificity
F1