

一般歯科材料在庫管理システム

在庫確認、出庫、不足確認、発注候補、納品確認までを一つの流れで扱うための試用デモ資料

日常出庫

よく使う材料をすばやく記録

不足確認

最低在庫を下回った材料を把握

発注準備

発注候補、送付記録、納品確認



紙やExcelだけでは、在庫判断が人の記憶に寄りやすい。

最初のデモでは、現場で起きやすい小さな困りごとを、日常操作の流れで確認します。

- どの商品が不足しているか分かりにくい
- 発注すべき商品が担当者の記憶に頼りやすい
- 在庫を減らした理由や操作履歴が残りにくい
- バーコード、ロット番号、有効期限を日常業務に活かしにくい
- 棚卸結果と普段の在庫数の差が追いにくい

目的

在庫が見える、足りないものが分かる、日常出庫をすぐ記録できる状態を作ります。

ホームから、日常操作と要確認情報へすぐ進めます。

出庫、不足、発注候補、バーコード出入庫を上部に集約しています。



上部の主要導線

クイック出庫、不足在庫、発注候補、バーコード出入庫を大きく表示します。

今日の状況



在庫登録数、不足件数、発注候補、クイック出庫カード数をまとめて確認できます。

要対応の確認

在庫0、不足在庫、未確認の発注候補、期限ロットを優先的に見られます。

よく使う材料は、クイック出庫でスピード重視に。

通常使用の出庫は毎回理由入力を求めず、履歴には「クイック出庫」として残します。

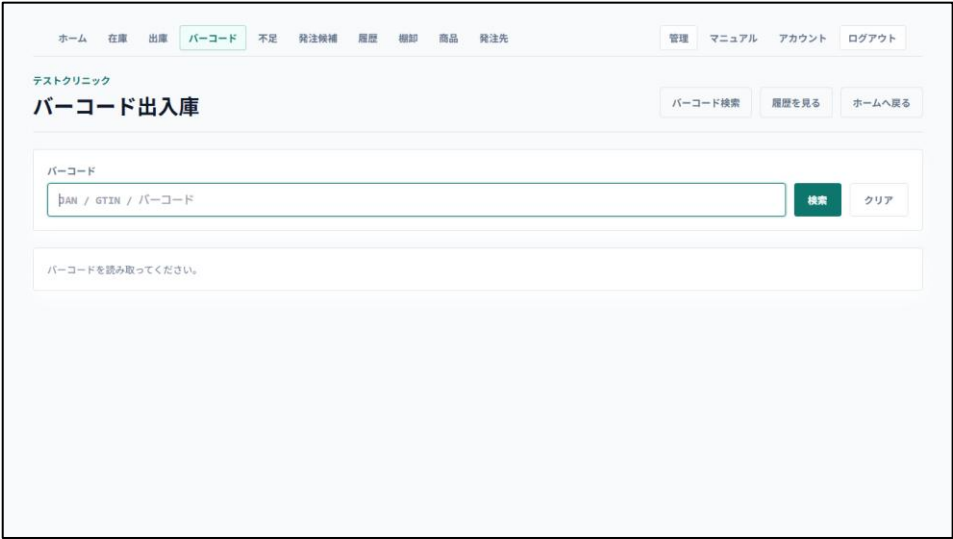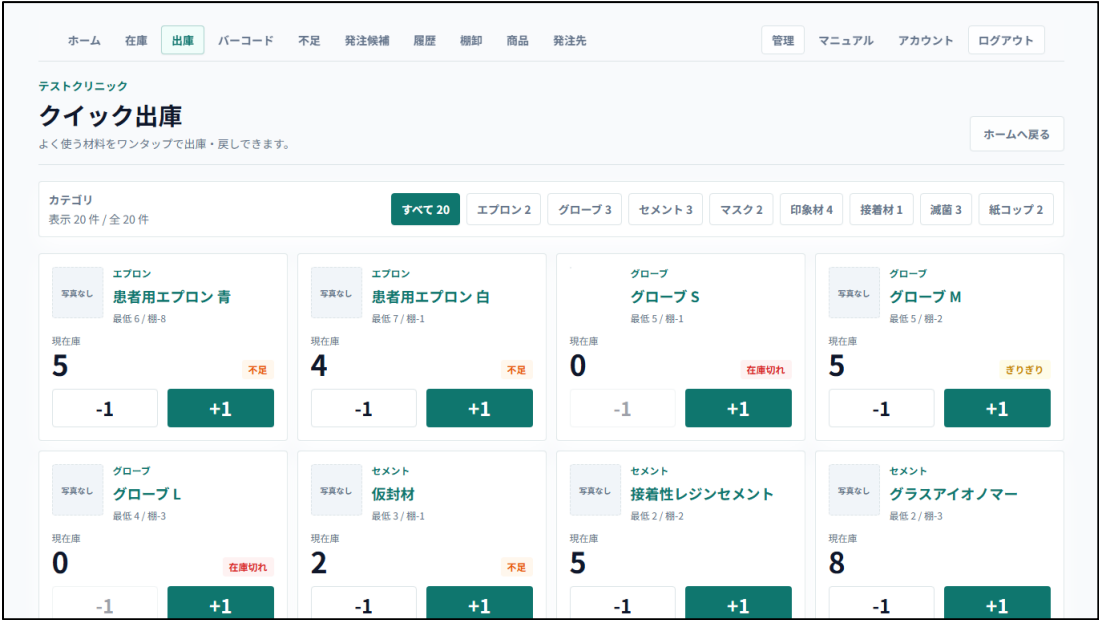

理由を詳しく残す場合

在庫一覧の直接編集やバーコード出入庫で、数量と理由を確認して記録します。

不足から発注へ

不足在庫から発注候補へ、確認作業をつなげます。

最低在庫を下回った商品を一覧化し、必要なものを発注候補に追加します。

ホーム在庫出庫バーコード不足発注候補履歴棚卸商品発注先管理マニュアルアカウントログアウト

テストクリニック
不足在庫一覧
発行日時: 2026/05/23 13:01

ホームへ戻る印刷

商品名・商品コード・JAN・カテゴリ・発注先検索クリア

表示 14 件 / 不足 14 件

商品名	現在庫	最低在庫	不足数	発注先	発注候補
サージカルマスク P-0004 / マスク	0	6	6	架空メディカルサプライ	追加済み
グローブ S P-0001 / グローブ	0	5	5	架空ディーラーA	追加済み
グローブ L P-0003 / グローブ	0	4	4	架空ディーラーC	追加済み
フェイスシールド P-0005 / マスク	0	4	4	架空デンタル物流	追加済み
患者用エプロン白 P-0009 / エプロン	4	7	3	架空メディカルサプライ	追加済み

ホーム在庫出庫バーコード不足発注候補履歴棚卸商品発注先管理マニュアルアカウントログアウト

テストクリニック
発注候補
発行日時: 2026/05/23 13:01

不足一覧へ発注書下書き発注記録印刷

商品名・商品コード・カテゴリ・発注先・メモ検索クリア

すべて未確認確認済み取り消し発注済み

表示 6 件 / 検索後 6 件 / 全 6 件

架空ディーラーA1件この発注先の下書き

☐ 送付済み確認
送付方法
選択してください
送付メモ（任意）
先方対応メモ（任意）

発注済み・送付方法・納品確認まで、記録として残せます。

外部送信はせず、人が送付した後にアプリへ記録する形です。

1. 発注候補を確認

発注先ごとに候補を確認し、数量やメモを調整します。

2. 発注書下書きを印刷

ブラウザ印刷またはPDF保存で、人が発注先へ送付します。

3. 発注済みを記録

送付方法、送付メモ、先方対応メモを残せます。

4. 納品確認

納品数量、ロット番号、有効期限を記録し、必要に応じて在庫へ入庫反映します。

自動送信は未対応

メール、FAX、LINE、ディーラーへの自動発注は現時点では行いません。

本格試用の最初の山は、商品マスタの準備です。

JANコードはバーコード検索の土台になりますが、商品名や発注先まで自動で全て埋まるわけではありません。

あるとよい項目

商品名、カテゴリ、現在庫、最低在庫、単位、JANコード、主発注先、品番、発注単位

現実的な進め方

ディーラーや院内の既存管理表から商品一覧サンプルをもらい、取り込み形式に整えて一括投入します。

最初から全商品を完璧に整えるより、よく使う商品から始めて、実運用に合わせて育てる進め方が現実的です。

デモ確認後、商品一覧サンプルをもとに試用準備へ進みます。

初回確認では、画面の流れが現場に合うかを中心に見ます。

- 顧客に画面を見もらう
- 試用するかどうかを確認する
- 試用する場合、商品一覧のサンプルデータを用意する
- 取り込み項目を確認し、商品マスタを整形する
- 実際の業務に近い形で試用し、不足項目を確認する

デモの位置づけ

正式運用前の試用確認です。実在患者情報や秘密情報は入力しません。