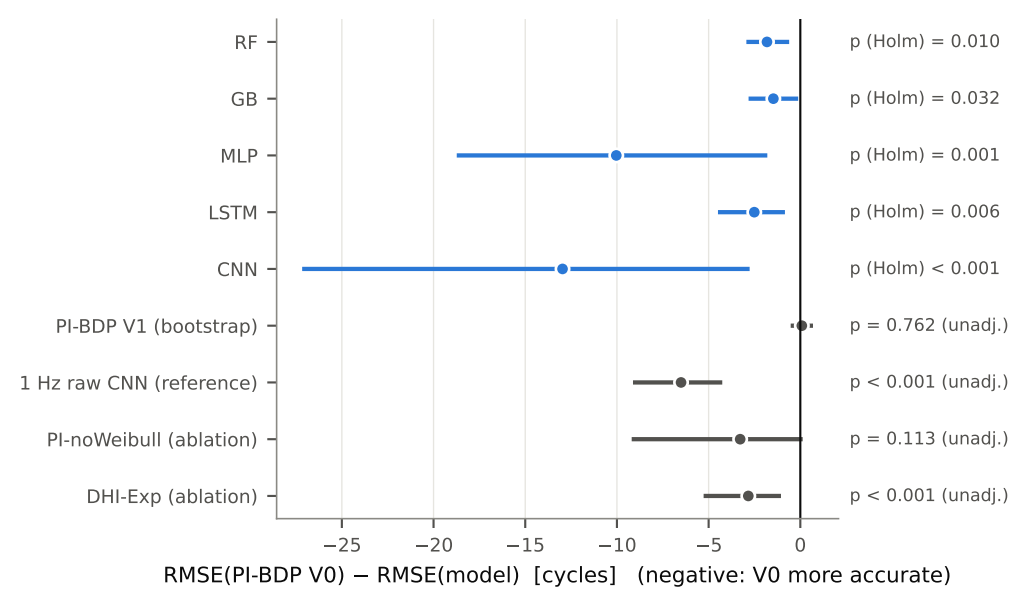
RF
GB
MLP
LSTM
CNN
PI-BDP V1 (bootstrap)
1 Hz raw CNN (reference)
PI-noWeibull (ablation)
DHI-Exp (ablation)
p (Holm) = 0.010
p (Holm) = 0.032
p (Holm) = 0.001
p (Holm) = 0.006
p (Holm) < 0.001
p = 0.762 (unadj.)
p < 0.001 (unadj.)
p = 0.113 (unadj.)
p < 0.001 (unadj.)
−25
−20
−15
−10
−5
0
RMSE(PI-BDP V0) − RMSE(model) [cycles] (negative: V0 more accurate)