CHACO IMPLANTES

al servicio de la salud...

FOLLETO DE PRODUCTO

LÍNEA CADERA

SISTEMA DE CADERA

# X-ACTA

## TALLO FEMORAL CEMENTADO

Doble conicidad

Diseño sin collar




### DOBLE CONICIDAD · SIN COLLAR

Diseño cementado con cuatro opciones de offset.

FABRICADO POR

Medacta International

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud.


DISTRIBUIDO POR

**CHACO IMPLANTES**

Resistencia, Chaco · Argentina

# Seis decisiones visibles en un solo diseño

Geometría altamente pulida y de doble conicidad,
con referencias visuales para una inserción controlada.

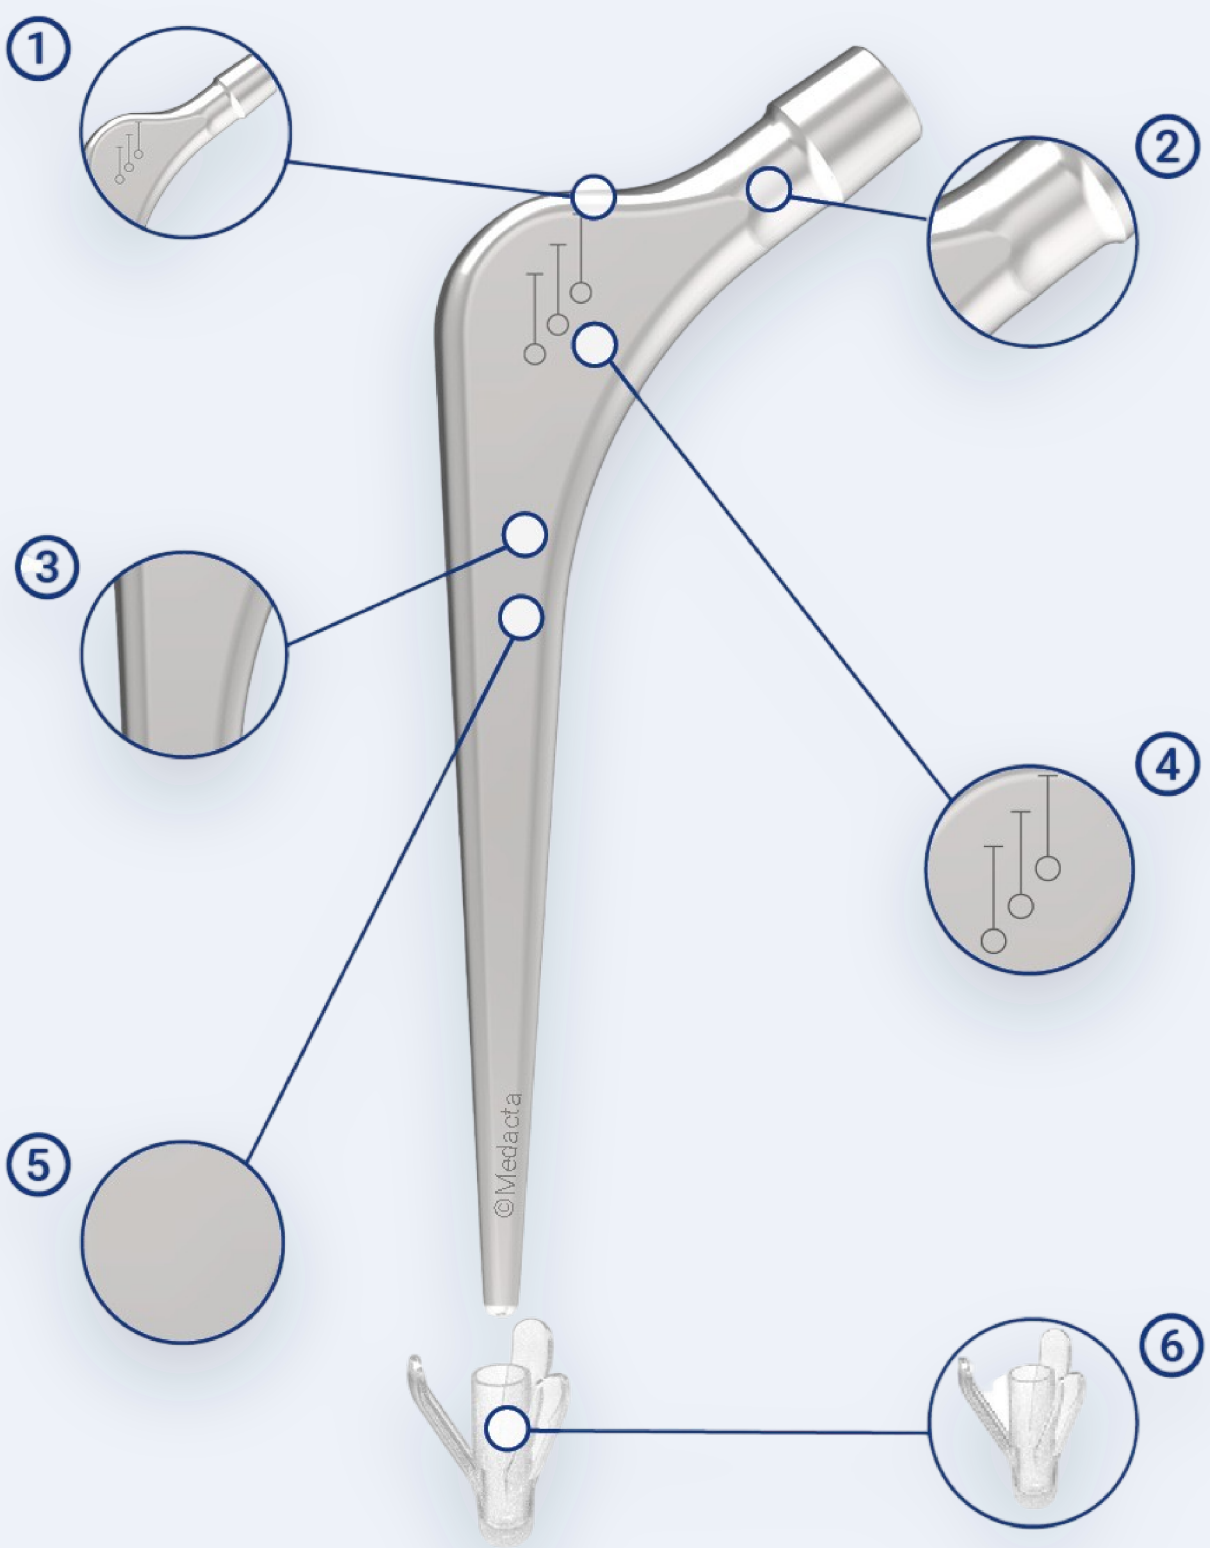


**01** Sin collar

**02** Cono con micro-rosca

**03** Doble conicidad

**04** Marcas cada 4 mm


**05** Altamente pulido

**06** Centralizador distal

| MATERIAL | ÁNGULO CCD | FIJACIÓN |
|---|---|---|
| ACERO INOXIDABLE | 125° CCD | CEMENTADO |

# Centralización distal según el canal femoral

El centralizador facilita el posicionamiento correcto y una distribución uniforme del cemento.

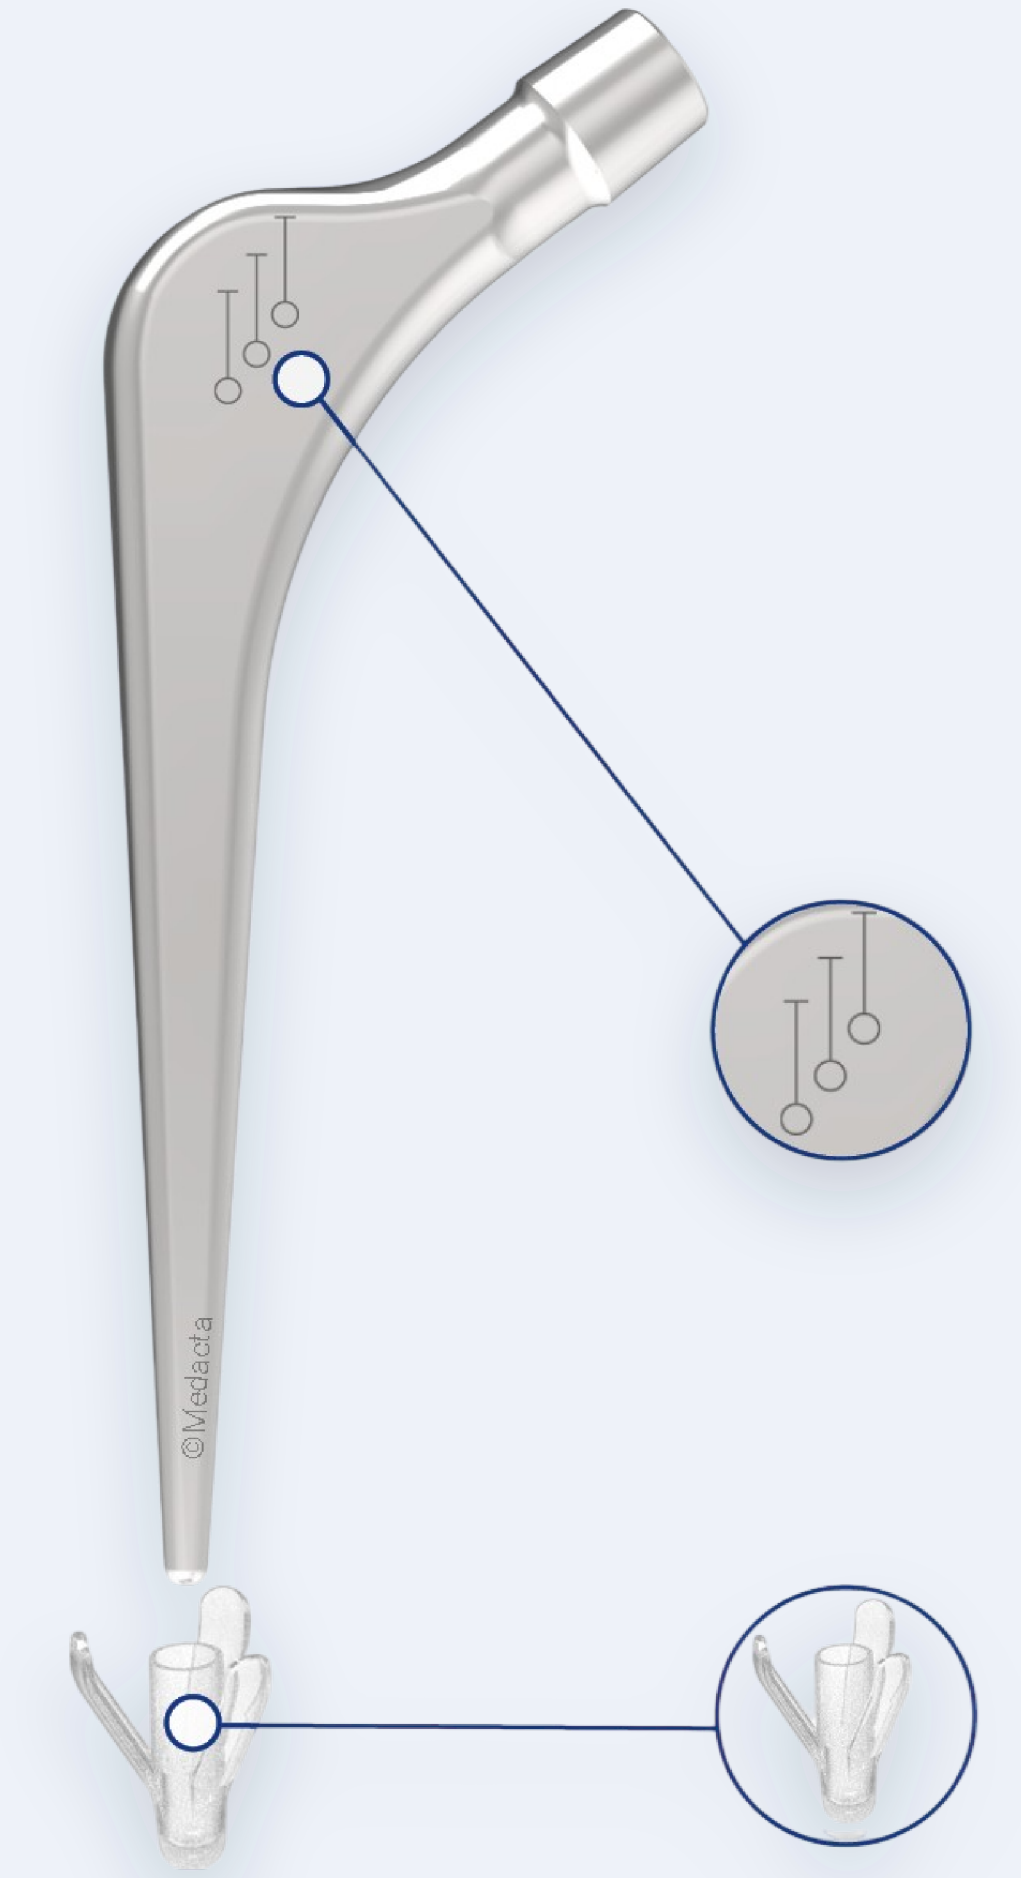


**SIN ALETAS** — **< Ø10 mm**

Para canales menores que el centralizador regular cerrado.

**REGULAR** — **Ø10–Ø18 mm**

Configuración estándar para el rango intermedio del canal.

**GRANDE** — **> Ø18 mm**

Para canales mayores que el regular completamente abierto.

**CEMENTACIÓN RETRÓGRADA** | **PRESURIZACIÓN DEL CEMENTO**

# Cuatro offsets para ajustar la reconstrucción

Opciones de offset y tamaño resumidas para consulta rápida. La selección definitiva se confirma con la técnica completa.



## 35,5 mm

**ESTÁNDAR**

Tamaño 0



## 37,5 mm

**ESTÁNDAR · CORTO**

Tamaños 0–4



## 44 mm

**ESTÁNDAR · CORTO**

Tamaños 0–4




## 50 mm

**ESTÁNDAR · CORTO**

Tamaños 1–4

# Dos longitudes con un CCD de 125°

La versión corta reduce la longitud del hombro manteniendo la familia de offsets seleccionada.

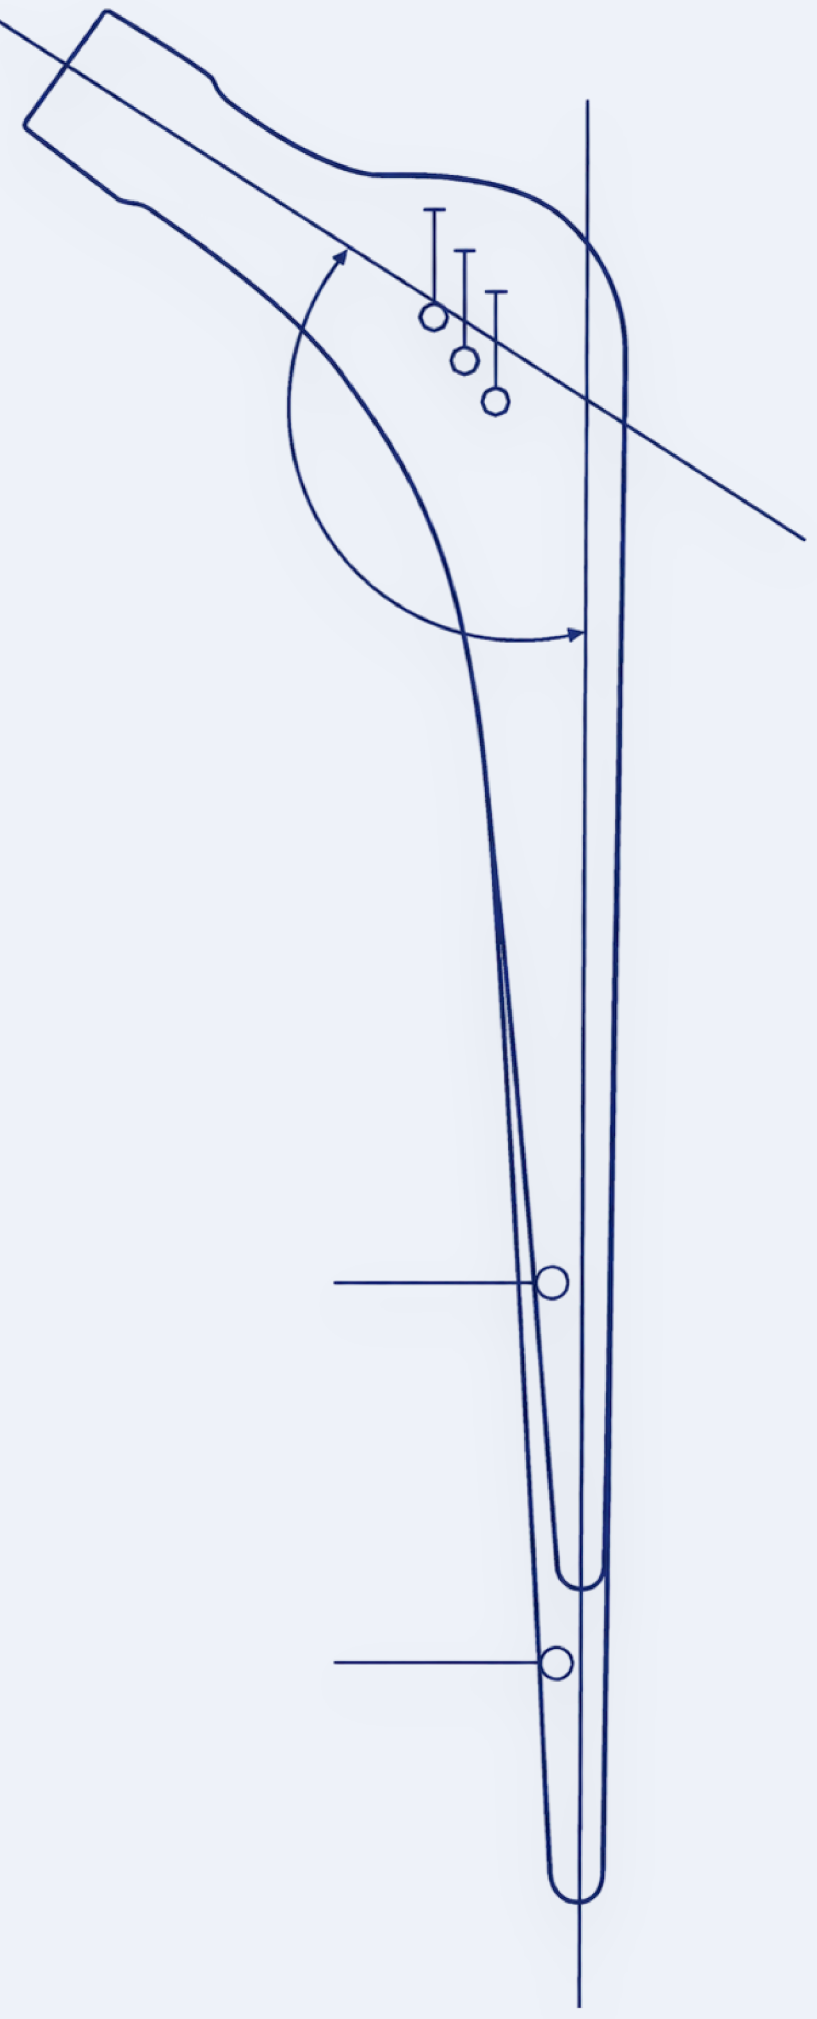

ÁNGULO CCD

## 125°

ESTÁNDAR

### 127–149 mm

Longitud de hombro según la configuración de offset.

CORTO

### 123–124 mm

Disponible para offsets 37,5 · 44 · 50 mm.

La opción de 35,5 mm se ofrece únicamente en longitud estándar.

# De la planificación a la cementación final

Cuatro momentos clave para ordenar la preparación, la prueba y la implantación del tallo X-acta.

**01 — Planificación**

Preselección del tamaño y nivel de resección.

**02 — Preparación femoral**

Apertura y raspado progresivo del canal femoral.

**03 — Reducción de prueba**

Control de movilidad, estabilidad y longitud del miembro.

**04 — Cementación**

Centralizador distal, cementación retrógrada e inserción.





FIJACIÓN

**TALLO CEMENTADO**

CONTROL FINAL

**MOVILIDAD · ESTABILIDAD**
**LONGITUD DEL MIEMBRO**

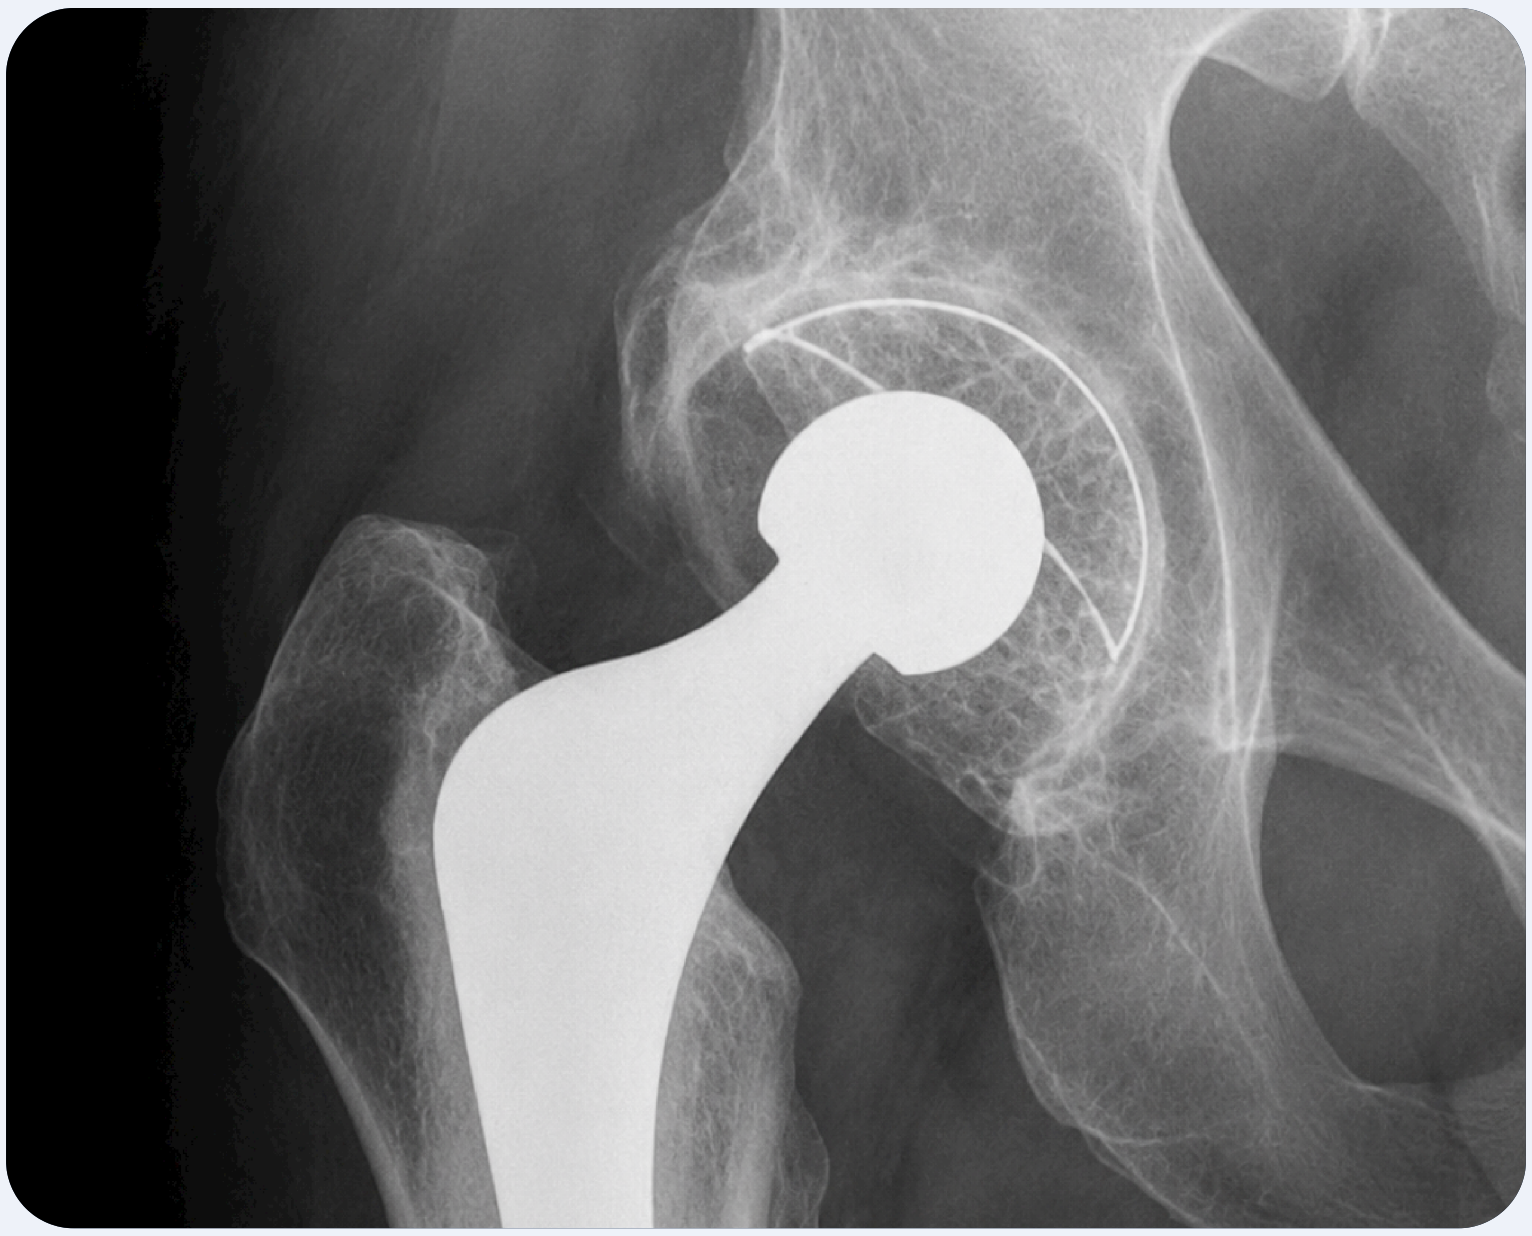

# Una solución cementada en dos longitudes

**DOBLE CONICIDAD**

Geometría pulida y sin collar.

**CUATRO OFFSETS**

35,5 · 37,5
44 · 50 mm.

**CENTRALIZADOR**

Tres opciones según el canal femoral.

## Consultá la técnica quirúrgica completa

Tallo X-acta® · Ref. 99.60.12 · Rev. 06

**Descargá la ficha completa** →


**DIRECCIÓN**

Corrientes 781
Resistencia, Chaco (3500)

**INSTAGRAM**

@chacoimplanteok


CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud...

FABRICADO POR Medacta International

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud. · chacoimplantes@gmail.com