CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud

FOLLETO DE PRODUCTO
LÍNEA HOMBRO

SISTEMA DE ARTROPLASTIA DE HOMBRO

HOMBRO ANATÓMICO

Plataforma modular para reconstrucción anatómica



COMPONENTES COORDINADOS. CONFIGURACIÓN ADAPTABLE.

FABRICADO POR
Medacta International

DISTRIBUIDO POR
CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud

Una arquitectura. Componentes coordinados.

La plataforma reúne glenoides, cabeza, doble excéntrico, metáfisis y diáfisis dentro de una configuración anatómica modular.



ARTICULACIÓN

Cabeza humeral
y componente glenoideo.

AJUSTE

Doble excéntrico
y metáfisis anatómica.

FIJACIÓN

Alternativas humerales
cementadas
y no cementadas.

Dos estrategias.
Una plataforma humeral.

La selección combina alternativas diafisarias y metafisarias según anatomía, calidad ósea y estabilidad obtenida.



DIAFISIS ESTANDAR

Cementada
y no cementada.



SIN VASTAGO

Configuración
metafisaria compacta.



METAFISIS ANATOMICA

Interfaz proximal
para montaje modular.

NO CEMENTADA

Tamaños 6-16

CEMENTADA


Tamaños pares 6-16

SELECCIÓN

Control intraoperatorio

Tres inclinaciones. Superficie proximal.

La metáfisis anatómica ofrece tres inclinaciones y variantes cementadas o no cementadas según la configuración elegida.

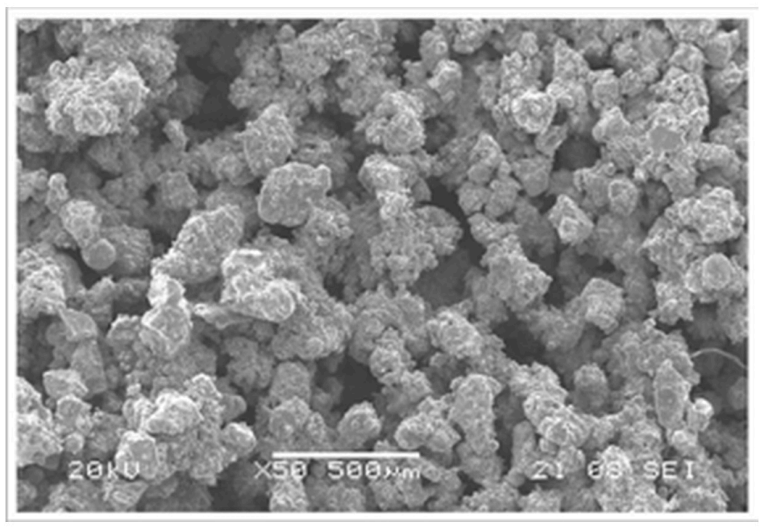

MICROESTRUCTURA MECTAGRIP

Lectura microscópica de la superficie porosa proximal.



128°

INCLINACIÓN

135°

INCLINACIÓN


142°


INCLINACIÓN


Disponibles en configuraciones cementadas y no cementadas.

Cobertura anatómica. Ajuste coordinado.

La cabeza humeral y el doble excéntrico permiten reproducir la cobertura y registrar la orientación definida en la prueba.

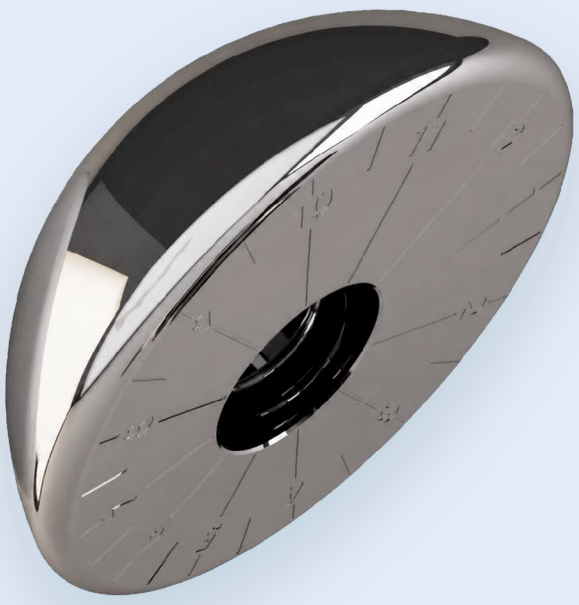

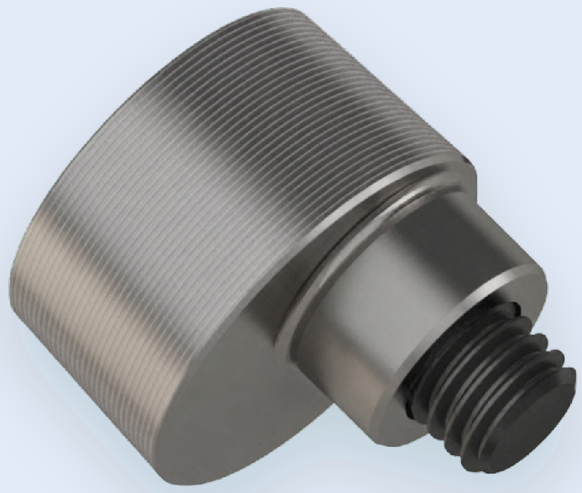

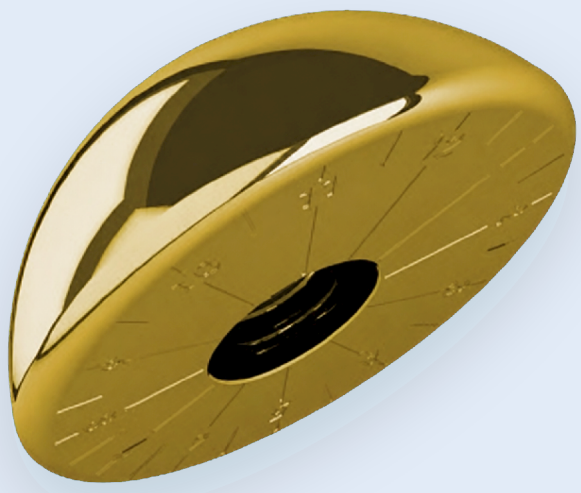

CABEZA METÁLICA

Ø40-58 mm

DOBLE EXCÉNTRICO

Offset y orientación

SensiTiN


Opción de acabado

REGISTRO DE POSICIÓN

Referencias alfabéticas y horarias facilitan el registro de la posición.

Interfaz glenoidea. Cobertura cementada.

El componente glenoideo con tetones completa la articulación y se selecciona en relación con la cabeza humeral.

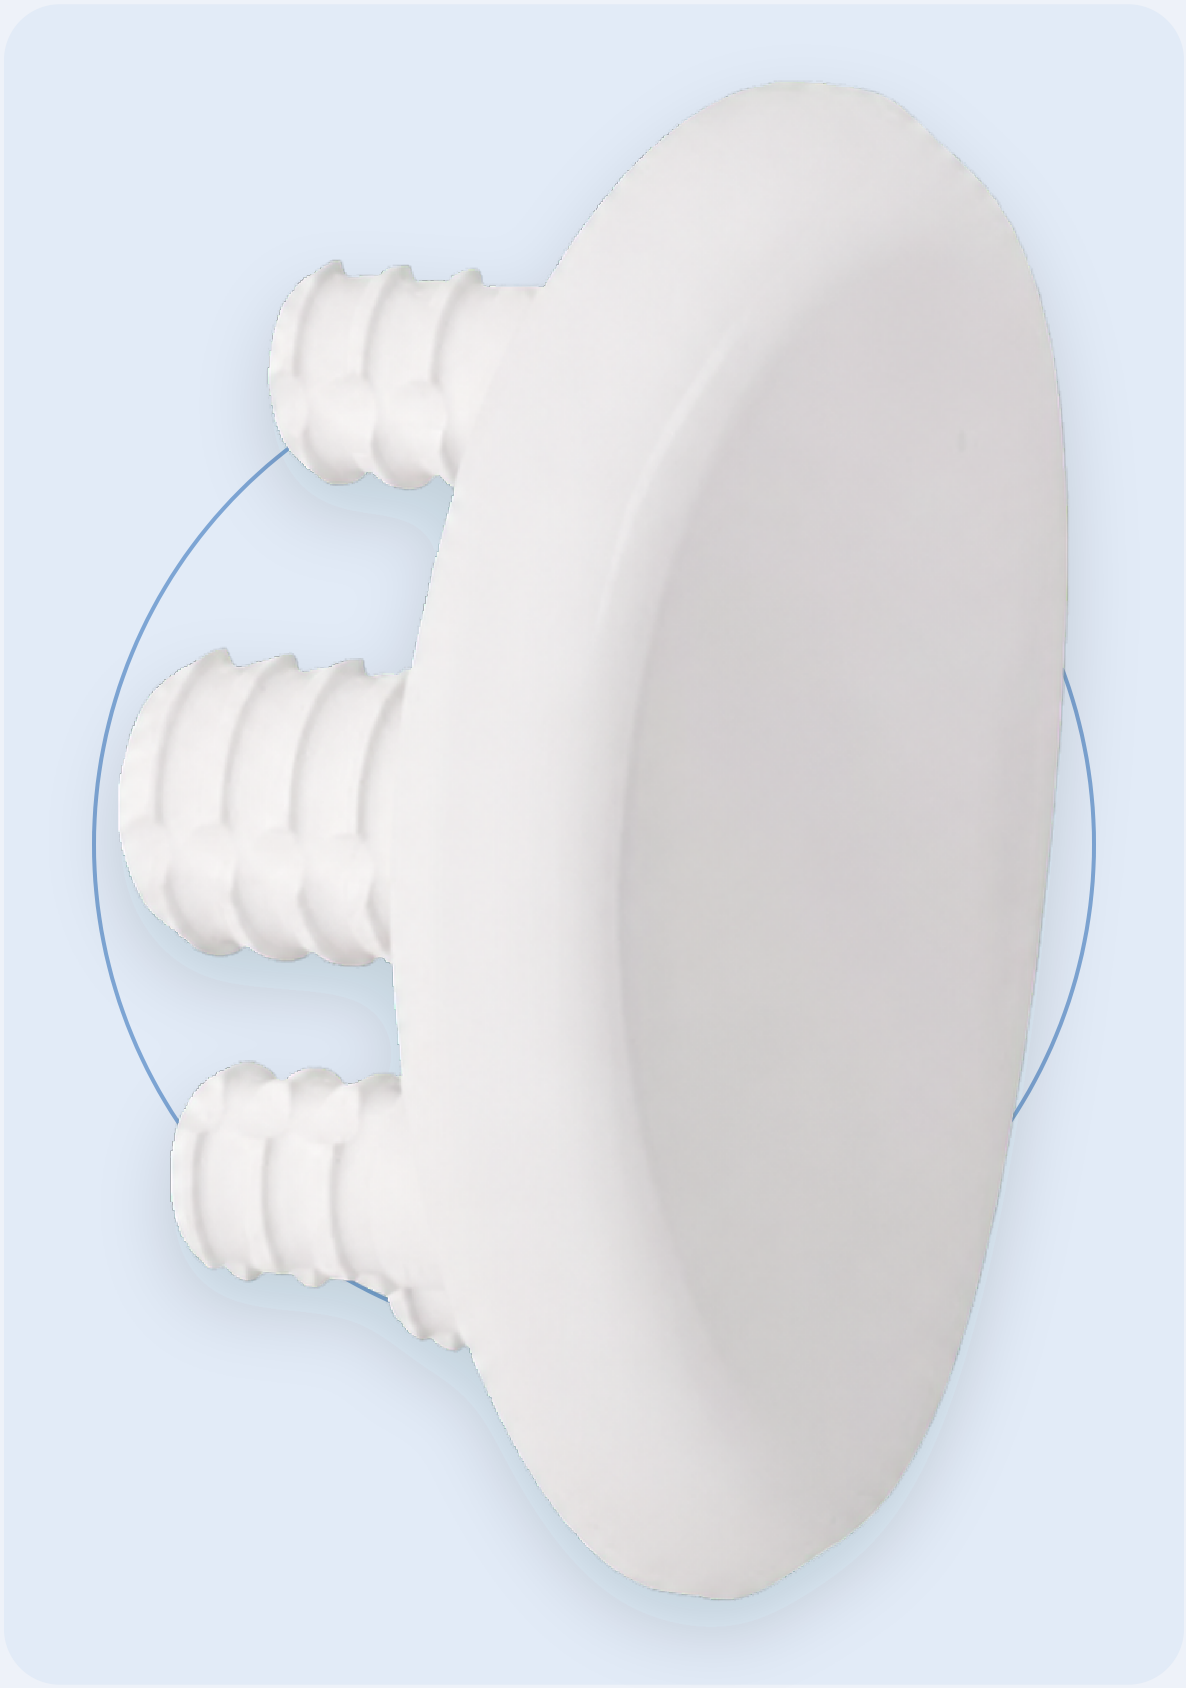

APLICACIÓN

CEMENTADO

Fijación mediante cemento óseo.

DIÁMETROS

Ø40-58 mm

Diez tamaños en pasos de 2 mm.


DESAJUSTE

2-10 mm

Según la combinación permitida.

La combinación final depende del tamaño de cabeza humeral seleccionado.

Sistema anatómico.
Ajuste coordinado.

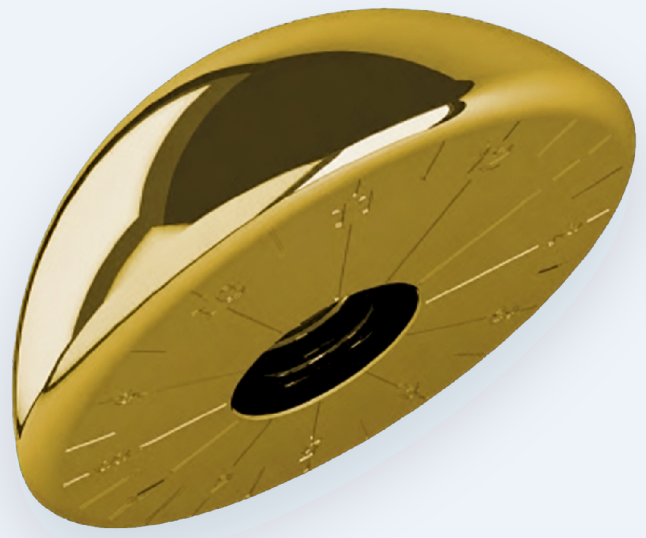

MODULARIDAD

Cabeza, excéntrico, metáfisis y diáfisis.

CONFIGURACIÓN

Alternativas cementadas y no cementadas.

RANGO

Cabezas y glenoides de Ø40 a Ø58 mm.

Consultá la ficha técnica completa

Técnica quirúrgica Hombro Anatómico · Ref. 99.81A.12 · REV. 02

Descargá la ficha completa →

DIRECCIÓN

Corrientes 781
Resistencia, Chaco (3500)

INSTAGRAM

@chacoimplanteok