Barlow Ratio for Xsec SHMS Calorimeter PID (0.8,1.2)

θ_{nq} = 5 ± 5

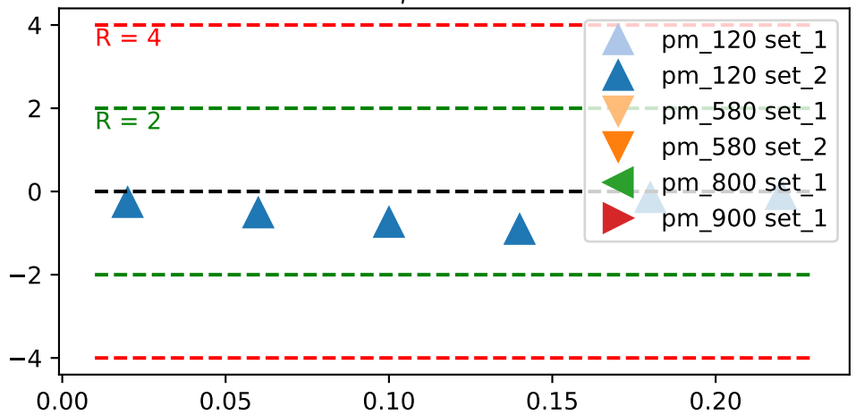

θ_{nq} = 15 ± 5

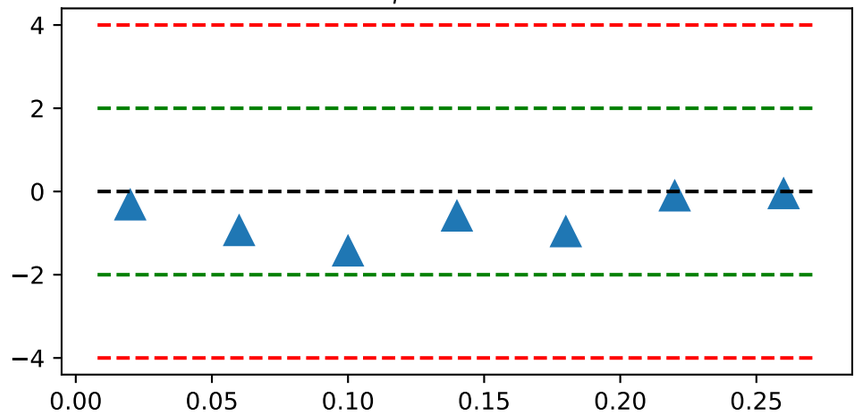

θ_{nq} = 25 ± 5

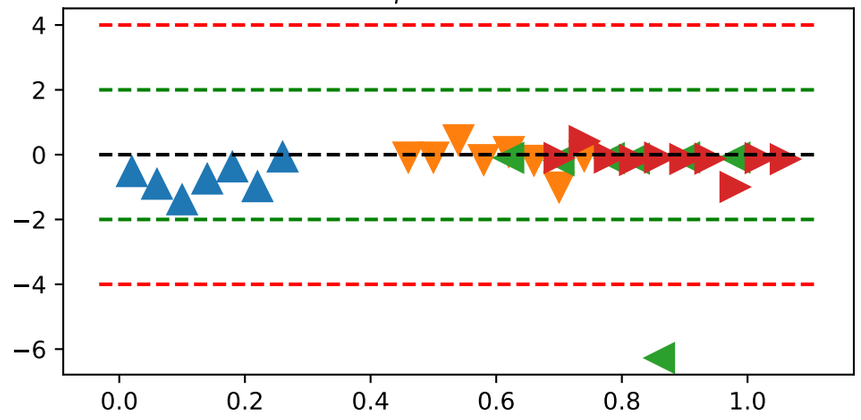

θ_{nq} = 35 ± 5

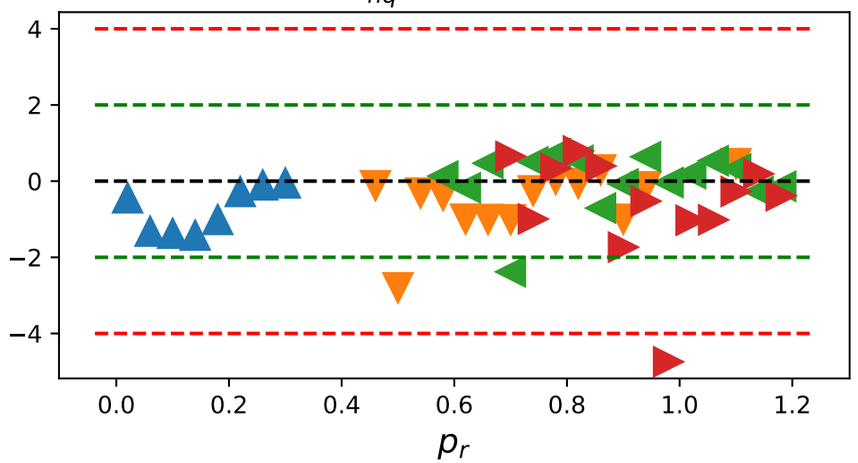

θ_{nq} = 45 ± 5

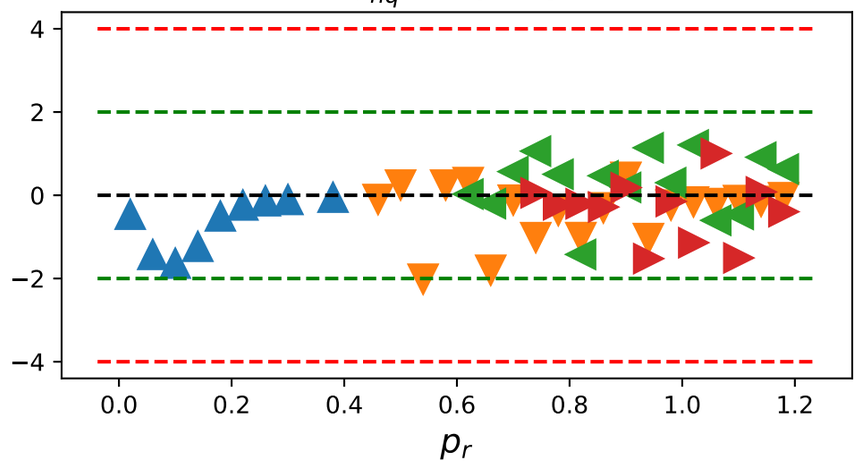

θ_{nq} = 55 ± 5

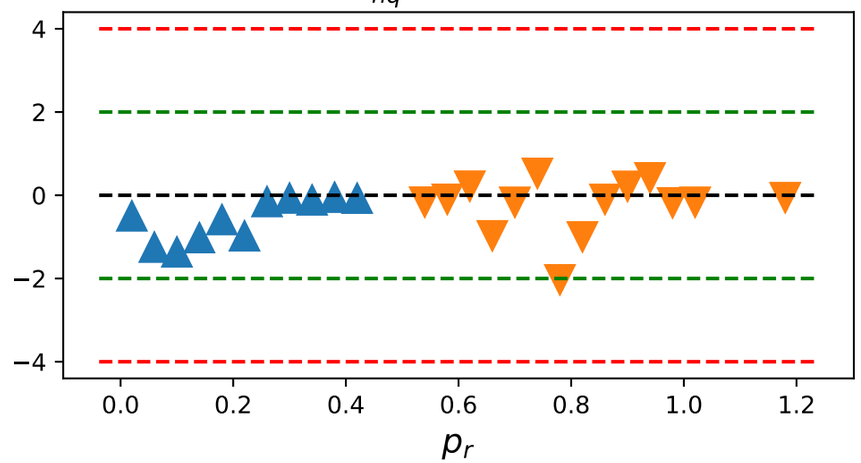

θ_{nq} = 65 ± 5

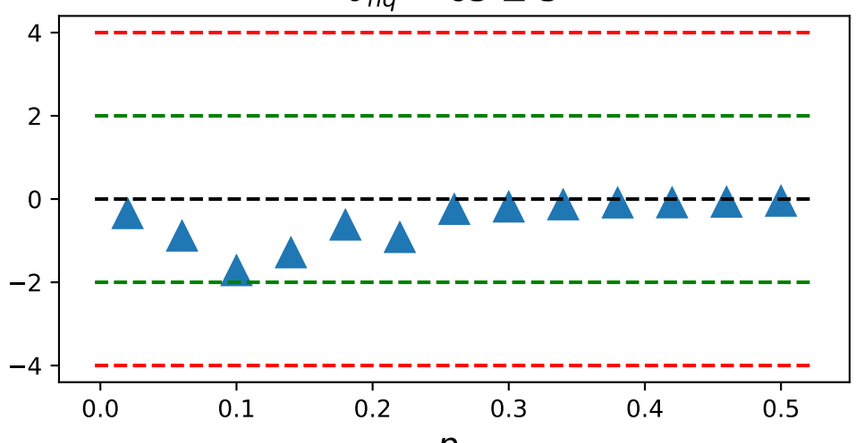

θ_{nq} = 75 ± 5

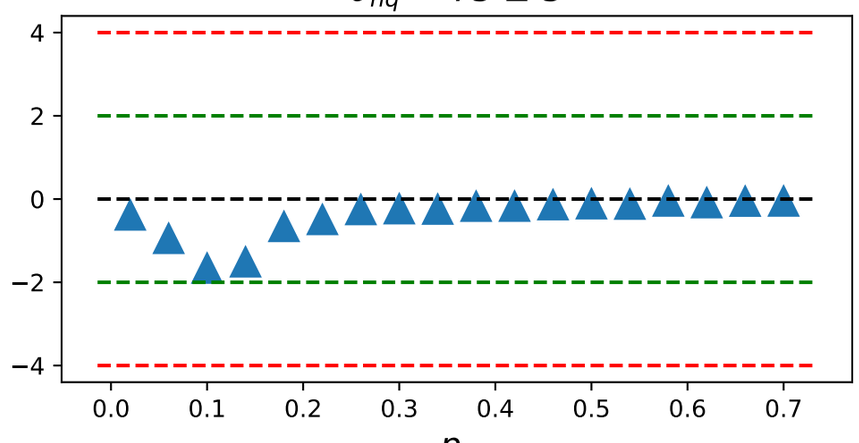
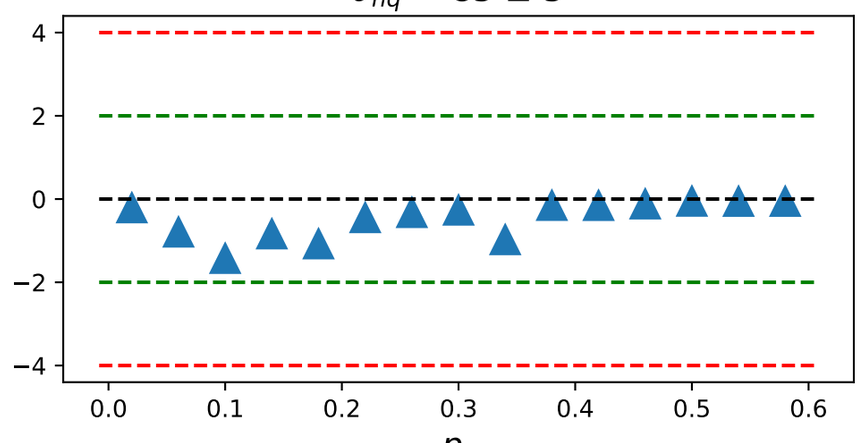
θ_{nq} = 85 ± 5