

灭菌设备监测报告

报告时间：2016-10-13 14:25:53

被监测单位信息

单位名称：北京XX诊所 单位地址：北京北京市朝阳区北苑路368号2栋1203
单位类型：诊所 单位联系人：张三 联系电话：13500102254
单位法人：李四 证件类型：身份证 证件号码：154332196605250651
卫生许可证：DF1504012036 有效期：2017-8-15 组织机构代码：1012357801 划分区域：北京朝阳区


TM

监测数据及结果

设备编号：S0001 设备信息：新华 SD0005 50L 程序号：P2
布局编号：2016-10-13 09:31:32 S0001 监测开始时间：2016-10-13 09:31:32
设定信息：134℃ 6分0秒 共360秒 使用部门：供应室 操作者：

记录仪数量4

平衡时间	温度最高	温度最低	保持时间	任意两点波动	真空度	压力范围	压力对应温度	设备评价
14	135.526	10.000	449	0.664	-81.0	208.4~219.2	131.917	
合格	合格	不合格	合格		-	-	-	合格

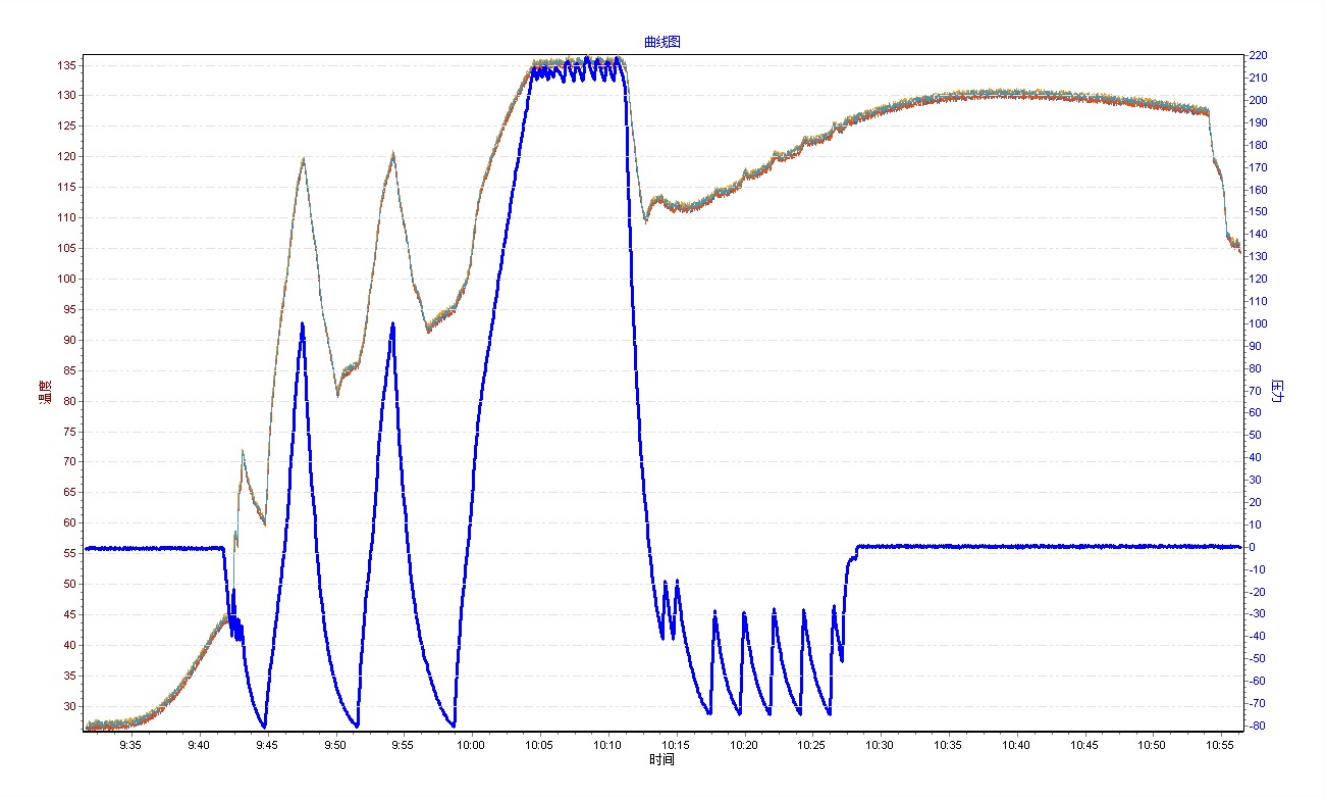

此数据只对本次测试有效

被监测单位信息

单位名称：北京XX诊所 单位地址：北京北京市朝阳区北苑路368号2栋1203

单位类型：诊所 单位联系人：张三 联系电话：13500102254

单位法人：李四 证件类型：身份证 证件号码：154332196605250651

卫生许可证：DF1504012036 有效期：2017-8-15 组织机构代码：1012357801 划分区域：北京朝阳区

TM

监测数据及结果


设备编号：S0001 设备信息：新华 SD0005 50L 程序号：P2

温度记录仪编号： 监测开始时间：2016-10-13 09:31:35

设定信息：134℃ 6分0秒 共 360 秒 使用部门：供应室 操作者：

灭 菌 包：

保持时间	温度最高值	真空度	压力范围	压力对应温度	灭菌效果	温度波动性
454	135.932	-81.0	208.4~219.2	131.917		1.743
-	-	-	-	-	-	

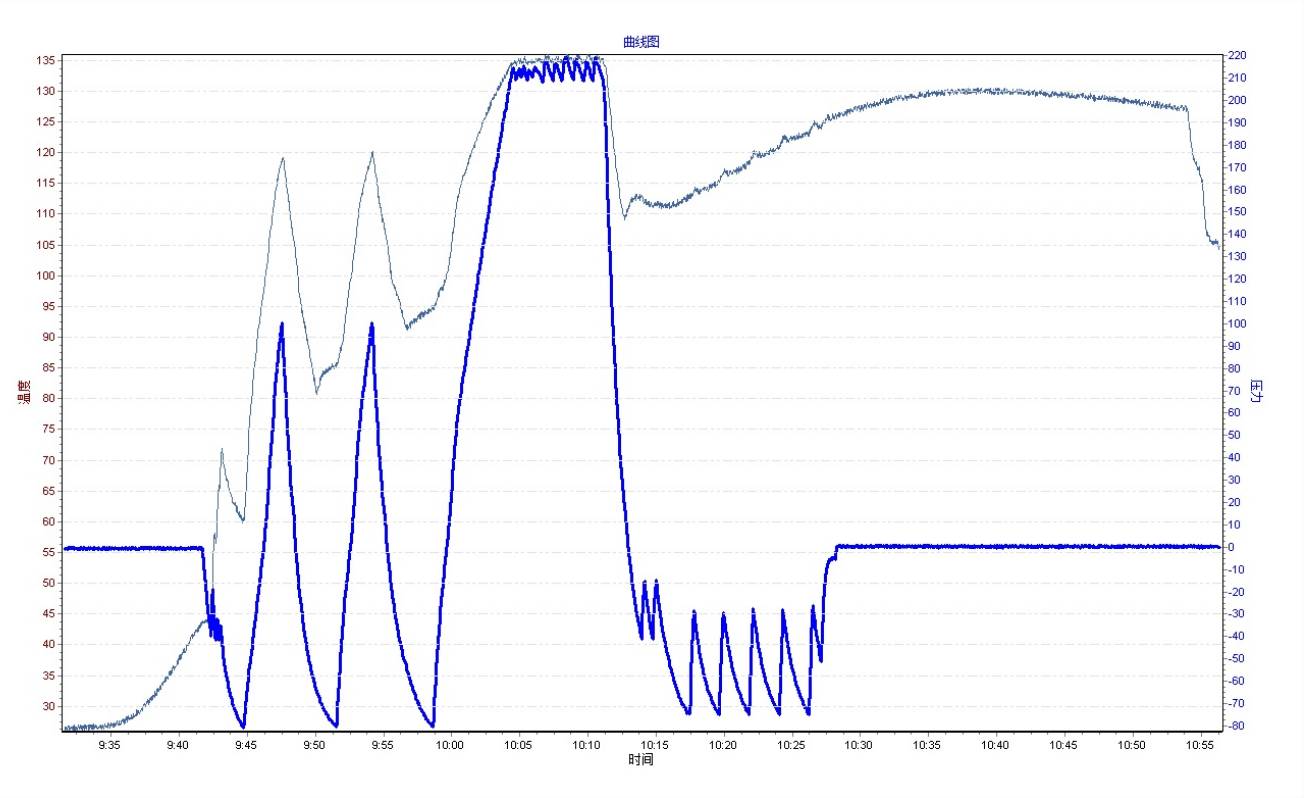

此数据只对本次测试有效

被监测单位信息

单位名称：北京XX诊所 单位地址：北京北京市朝阳区北苑路368号2栋1203

单位类型：诊所 单位联系人：张三 联系人电话：13500102254

单位法人：李四 证件类型：身份证 证件号码：154332196605250651

卫生许可证：DF1504012036 有效期：2017-8-15 组织机构代码：1012357801 划分区域：北京朝阳区

TM

监测数据及结果


设备编号：S0001 设备信息：新华 SD0005 50L 程序号：P2

温度记录仪编号： 监测开始时间：2016-10-13 09:31:38

设定信息：134℃ 6分0秒 共 360 秒 使用部门：供应室 操作者：

灭 菌 包：

保持时间	温度最高值	真空度	压力范围	压力对应温度	灭菌效果	温度波动性
466	136.765	0.0	0.0~0.0	0.000		1.841
-	-	-	-	-	-	

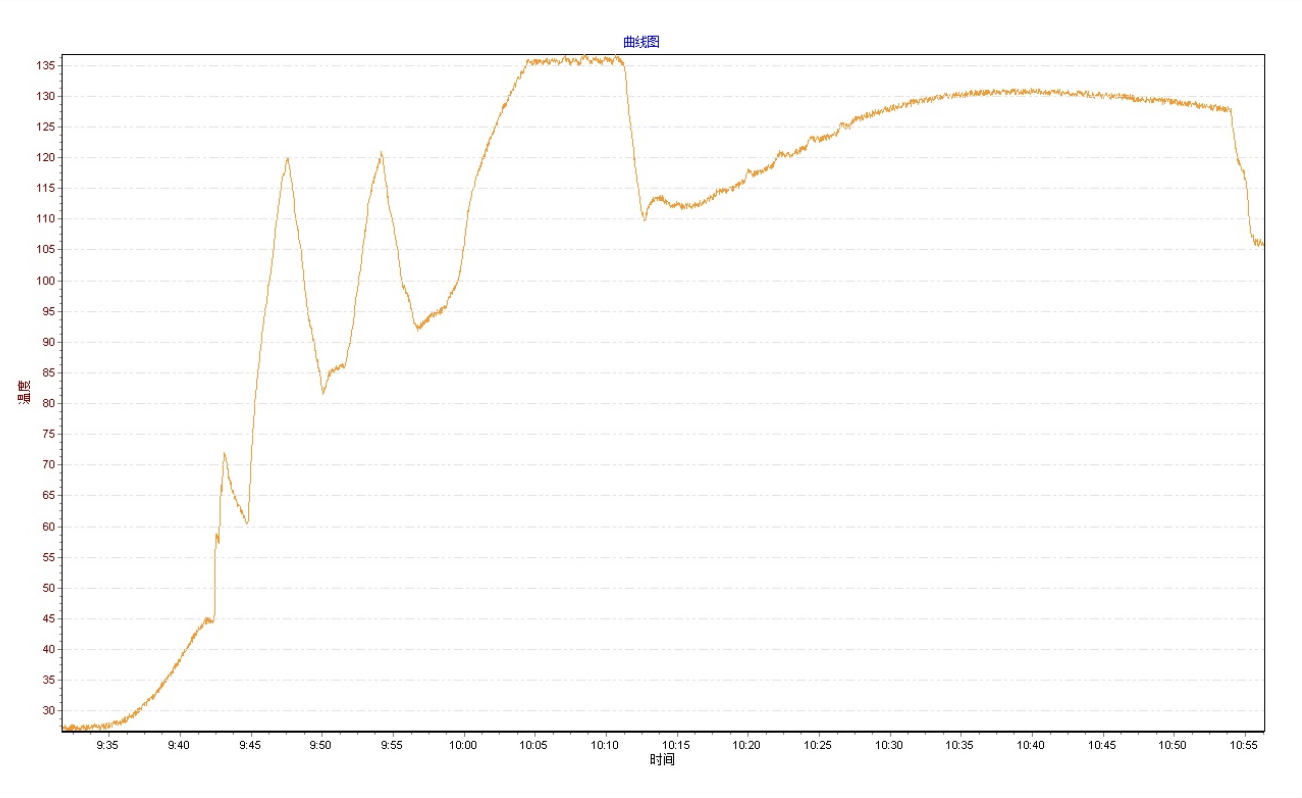

此数据只对本次测试有效

被监测单位信息

单位名称：北京XX诊所 单位地址：北京北京市朝阳区北苑路368号2栋1203

单位类型：诊所 单位联系人：张三 联系人电话：13500102254

单位法人：李四 证件类型：身份证 证件号码：154332196605250651

卫生许可证：DF1504012036 有效期：2017-8-15 组织机构代码：1012357801 划分区域：北京朝阳区

TM

监测数据及结果


设备编号：S0001 设备信息：新华 SD0005 50L 程序号：P2

温度记录仪编号： 监测开始时间：2016-10-13 09:31:40

设定信息：134℃ 6分0秒 共 360 秒 使用部门：供应室 操作者：

灭 菌 包：

保持时间	温度最高值	真空度	压力范围	压力对应温度	灭菌效果	温度波动性
452	136.063	0.0	0.0~0.0	0.000		1.889
-	-	-	-	-	-	

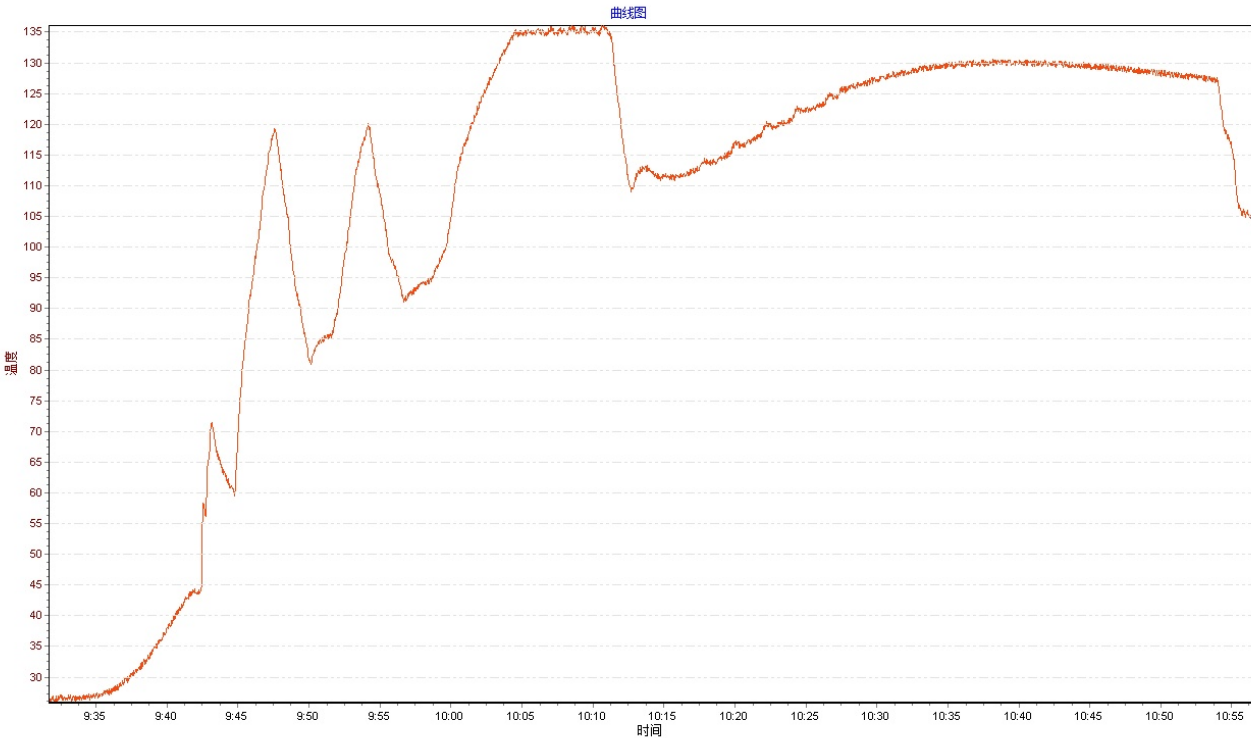

此数据只对本次测试有效

被监测单位信息

单位名称：北京XX诊所 单位地址：北京北京市朝阳区北苑路368号2栋1203

单位类型：诊所 单位联系人：张三 联系电话：13500102254

单位法人：李四 证件类型：身份证 证件号码：154332196605250651

卫生许可证：DF1504012036 有效期：2017-8-15 组织机构代码：1012357801 划分区域：北京朝阳区

TM

监测数据及结果


设备编号：S0001 设备信息：新华 SD0005 50L 程序号：P2

温度记录仪编号： 监测开始时间：2016-10-13 09:31:45

设定信息：134℃ 6分0秒 共 360 秒 使用部门：供应室 操作者：

灭 菌 包：

保持时间	温度最高值	真空度	压力范围	压力对应温度	灭菌效果	温度波动性
464	136.525	0.0	0.0~0.0	0.000		1.780
-	-	-	-	-	-	

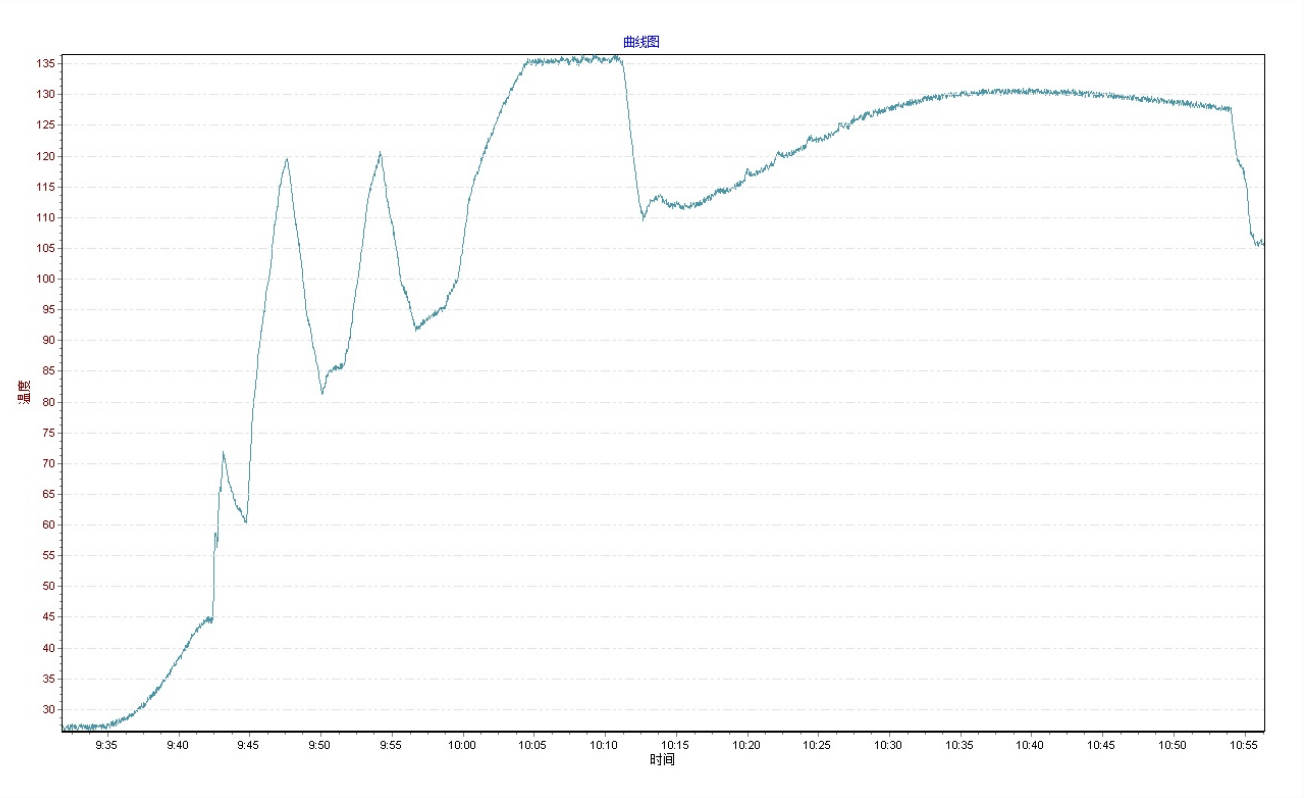

此数据只对本次测试有效