
흉부 영상 AI 결과를 받았을 때 확인할 것

인공지능(AI)의 위치·점수 표시를 원영상, 과거 영상, 판독 결과와 함께 확인한다.

핵심 판단 한눈에

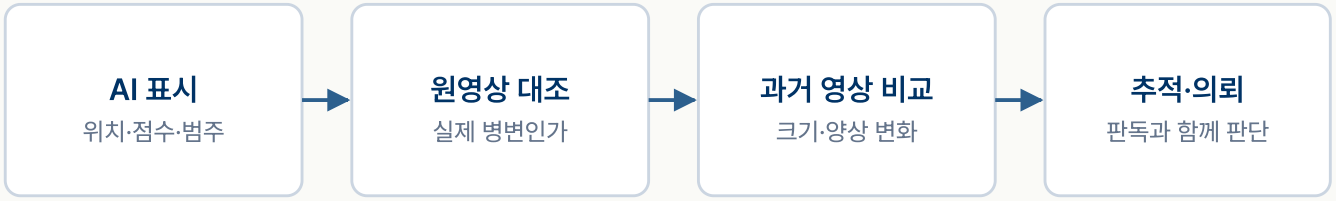

AI 표시를 원영상과 비교하고, CT 결절의 양상·크기·범주를 검토해 추적·의뢰를 결정한다.

결과를 읽는 순서

- ☐ CT AI의 결절 표시가 실제 결절인지 원영상을 본다. 강의는 혈관·림프절을 폐암으로 잘못 읽은 사례를 제시했다.
- ☐ 흉부 X선 AI의 이상 표시는 곧 암 진단이 아니다. 과거·현재 영상을 비교하고 필요 시 재촬영·CT로 평가한다.
- ☐ Lung-RADS 범주와 결절 양상·크기를 함께 검토한다.
- ☐ **흉부 X선 AI를 저선량 CT 폐암검진과 구분**한다.

강의의 제품 예시 · 결과와 성능의 범위

항목	강의에서 소개된 내용
CXR4 Normal Flagging	고신뢰 정상 선별 엔진: NPV 99.5%, sensitivity 99.7%, 학습 700K (제품 소개 수치)
정상 선별 조건	임상적 이상 없고 판독 일치도가 높은 영상, 모든 부위의 변이·이상 및 의료기기 없음, 적절한 자세·영상 품질
CT AI 예시	결절 개수·부위·크기·Lung-RADS, 이전 검사 매칭·용적배가시간(VDT) 제공

강의 당시 서울아산 시행 예시

제품 성능·기관 시행 조건을 별개로 기록

고시 제2023-176호(2023.11.16), 만 14세 이상 흉부질환 의심환자, 2024.3–2027.2 시행, 예상수가 약 3,100원, 동의서 구득을 소개했다. 연자 Q&A는 학회 검증 제품 목록이 아니라 신의료기술 통과 정도라고 답변했다.