

통 보

제 목 AED(자동심장충격기) 관리 미흡

관 계 부 서 ■□처, □□/□▲/□▼/□■/□○/□▣/□▤/□▥/□▦지사


조 치 부 서 ■□처

내 용

1. 업무 개요

비축지사는 유사시 비축지사에서 발생할 수 있는 심정지 환자의 심폐소생을 돕기 위하여 [사진]과 같이 AED¹⁾(자동심장충격기)를 설치하여 운영하고 있다.

[사진] 비축지사 AED

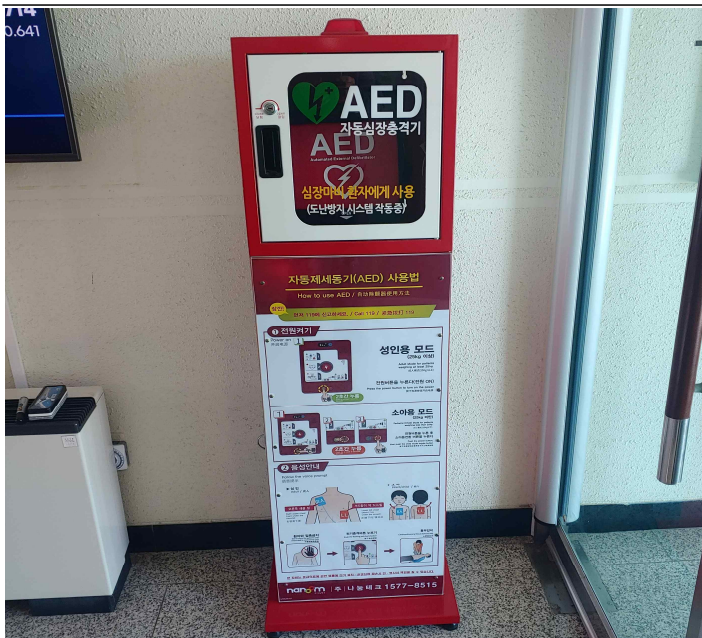

자료: □▲지사 AED 사진, 대한심폐소생협회 교육자료

1) AED(Automated External Defibrillator: 자동심장충격기): 심정지 환자의 심장박동 리듬을 자동으로 분석하여 제세동을 시행할 수 있도록 유도하는 심장충격기(의료 장비)

2. 관계규정 및 판단기준

■□처는 유사시 비축지사 내 발생하는 심정지 환자의 심폐소생을 돕기 위하여 비축지사의 AED가 항상 정상적인 작동이 가능하도록 통일된 점검기준을 수립하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■□처는 통일된 비축지사 AED 점검기준을 수립하지 않고 있다.

이에 따라 [표]와 같이 9개 비축지사 중 □□지사와 □▲지사는 AED에 대한 점검기준이 없고, 나머지 7개 지사는 자체적으로 점검기준을 수립하여 점검하고 있으나 지사 간 점검항목이 상이하다.

[표] 비축지사 AED 관리 현황(2022년 10월 말 기준)

부 서	점검기준 존재여부	점검 주기/항목		유효기간		비 고
		주기	항목	배터리	PAD	
□□지사	없음	없음	없음	2020년 1월	2022년 11월	
□▲지사	없음	없음	없음	2022년 11월	2022년 4월	
□▼지사	소방시설 운용 지침서	1회/분기	상태점검 배터리/PAD 유효기간 점검 등	2025년 6월	2024년 8월	
□■지사	소방시설 운용 지침서	1회/분기	외관상태, 배터리/녹색램프/ PAD 유효기간 등	2018년 9월 (제조일만 표시)	2023년 11월	
□○지사	소방시설 운용 지침서	1회/반기 (4월, 8월)	경보작동여부, 상태표시등 점등여부, 외함 및 본체 훼손 여부	2024년 3월 (행정동) 2025년 8월 (제품탱크)	2025년 8월 (행정동) 2023년 10월 (제품탱크)	
□▣지사	소방시설운영 지침서	1회/반기	보유수량	2013년 6월 (제조일만 표시)	2022년 7월	
□▢지사	보건관리절차서 준용	1회/분기	기능점검, 배터리/PAD 유효기간 점검 등	2023년 3월	2025년 4월	
□▤지사	보건관리절차서 준용	1회/분기	기능점검, 배터리/PAD 유효기간 점검 등	2026년 3월	2024년 8월	
□▥지사	보건관리절차서 준용	1회/월	기능점검, 배터리/PAD 유효기간 점검 등	2022년 10월	2022년 10월	

자료: ■□처 제출자료 재구성

그 결과 □□지사, □▲지사, □■지사는 배터리와 PAD 유효기간에 대한 점검기준이 없고, 2022년 10월 말 현재 유효기간이(약 3개월~1년 9개월) 지나 정상적인 작동을 보장할 수 없는 상태이다.

관계부서 의견 ■□처는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■□처장은 유사시에도 정상적인 작동이 가능하도록 비축지사 AED(자동심장충격기) 점검항목을 검토하고 통일된 점검기준을 수립하여 관리하시기 바랍니다.(통보)