PEMANTAPAN MUTU INTRA LABORATORIUM BIDANG HEMATOLOGI

RUMAH SAKIT " DHARMA NUGRAHA "

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun - Jakarta Timur, Telepon 021-4707433; Fax 021-4707428

Bahan Kontrol		Reagen						Agu-23	Pemeriksaan	**Lekosit**
Hema Contol BC-5300		No.Lot	Nilai Mean	Batas peringatan (x+2SD)		1 SD			Metode	**Impedance**
Low									Satuan	10^3/ µL
Normal		**BC2307B**	**7,62**	**4,62**	**10,62**	1		Exp. 10/09/2023	Alat	Mindray BC - 5300

*) Tgl / Hasil	Normal	Petugas
1	7,20	Fara
2	7,07	Agus
3	7,18	Agus
4	7,23	Vinna
5	7,30	Vinna
6	7,29	Fara
7	6,97	Fara
8	7,62	Yanti
9	8,00	Yanti
10	7,30	Vinna
11	7,49	Vinna
12	7,16	Agus
13	7,39	Agus
14	8,00	Yanti
15	9,00	Yanti
16	7,58	Vinna
17	7,31	Vinna
18	7,14	Fara
19	7,42	Fara
20	7,34	Agus
21	7,36	Agus
22	7,55	Yanti
23	7,60	Yanti
24	7,39	Fara
25	7,13	Fara
26	7,36	Agus
27	7,15	Agus
28	7,29	Vinna
29	7,19	Vinna
30	8,00	Yanti
31	8,15	Yanti
Mean	7,46	#REF!
SD	0,41	#REF!
CV	**5,49%**	**#REF!**

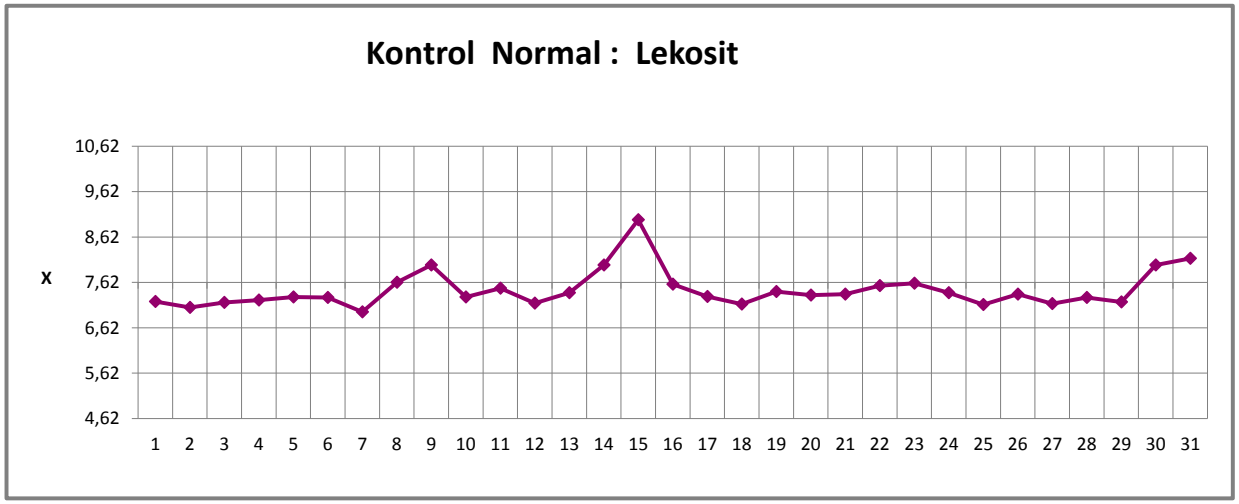

CV Maksimum * ditetapkan

PARAMETER	CV (%)
Hemoglobin	**7%**
Leukosit	**15%**
Hematokrit	**6%**
Trombosit	**25%**

Aturan Kontrol : *Westgard*	
Peringatan	1 – 2S
Penolakan	1 – 3S
Penolakan	2 – 2S
Penolakan	R – 4S

Diketahui oleh :
Koordinator Laboratorium
Widya Astuti

Kepustakaan :

* Sun Diagnostics Total Error Limiits for variety of Laboratory test as defined by CLIA

** Westgard JO,Phd; Basic QC Practices 2 nd Edition; 2008 ; page 33 , 195