PEMANTAPAN MUTU INTRA LABORATORIUM BIDANG HEMATOLOGI

RUMAH SAKIT " DHARMA NUGRAHA "

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun - Jakarta Timur, Telepon 021-4707433; Fax 021-4707428

Control Serum		Reagen						Sep-23	Pemeriksaan	**Hemoglobin**
Hema Contol BC-5300		No.Lot	Nilai Mean	Batas peringatan (x+2SD)		1SD			Metode	**Cyanide-free reagent**
Low									Satuan	g/dL
Normal		**BC 2309 B**	**11,8**	**10**	**13,6**	0,6		Exp.10-11-2023	Alat	Mindray BC- 5300

*) Tgl / Hasil	Normal	Petugas
1	11,1	Ayu
2	11,3	Agus
3	11,3	Agus
4	11,8	Yanti
5	12,4	Yanti
6	11,7	Fara
7	11,4	Fara
8	11,7	Vinna
9	11,8	Vinna
10	12,0	Yanti
11	12,4	Yanti
12	11,3	Ayu
13	11,9	Ayu
14	11,2	Fara
15	11,2	Fara
16	11,3	Agus
17	11,2	Agus
18	12,0	Vinna
19	11,5	Vinna
20	11,7	Yanti
21	12,0	Yanti
22	11,5	Fara
23	11,4	Fara
24	11,3	Agus
25	11,3	Agus
26	11,4	Vinna
27	11,3	Vinna
28	11,8	Yanti
29	12,0	Yanti
30	11,9	Fara
31		
Mean	11,60	#REF!
SD	0,36	#REF!
CV	**3,10%**	**#REF!**

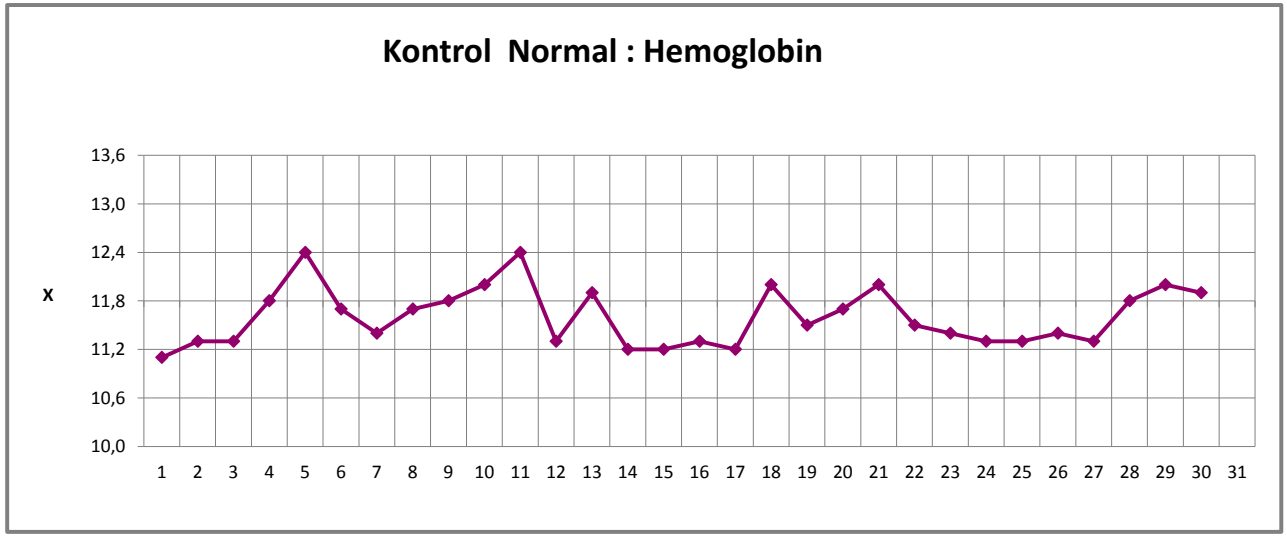

CV Maksimum * ditetapkan

PARAMETER	CV (%)
Hemoglobin	**7%**
Leukosit	**15%**
Hematokrit	**6%**
Trombosit	**25%**

Aturan Kontrol : *Westgard* **	
Peringatan	1 – 2S
Penolakan	1 – 3S
Penolakan	2 – 2S
Penolakan	R – 4S

Diketahui oleh :
Koordinator Laboratorium
Widya Astuti

Kepustakaan :

* Sun Diagnostics Total Error Limiits for variety of Laboratory test as defined by CLIA

** Westgard JO,Phd; Basic QC Practices 2 nd Edition; 2008 ; page 33 , 195