PEMANTAPAN MUTU INTRA LABORATORIUM BIDANG HEMATOLOGI

RUMAH SAKIT " DHARMA NUGRAHA "

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun - Jakarta Timur, Telepon 021-4707433; Fax 021-4707428

Control Serum		Reagen						Agu-23	Pemeriksaan	Hemoglobin
Hema Contol BC-5300		No.Lot	Nilai Mean	Batas peringatan (x+2SD)		1SD			Metode	**Cyanide-free reagent**
Low									Satuan	g/dL
Normal		**BC2307B**	**11,7**	**9,9**	**13,5**	0,6		Exp. 10/09/2023	Alat	Mindray BC- 5300

*) Tgl / Hasil	Normal	Petugas
1	12,0	Fara
2	11,9	Agus
3	12,0	Agus
4	12,0	Vinna
5	12,1	Vinna
6	12,0	Fara
7	11,8	Fara
8	12,0	Yanti
9	12,3	Yanti
10	12,4	Vinna
11	11,5	Vinna
12	11,0	Agus
13	11,4	Agus
14	11,7	Yanti
15	11,9	Yanti
16	11,4	Vinna
17	11,4	Vinna
18	11,2	Fara
19	11,3	Fara
20	11,3	Agus
21	11,2	Agus
22	11,9	Yanti
23	12,0	Yanti
24	11,3	Fara
25	11,2	Fara
26	11,4	Agus
27	11,2	Agus
28	11,1	Vinna
29	11,2	Vinna
30	12,0	Yanti
31	12,3	Yanti
Mean	11,66	#REF!
SD	0,41	#REF!
CV	**3,52%**	**#REF!**

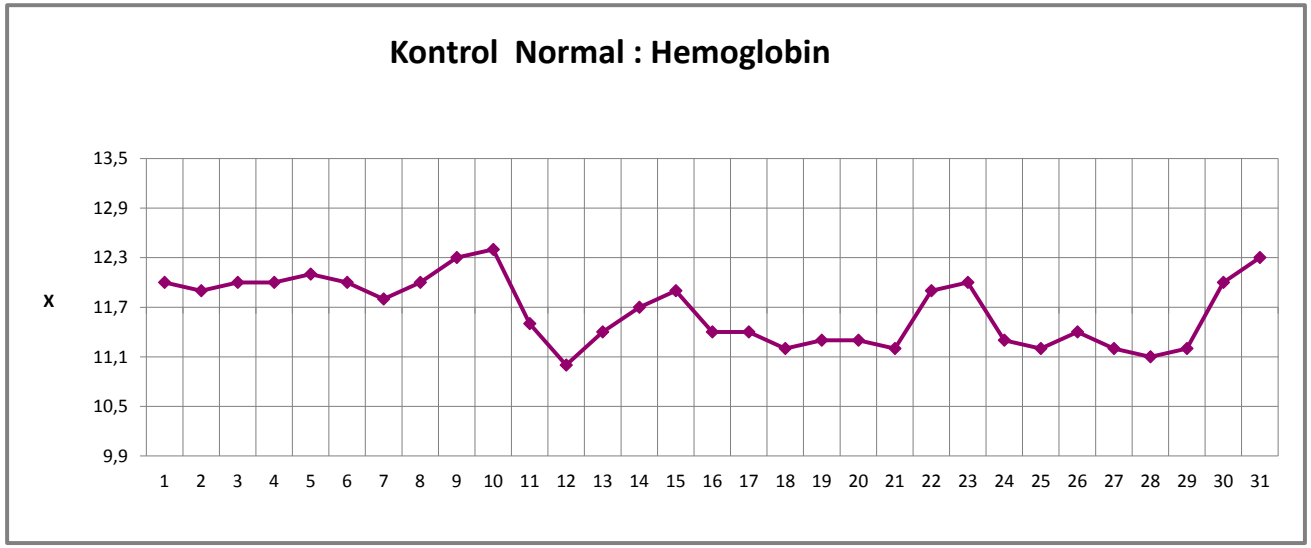

CV Maksimum * ditetapkan

PARAMETER	CV (%)
Hemoglobin	**7%**
Leukosit	**15%**
Hematokrit	**6%**
Trombosit	**25%**

Aturan Kontrol : *Westgard* **	
Peringatan	1 – 2S
Penolakan	1 – 3S
Penolakan	2 – 2S
Penolakan	R – 4S

Diketahui oleh :
Koordinator Laboratorium
Widya Astuti

Kepustakaan :

* Sun Diagnostics Total Error Limiits for variety of Laboratory test as defined by CLIA

** Westgard JO,Phd; Basic QC Practices 2 nd Edition; 2008 ; page 33 , 195