DIC07
基體偏壓與環形振盪器

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的與規格對照

依 Lab 7 (PDF 第 26–30 頁) 完成三項模擬：固定基體偏壓比較 N=3、5、7 的環形振盪器；固定級數比較四種基體接法；掃描 NMOS 與 PMOS 的反向 source-body 偏壓並觀察臨界電壓。兩個 netlist 共五個變體全部完成，環形振盪器在同一變體內同時包含三種級數。

2 電路與理論

每級反相器使用 $W_n = 0.6\,\mu\text{m}$、$W_p = 1.8\,\mu\text{m}$、$L = 0.25\,\mu\text{m}$。最後一級回接第一級，形成奇數級反相回授；沒有外接振盪時脈。為打破完全對稱的數值初始狀態，以 UIC 與一個節點 0.05 V 的初始條件啟動，這是暫態啟動方法，並非物理上無擾動啟振能力的驗證。

若每級平均延遲為 t_p，則 $T \approx 2Nt_p$、$f \approx 1/(2Nt_p)$。四種 body 設定依序為：PMOS body=1 V、NMOS body=0 V；只把 PMOS body 提高至 1.2 V；只把 NMOS body 降為 -0.2 V；兩者皆改。講義在 2.5 V 電源使用的 0.5 V 偏移，本次按相同比例調為 0.2 V。

NMOS 的長通道 body-effect 關係為

$$V_{tn} = V_{tn0} + \gamma\left(\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}\right).$$

PMOS 使用相應的反向偏壓與臨界電壓絕對值。模型中的短通道、汲極偏壓及其他效應仍由模擬器處理，沒有自行指定不可取得的 γ 或 ϕ_F。

3 模擬設定與量測定義

本次使用獨立提供的 MOS 模型，電源為 1.0 V、溫度為 27 °C，並保留講義的電路拓樸及下列比較條件。1 V 是本次模擬設定，並非由公開模型文件確認的元件額定值；不能把講義舊製程的數值當成此次模型的驗收值。

模擬使用 HSPICE S-2021.09、RUNLVL=6。表格取自實際原生量測結果，圖形由實際列印數據重繪；每個變體都完整重設掃描參數及溫度，避免前一個變體的設定殘留。數值求解完成與量測成功，不等於已驗證製程可靠度。加密模型區塊的內部警告仍無法完整檢視。環形振盪器模擬 20 ns，列印步距 1 ps；跳過前 10 ns，在 50% 門檻的第 1 與第 6 個上升交越間量測五個週期，再以 $f = 5/\Delta t$ 求平均頻率。另對 source 電壓作 0–1 V、10 mV 步距的 DC 掃描，直接列印 VTH，而非由任意電流門檻推估。

4 實測結果

下表單位 GHz；所有頻率均來自啟動後的實際交越時間。

偏壓配置	N=3	N=5	N=7
基準	2.0095	1.1609	0.8279
僅 PMOS 反偏	1.9266	1.1101	0.7916
僅 NMOS 反偏	1.8870	1.0955	0.7814
雙側反偏	1.8112	1.0493	0.7485

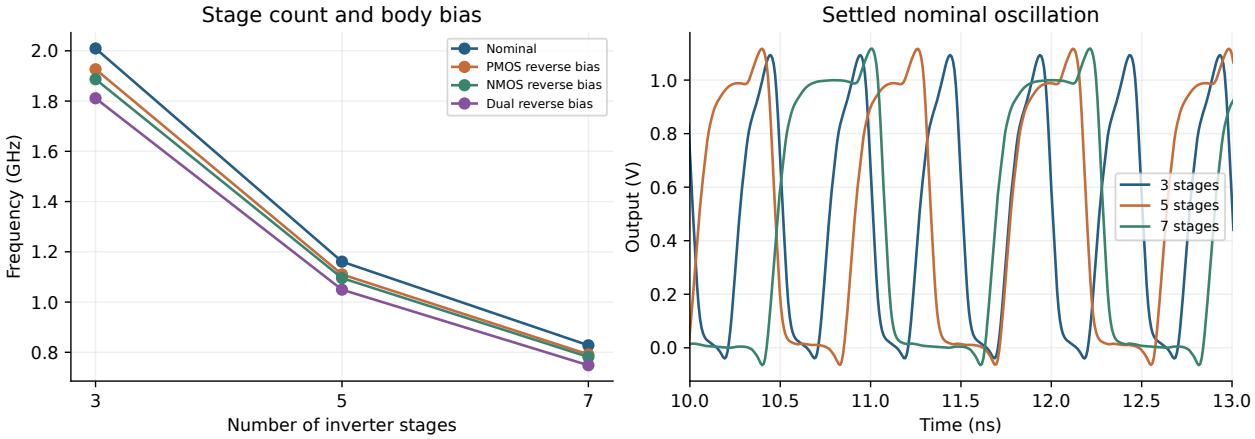


Figure 1: 級數、基體反向偏壓與振盪頻率，以及基準波形。

元件	Bias=0 V	Bias=1 V	Change (mV)
NMOS	0.3951	0.5804	185.29
PMOS magnitude	0.3364	0.5028	166.43

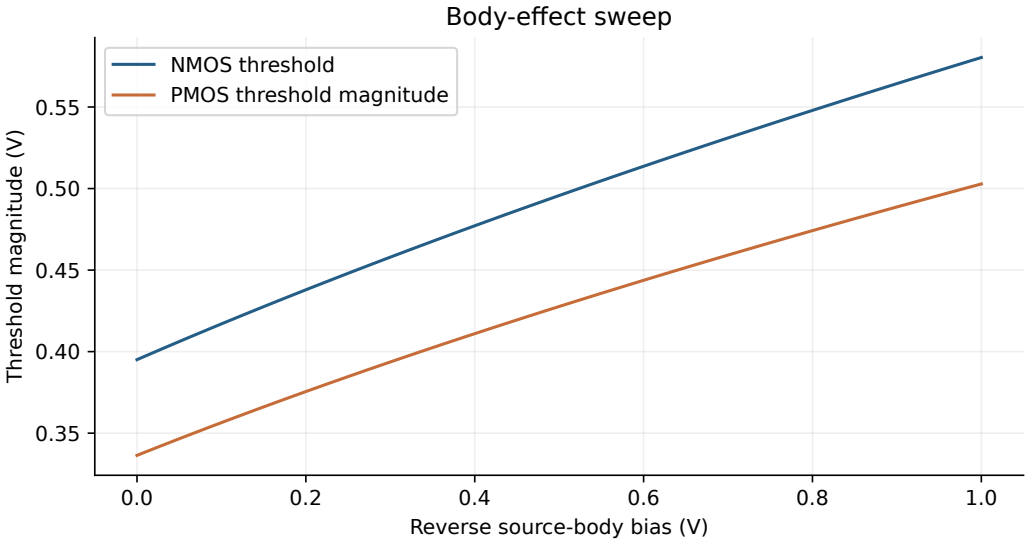


Figure 2: VTH 直接輸出顯示反偏增大時，兩種元件的臨界電壓幅度都增加。

5 討論

N 增加使迴圈延遲增加，頻率降低。基準反推的每級平均延遲，N=3/5/7 約為 82.94/86.14/86.28 ps；N=3 的波形與每級動態工作點不同，因此不應假設三種級數有完全相同的 t_p。

反向 body 偏壓提高臨界電壓、降低可用過驅電壓，使頻率下降。本次順序為基準、只改 PMOS、只改 NMOS、兩者皆改；此順序與講義範例相符，但 PMOS 與 NMOS 單邊偏壓的相對差距是模型及尺寸相依的，不能只憑載子遷移率推論所有製程都相同。

波形保留模型產生的小幅過衝與欠衝，沒有截成理想 0/1 V。這些暫態數值不代表已完成可靠度與接面電流檢查。直接 VTH 掃描也包含偏壓改變造成的其他模型效應，不把它宣稱為純粹長通道公式的參數萃取。

6 可重現檔案

本實驗上傳下列 netlist；模型設定以註解標記保留，模型檔與其路徑均不隨報告上傳。執行前須在本機補入合法可用的模型設定。

- `01_ring_oscillators.sp`
- `02_body_threshold.sp`

每一個變體的完整量測值位於本 lab 的 `results`，並附代表性波形 CSV、分析結果與規格對照清單。波形 CSV 最多保留 2501 個均勻取樣點；直接量測未降採樣。完整原始 listing 留在本機。