DIC10
線性與非線性延遲模型

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的與規格對照

依 Lab 10（PDF 第 39–43 頁）完成四項要求。第一個 netlist 掃描反相器尺寸 1–4 倍及負載 0/0.1/0.2/0.3 pF，固定輸入邊緣參數 0.2 ns，同時涵蓋固定負載改尺寸、固定尺寸改負載、尺寸與負載共同掃描三步。第二個 netlist 固定尺寸 1 倍，掃描輸入邊緣 0.2/0.4/0.6/0.8 ns 及上述四種負載，對應表 10.1。總計兩個 netlist、32 個變體全部完成求解及量測。

2 電路與延遲模型

單位反相器採 $W_p/W_n = 1.8/0.6\,\mu\text{m}$、$L = 0.25\,\mu\text{m}$，尺寸倍數同時乘到兩種寬度。輸出接理想負載電容；標示零負載時只加入 10^{-21} F 的數值極小量，模型自身寄生效應仍保留。

以 $z = (t_{pHL} + t_{pLH})/2$ 為平均延遲，先在固定輸入邊緣下擬合 $z = A_0 + A_1 C_L$。再以負載 x（pF）、PULSE 邊緣參數 y（ns）建立講義的雙線性形式

$$z = A + Bx + Cy + Dxy.$$

這是有限工作區間的近似，不是晶體管方程的精確解；全部原始 t_{pHL}、t_{pLH}、輸出上升及下降時間都保留在 CSV。

3 模擬設定與量測定義

本次使用獨立提供的 MOS 模型，電源為 1.0 V、溫度為 27 °C，並保留講義的電路拓樸及下列比較條件。1 V 是本次模擬設定，並非由公開模型文件確認的元件額定值；不能把講義舊製程的數值當成此次模型的驗收值。

模擬使用 HSPICE S-2021.09、RUNLVL=6。表格取自實際原生量測結果，圖形由實際列印數據重繪；每個變體都完整重設掃描參數及溫度，避免前一個變體的設定殘留。數值求解完成與量測成功，不等於已驗證製程可靠度。加密模型區塊的內部警告仍無法完整檢視。PULSE 的 SLEW 參數是從 0 到 100% 的線性斜坡時間，其 10–90% 區間為 0.8×SLEW。這與輸出採 10–90% 量測的定義不同，報告明確區分。週期為 25 ns，輸入初始延遲 2 ns、脈寬 10 ns；暫態 50 ns、列印間距 5 ps。傳播延遲採輸入 / 輸出 50% 交越。

4 固定輸入邊緣的線性擬合

下表以 ns、pF 為單位，殘差為四個負載點的最大絕對誤差。

尺寸	A_0 (ns)	A_1 (ns/pF)	Max residual (ps)
1	0.05936	3.69754	8.96
2	0.05939	1.87448	8.77
3	0.05880	1.26966	7.53
4	0.05875	0.96623	7.18

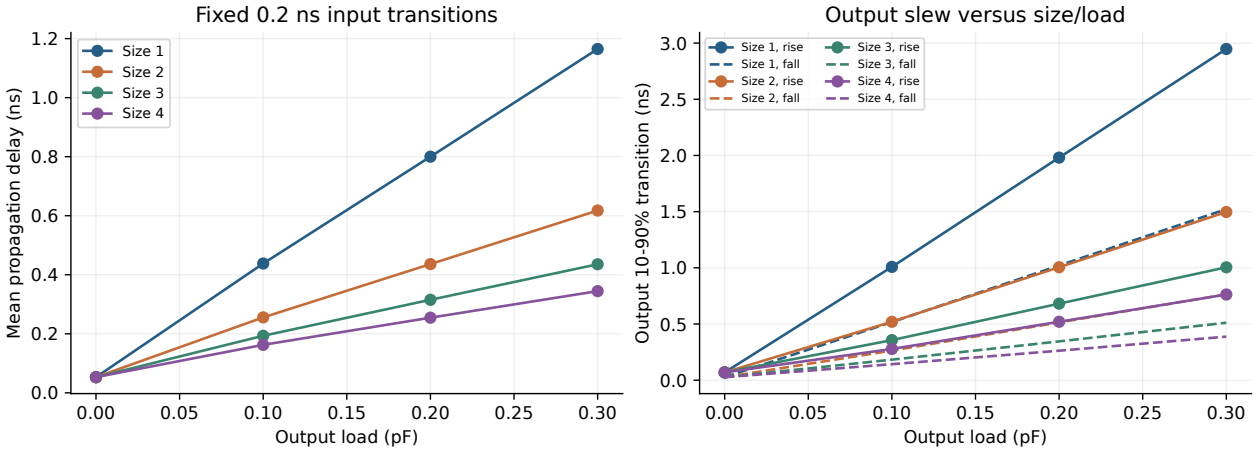


Figure 1: 固定邊緣下的負載延遲，以及輸出上升 / 下降時間。

5 負載與輸入邊緣的二維結果

下表為平均傳播延遲 (ns)，行為輸入斜坡參數、列為輸出負載。

Ramp (ns)	0 pF	0.1 pF	0.2 pF	0.3 pF
0.2	0.0530	0.4381	0.8000	1.1649
0.4	0.0668	0.4843	0.8484	1.2132
0.6	0.0768	0.5326	0.8973	1.2600
0.8	0.0850	0.5808	0.9472	1.3067

$$z = 0.038107 + 3.583427x + 0.109639y + 0.556701xy \quad \text{(ns)}.$$

使用同一組 16 點資料時，只考慮負載的模型 RMSE 為 51.17 ps；加入斜坡及交互項後降至 23.64 ps，最大殘差仍有 52.14 ps。這是資料內擬合誤差，並非獨立驗證集的預測誤差。

6 討論

提高尺寸降低每單位負載的延遲斜率；本次從尺寸 1 的 3.6975 ns/pF 降至尺寸 4 的 0.9662 ns/pF。非零截距反映內部寄生、有限輸入斜坡與模型擬合效應，不能直接解讀成單一固定的物理電容。

固定負載時，慢輸入使平均傳播延遲增加，因此忽略輸入邊緣會產生系統性誤差。雙線性模型改善平均誤差，但在低負載及慢斜坡附近仍有曲率，適合改用更細的查表資料與插值。圖中的不同線條相連僅便於觀察，不表示已驗證範圍外的線性外插。

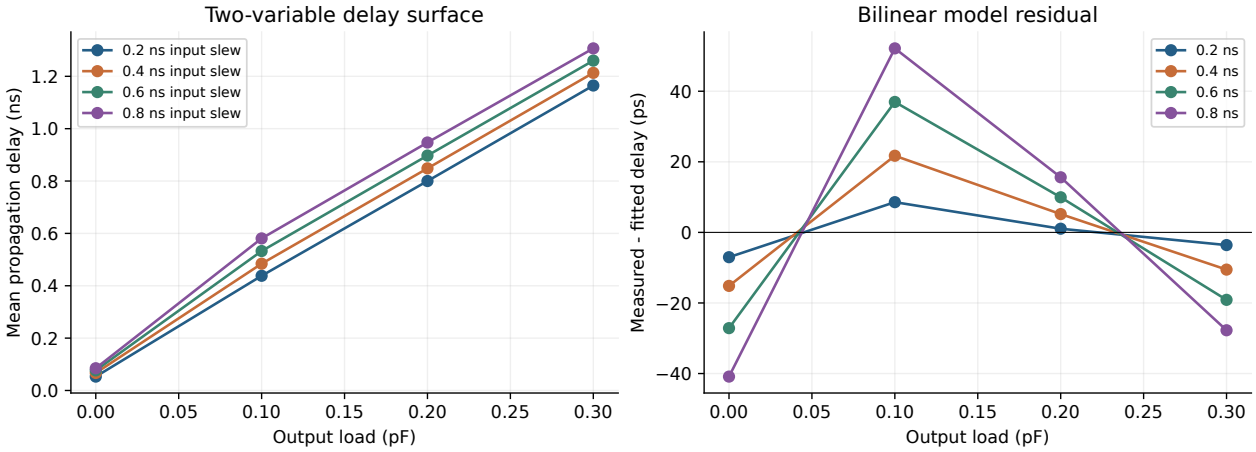


Figure 2: 輸入斜坡改變延遲曲面，雙線性近似仍有可見殘差。

7 可重現檔案

本實驗上傳下列 netlist；模型設定以註解標記保留，模型檔與其路徑均不隨報告上傳。執行前須在本機補入合法可用的模型設定。

- `01_size_load.sp`
- `02_slew_load.sp`

每一個變體的完整量測值位於本 lab 的 `results`，並附代表性波形 CSV、分析結果與規格對照清單。波形 CSV 最多保留 2501 個均勻取樣點；直接量測未降採樣。完整原始 listing 留在本機。