
设备名称：默耐思荧光检测仪

设备图片：



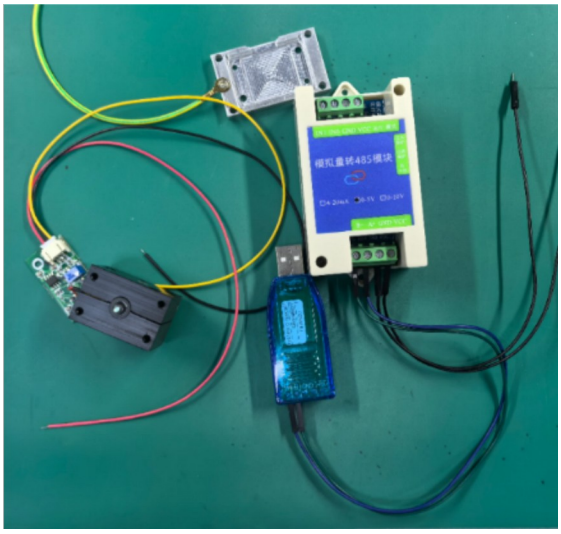

存放地点：**8 号楼 2014**

关键性能参数（文字或者图片快照）：

模块的选型或定制，需要确认检测对象激发波长和发射波长，比如说检测某种物质，它的激发波长 470nm,发射波长 525nm，那传感器只能检测这种波长的物质，检测不了其他波长的物质。

模块的原理是通过检测对象被激发光激发后，发出荧光功率来判断结果。

荧光信号越强，输出电压值越大。

01. 型号对应染料

我们这个有带宽的，比如MNS-MFD-470型号，中心波长 和 半波宽是：

- 激发：465±15nm
- 检测：525±9nm

型号	激发波长	检测波长
MNS-MFD-365	365±4	612±9
MNS-MFD-470	465±15	525±9
MNS-MFD-525	525±9	564±9
MNS-MFD-571	571±9	612±9
MNS-MFD-635	635±12.5	685±15

购买链接：

https://item.taobao.com/item.htm?id=664128968042&last_time=1770691380&mi_id=0000yJwu8_AmmP2AL-VXaDOWIUpTfrdigqsOhR7rXTuHGYI&scm=1007.13982.82927.0&spm=tbpc.mytb_footmark.item.goods&upStreamPrice=298000

驱动与控制软件、参数手册（若有）：

百度网盘(课题组)\3 实验资源 软件控制 Lab Resources\2. 实验室 设备仪器\默耐思荧光检测仪