
## Calibración de material VOLUMETRICO

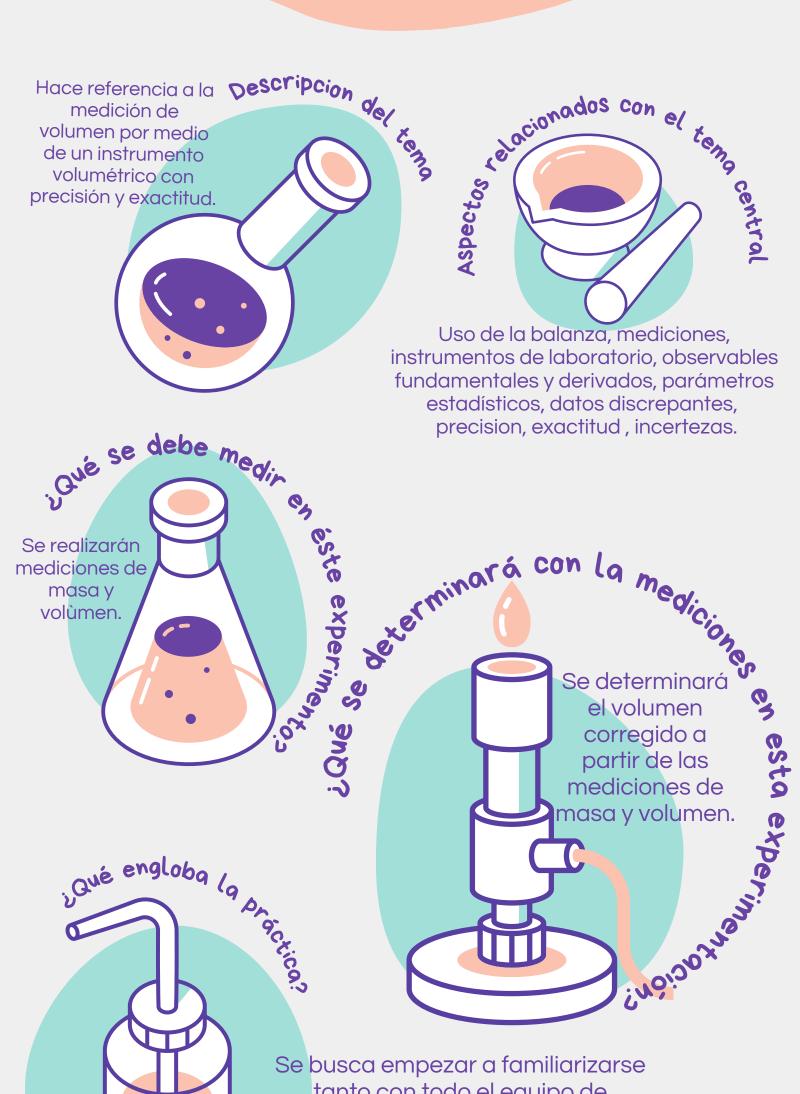

equipo de
conormas de
so de protección
sidad, etc.

El volumen
corregido del
instrumento a la
temperatura de
fabricación.


Los datos
discrepantes

Las mediciones
de masa y
volumen

¿Soponymas

egrantes:

'Illesco
to Si
C Se busca empezar a familiarizarse tanto con todo el equipo de laboratorio, como normas de seguridad, símbolos de protección y

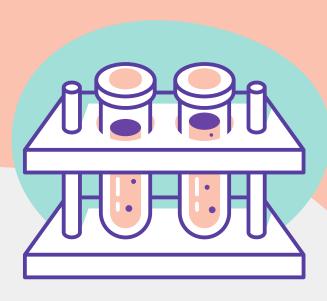



**USAC** Facultad de Ingeniería Laboratorio de Química General 1 Auxiliar: María Alejandra Escobar

José Wilfredo Sirin Aguilar/ 9713184 Hector Fernando Carrera Soto / 201700923