
Quando uma curva precisa ser questionada

R · LOOCV · Análise experimental

A curva que melhor se ajusta aos pontos do ensaio também é a mais adequada para representar a resposta do sensor?

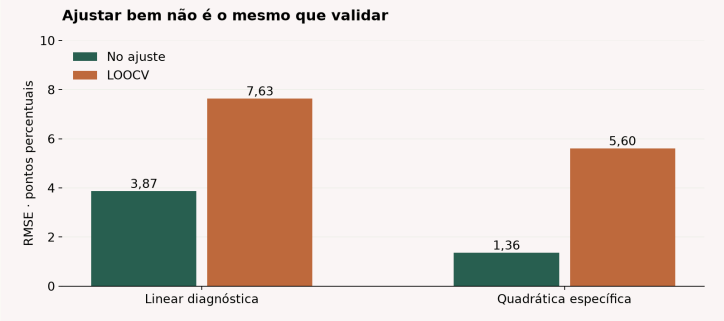

RMSE em pontos percentuais de conteúdo volumétrico de água. A diferença entre ajuste e validação faz parte da análise.

Como o estudo foi conduzido

- Análise de 36 leituras brutas em sete níveis do ensaio SOLO_01.
- Comparação de curvas linear e quadrática específicas com a equação de fábrica.
- LOOCV por nível e verificação de monotonicidade, forma da curva e valores plausíveis.

Leitura dos resultados

A quadrática específica tem menor RMSE no ajuste do que na LOOCV. Além disso, não atende integralmente aos critérios de forma avaliados. O resultado é um diagnóstico, não uma curva adotada.

Escopo e interpretação

LOOCV é validação interna. Uma nova sequência ou coluna de solo é necessária para validação independente. Os resultados não devem ser extrapolados para além da faixa e da geometria ensaiadas.

Materiais de origem e documentação