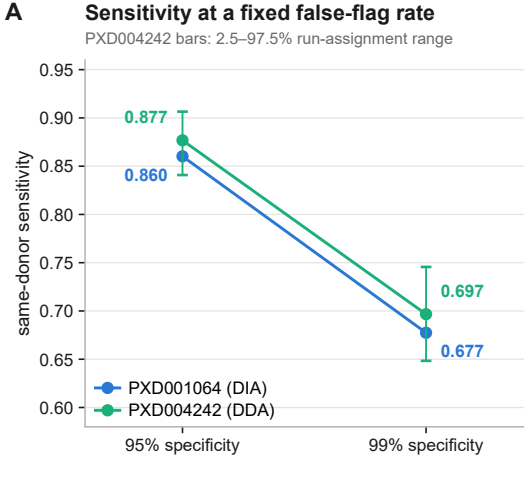
A
Sensitivity at a fixed false-flag rate
PXD004242 bars: 2.5–97.5% run-assignment range
same-donor sensitivity
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.877
0.860
0.697
0.677
PXD001064 (DIA)
PXD004242 (DDA)
95% specificity
99% specificity

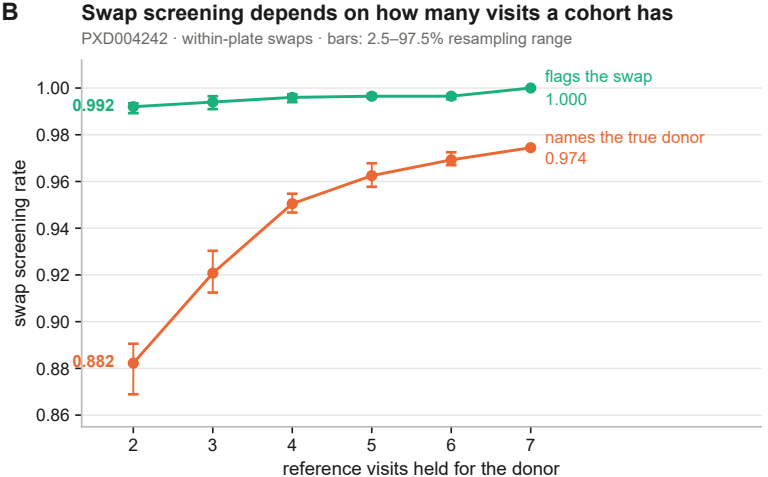
B
Swap screening depends on how many visits a cohort has
PXD004242 · within-plate swaps · bars: 2.5–97.5% resampling range
swap screening rate
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.992
0.882
flags the swap
1.000
names the true donor
0.974
2
3
4
5
6
7
reference visits held for the donor