I10 2023 版電子書安裝

測試網頁是否可語認證伺服器溝通（擇一會通即可）

**需要將院方防火牆 2013 port 開放,

http://59.120.248.196:2013/Icd10_Upgrade/

http://10.252.225.194:2013/Icd10_Upgrade/

**不開啟 2013 port 可以選擇下面連結測試

http://59.120.248.195/Icd10_Upgrade/

請確認以上 IP 是否加入院方白名單信任 IP

測試,如果沒有錯誤訊息並且顯示

Hello World i10 ! 歡迎您～

有出現就是正常

安裝 I10 步驟

C 槽新增 i10 目錄 C:\i10

若 PC 有權限控管請資訊室協助將安裝權限打開,在進行安裝

AdobeAIRInstall(20.0.0.260).exe **沒有 AIR 環境,第一次安裝需要

https://I10NAS.synology.me:5001/sharing/13foYxgwM

i10DRGProxy.exe ** DRG 試算界接程式需要安裝
https://I10NAS.synology.me:5001/sharing/vCAyfXyPC

2023TW_Hosp_1.1.5.air 為例安裝步驟
https://I10NAS.synology.me:5001/sharing/d5xaGBdiv

以上路徑下載下來放到 C:\i10\ **底下安裝
按右鍵以系統管理員身分安裝

AdobeAIRInstall(20.0.0.260) 安裝步驟



2023TW_Hosp_1.1.5.air 為例安裝步驟

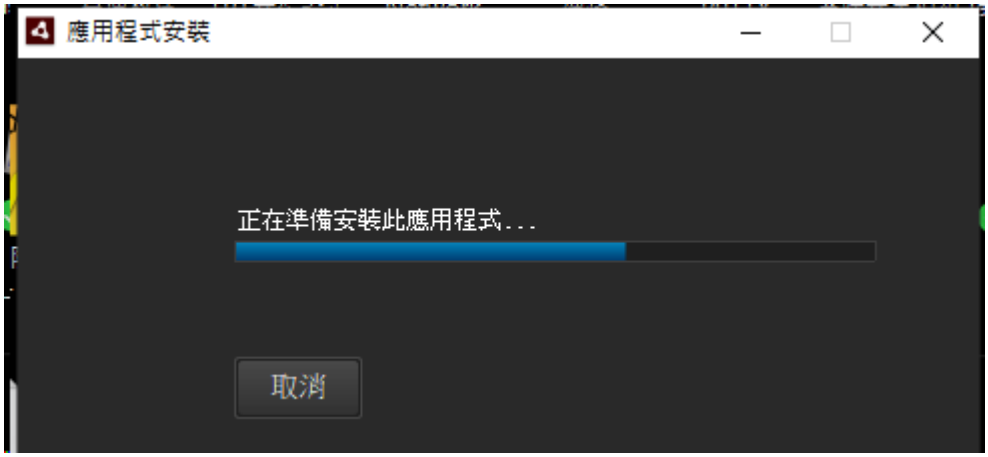

點擊安裝

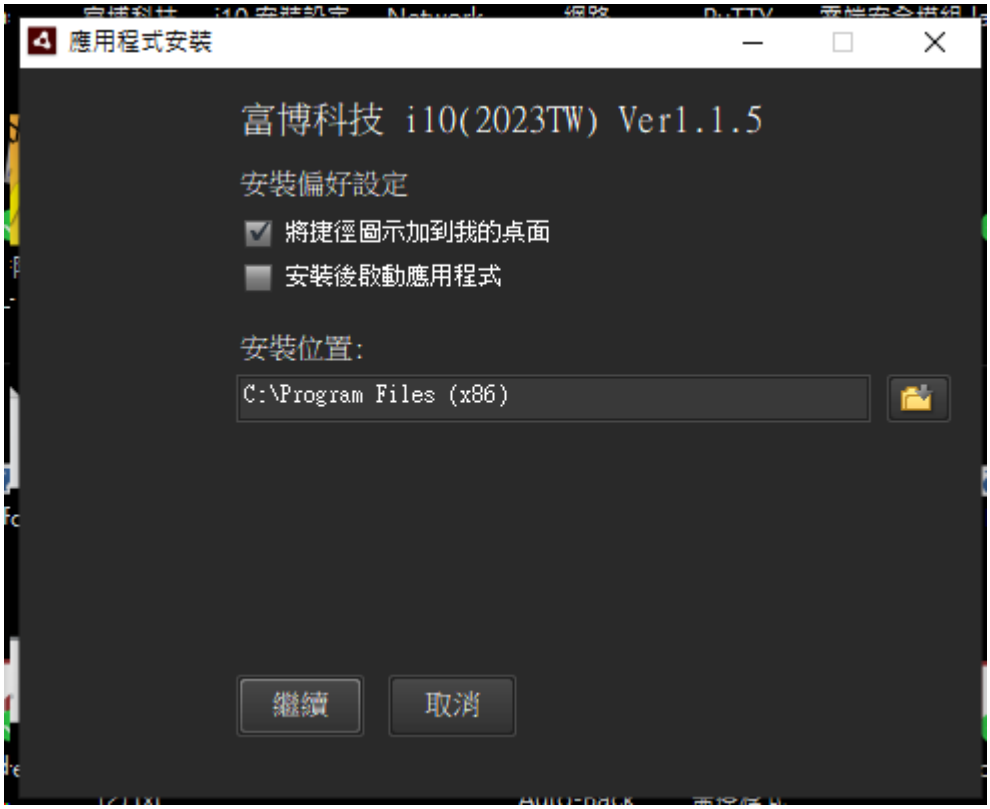

將安裝後啟動應用程式的勾勾拿掉

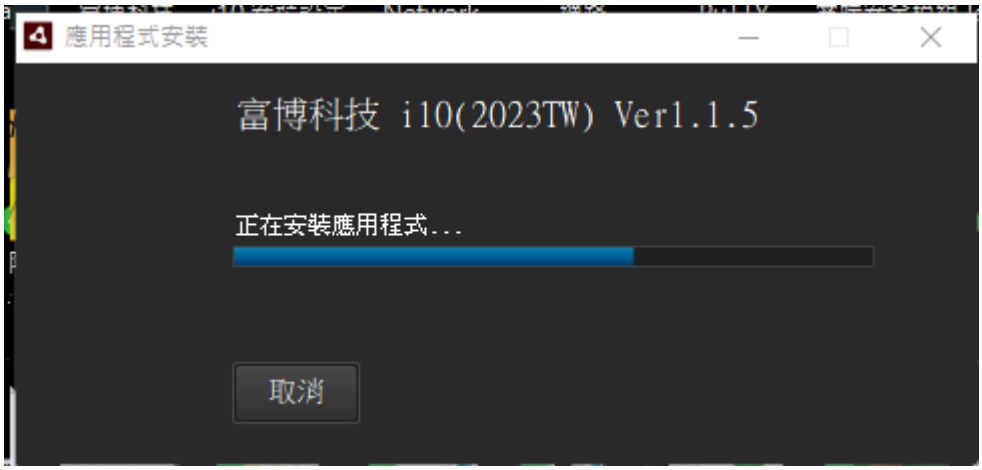

即可點擊桌面 i10 圖示， 

一般驗證過後 20 天 才會在驗證一次

若出現驗證失敗可以將錯誤畫面上面的 IP 提供給富博科技將 IP 設定白名單，完成後將程式關閉再重新啟動即可。

第一次設定,點選 Index to Diseases and Injuries 進入畫面

點選上面紅色框框位置進入以下,點選左上方 “A000000000 測試病患”,進入下個畫面

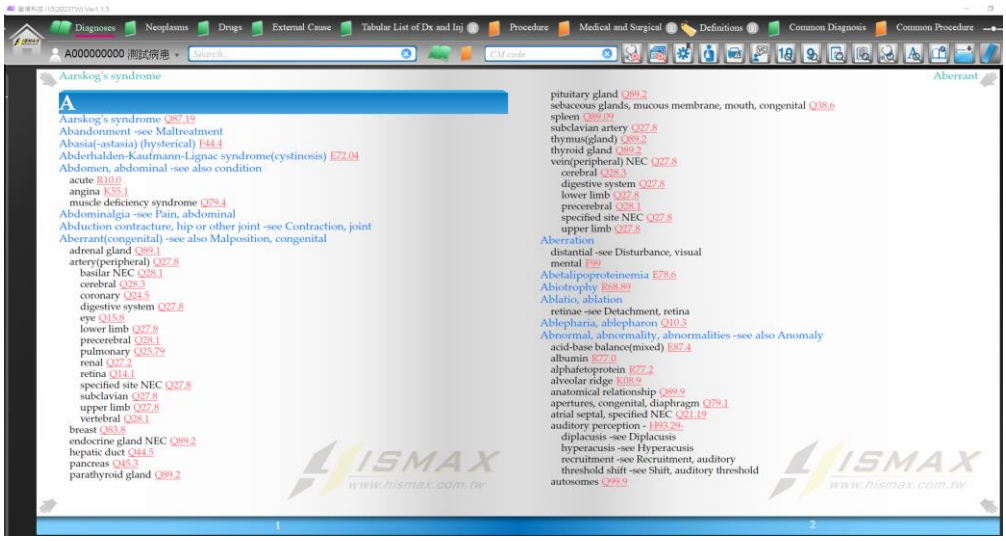

點選右上設定

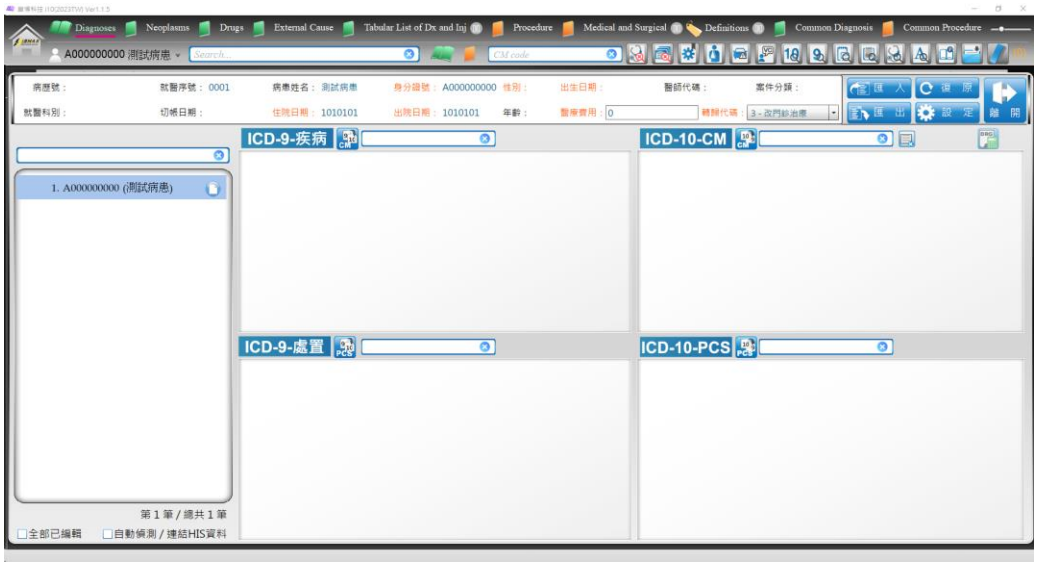

DRG 編碼服務要看院方是否要設定 健保局 DRG 預設路徑為
C:\MED\S_DRGService_XXX (XXX 是版號
注意確認 i10DrgProxy 是否有安裝

備份個人資料與匯入資料的位置

i10DRGProxy 安裝：

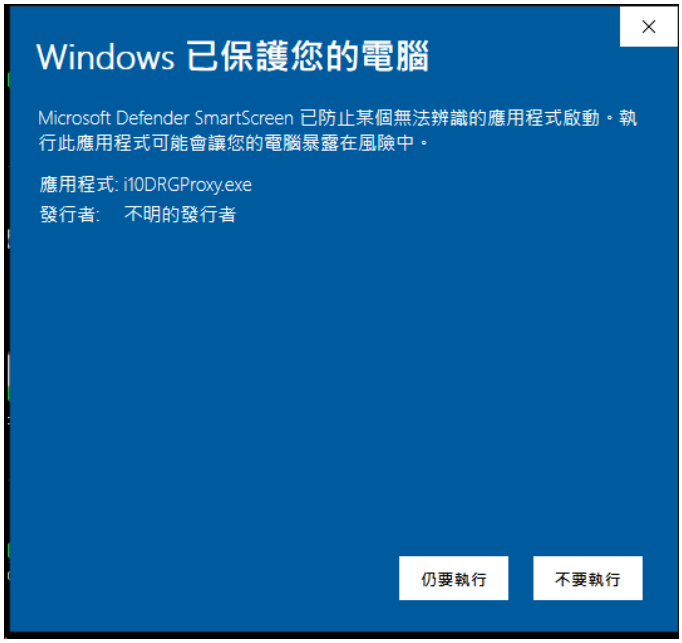

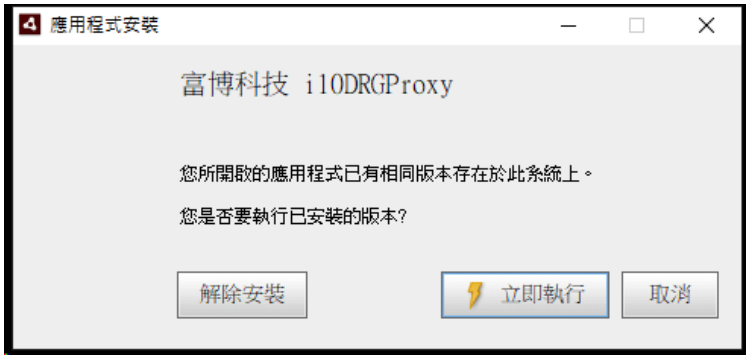

如果設定裡面有指定 3.x.x 跟 4.x.x 就會試算兩次 (**先試算 4.x.x 後再算 3.x.x**)

試算結果如下

如有**異動資料 一定要在重新試算一次** (右邊紫色 DRG 圖示為近一次試算結果)