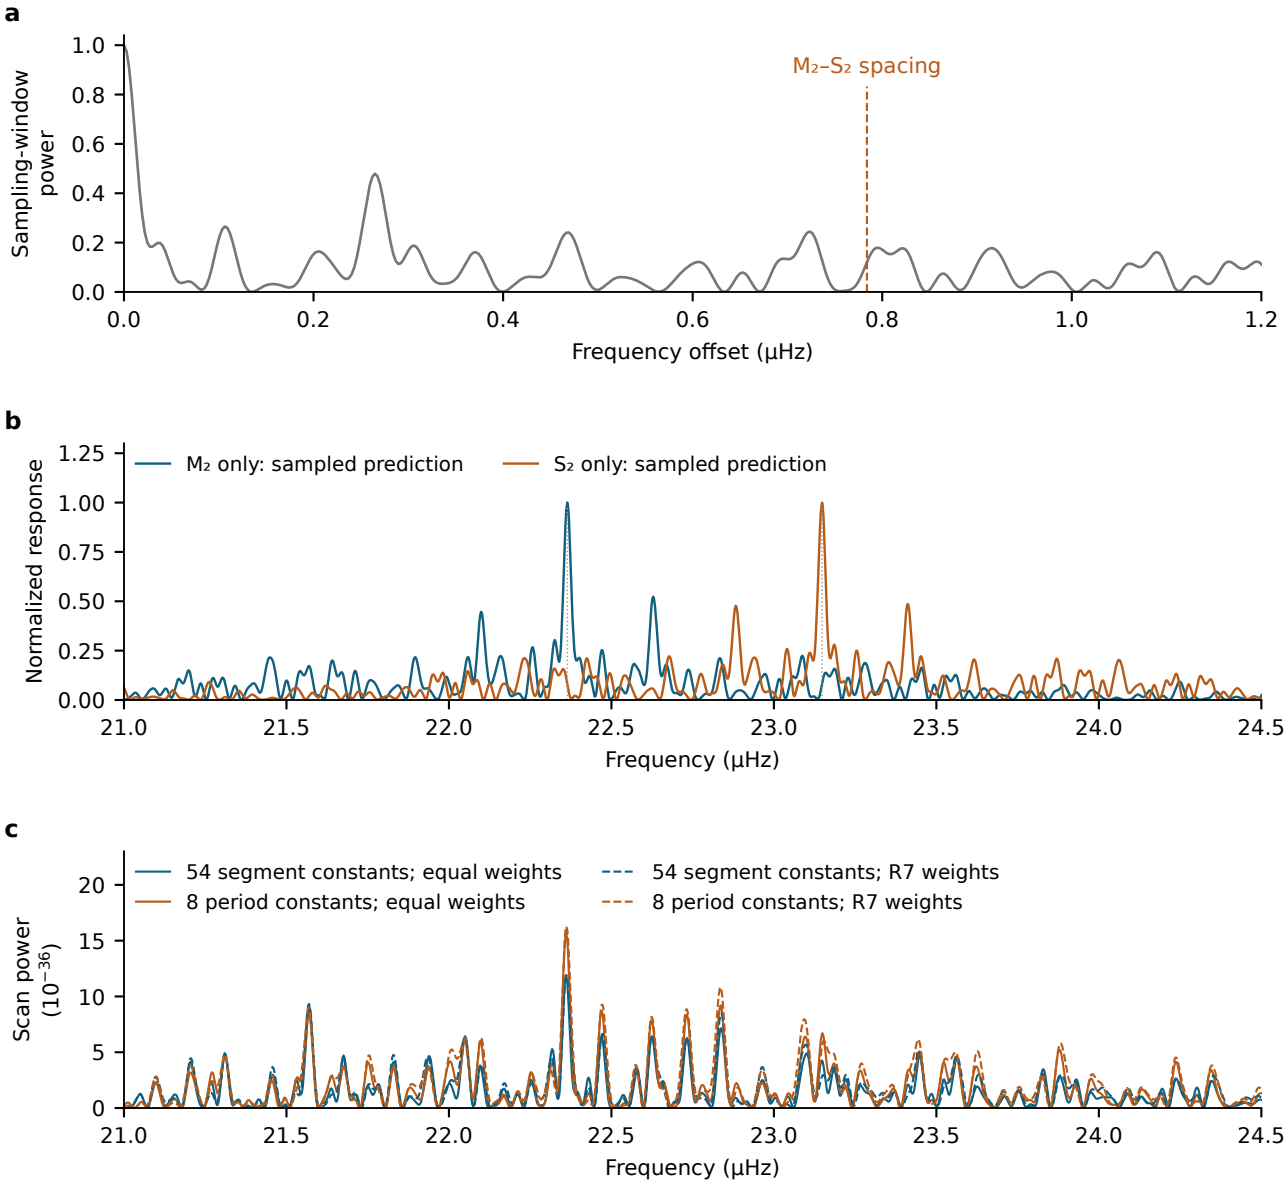

a
Sampling-window power
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
M₂–S₂ spacing
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Frequency offset (μHz)
b
Normalized response
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
M₂ only: sampled prediction
S₂ only: sampled prediction
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
Frequency (μHz)
c
Scan power (10^{-36})
20
15
10
5
0
54 segment constants; equal weights
8 period constants; equal weights
54 segment constants; R7 weights
8 period constants; R7 weights
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
Frequency (μHz)