



0152GBO, couveuse, avril (active)
24 journées, plaque 200 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 8,6 % ≤ 19,6	LDC 4,2 % ≤ 16,9	FFT 12,1 % ≤ 19,6	Énergie −1,2 % ≤ 12,1	Pointe −6,2 % ≤ 19,0
Fact. de charge 3,8 % ≤ 10,0	CORR_h 3,6 % ≤ 8,5	TVD_h 2,4 % ≤ 10,0	EXT_prof 21,9 % ≤ 31,4	Heure des pics 3,0 h > 2,0
Forme 1 h 2,7 σ ≤ 3,3	Forme 2 h 2,4 σ ≤ 3,2	Pire écart 1 h 20,0 % ≤ 33,8	Verdict rejetée	Pointe jour. P95 200 / 199 W

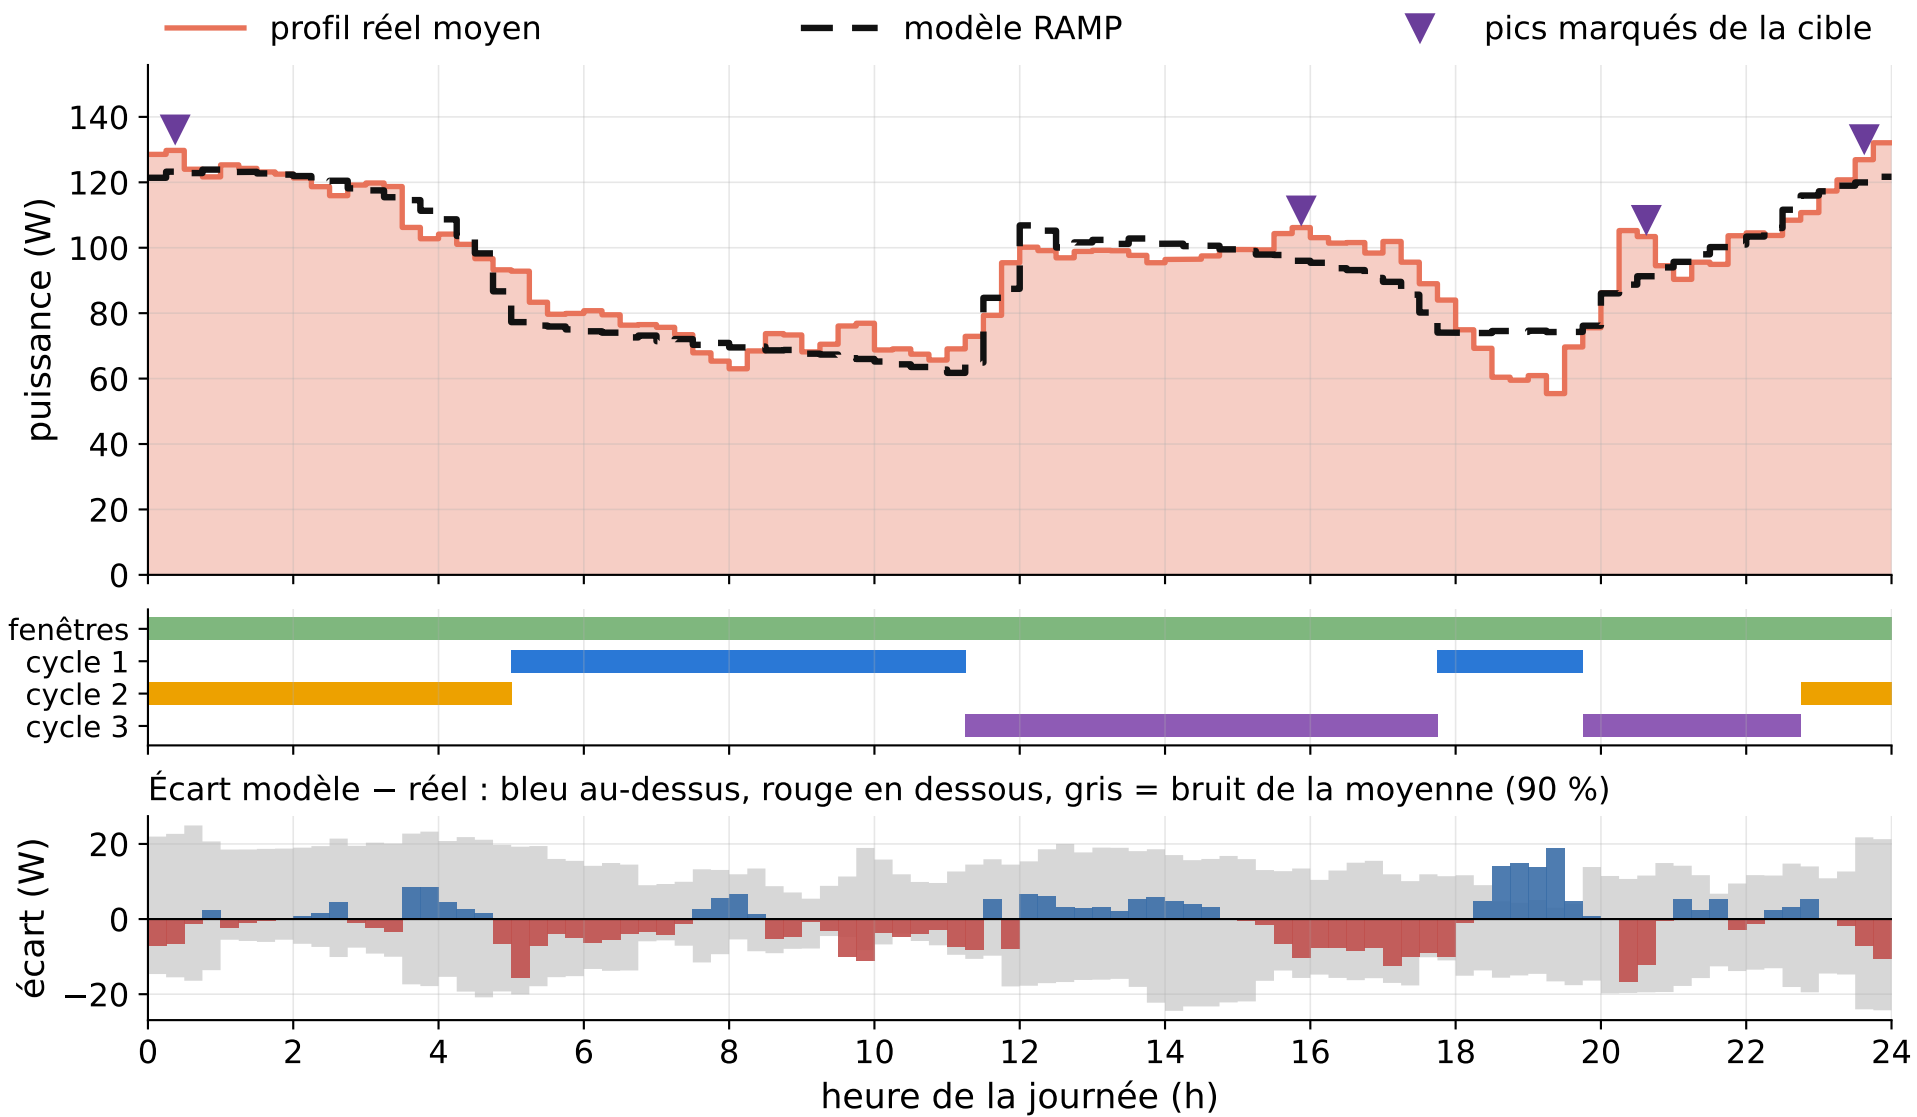

Courbe classée, LDC 4,2 %

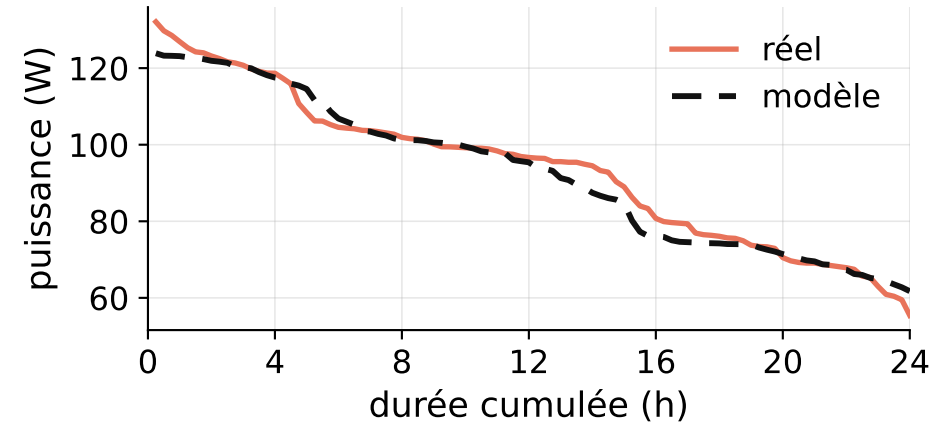

Harmoniques, FFT 12,1 %

