


CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE CÂMERA AEROFOTOGRAMÉTRICA



CERTIFICADO Nº

001/96



CALIBRAÇÃO REALIZADA PELO MÉTODO DO CAMPO TRIDIMENSIONAL
CAMPO DE CALIBRAÇÃO: SÃO LUIZ DO PURUNÃ
FOLHA 1/2

PROPRIETÁRIO:

ESTEIO - Engenharia e Aerolevantamentos S/A

CARACTERÍSTICAS DA CÂMERA

FABRICANTE:	CARL ZEISS	DISTÂNCIA FOCAL NOMINAL:	153 mm
MODELO DA CÂMERA:	RMK A 15/23	SÉRIE Nº:	137 474
TIPO DE LENTES:	PLEOGON A2	SÉRIE Nº:	137 504
QUADRO DO NEGATIVO:	23 x 23 cm	ABERTURA MÁXIMA:	f4

DADOS DA CALIBRAÇÃO

DATA DAS AEROFOTOS:	09/dez/1995	NÚMERO DE AEROFOTOS:	17
NÚMERO DE IMAGENS DOS ALVOS:	320	NÚMERO DE ALVOS:	34
FILME UTILIZADO:	Kodak Double - X	GRAUS DE LIBERDADE:	552
FILTRO UTILIZADO:	Amarelo	APARELHO UTILIZADO NAS OBSERVAÇÕES FOTOGRAMÉTRICAS:	Planicomp C-120 ZEISS

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

	PARÂMETROS	DESVIOS PADRÃO
DISTÂNCIA FOCAL CALIBRADA *	$c = 153,528 \text{ mm}$	$\sigma_c = 0,043$
COORDENADAS DO PONTO PRINCIPAL:	$x_0 = -0,063 \text{ mm}$ $y_0 = -0,037 \text{ mm}$	$\sigma_{x_0} = 0,016$ $\sigma_{y_0} = 0,017$
COEFICIENTES DA DISTORÇÃO RADIAL SIMÉTRICA:	$k_0 = -2,667 \text{ E} - 05$ $k_1 = -1,813 \text{ E} - 09$ $k_2 = -5,877 \text{ E} - 14$ $k_3 = -5,909 \text{ E} - 18$	$\sigma_{k_1} = 1,217 \text{ E} - 08$ $\sigma_{k_2} = 1,092 \text{ E} - 12$ $\sigma_{k_3} = 3,009 \text{ E} - 17$
COEFICIENTES DA DISTORÇÃO DESCENTRADA:	$p_1 = -6,278 \text{ E} - 07$ $p_2 = 7,172 \text{ E} - 07$	$\sigma_{p_1} = 1,254 \text{ E} - 07$ $\sigma_{p_2} = 1,495 \text{ E} - 07$

* Escolhida de modo a deixar o módulo da máxima distorção positiva igual ao da máxima distorção negativa.


RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DADOS

ANEA

RESPONSÁVEL PELA CALIBRAÇÃO


DATA: 01 / fev / 1996

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DE CÂMERA AEROFOTOGRAMÉTRICA



CERTIFICADO Nº


001/96



CALIBRAÇÃO REALIZADA PELO MÉTODO DO CAMPO TRIDIMENSIONAL
CAMPO DE CALIBRAÇÃO: SÃO LUIZ DO PURUNÃ
FOLHA 2/2


SISTEMA DE COORDENADAS FIDUCIAIS

COORDENADAS:

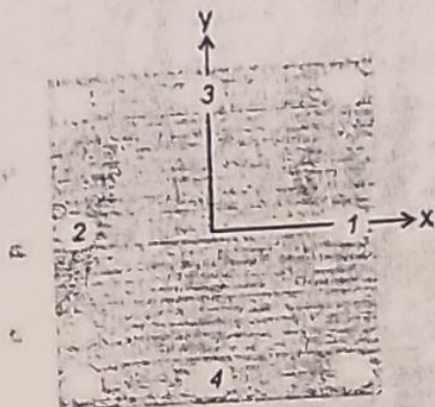

PONTO	x (mm)	y (mm)
1	113,000	0,016
2	-113,006	0,018
3	0,004	113,015
4	0,007	-112,975

CURVA DE DISTORÇÃO RADIAL SIMÉTRICA PARA DISTÂNCIA FOCAL CALIBRADA

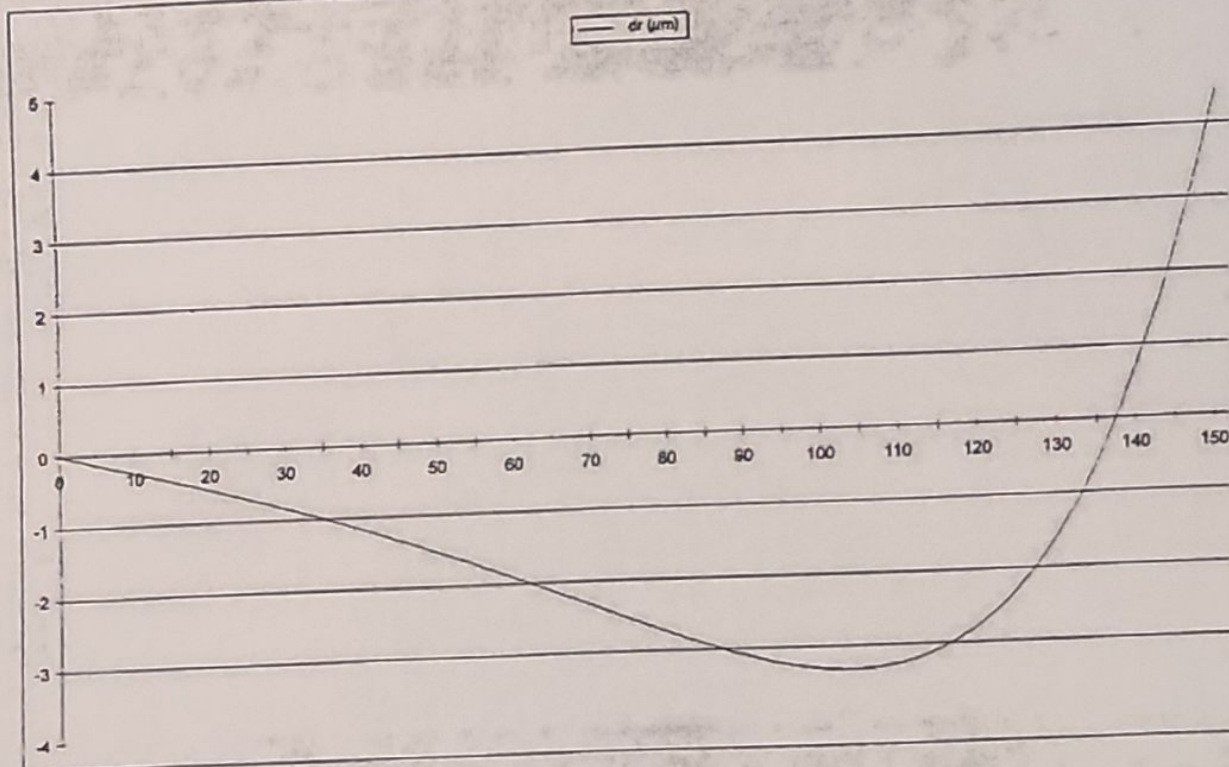

RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DADOS

ANEA

RESPONSÁVEL PELA CALIBRAÇÃO

DATA: 01 / fev / 1996