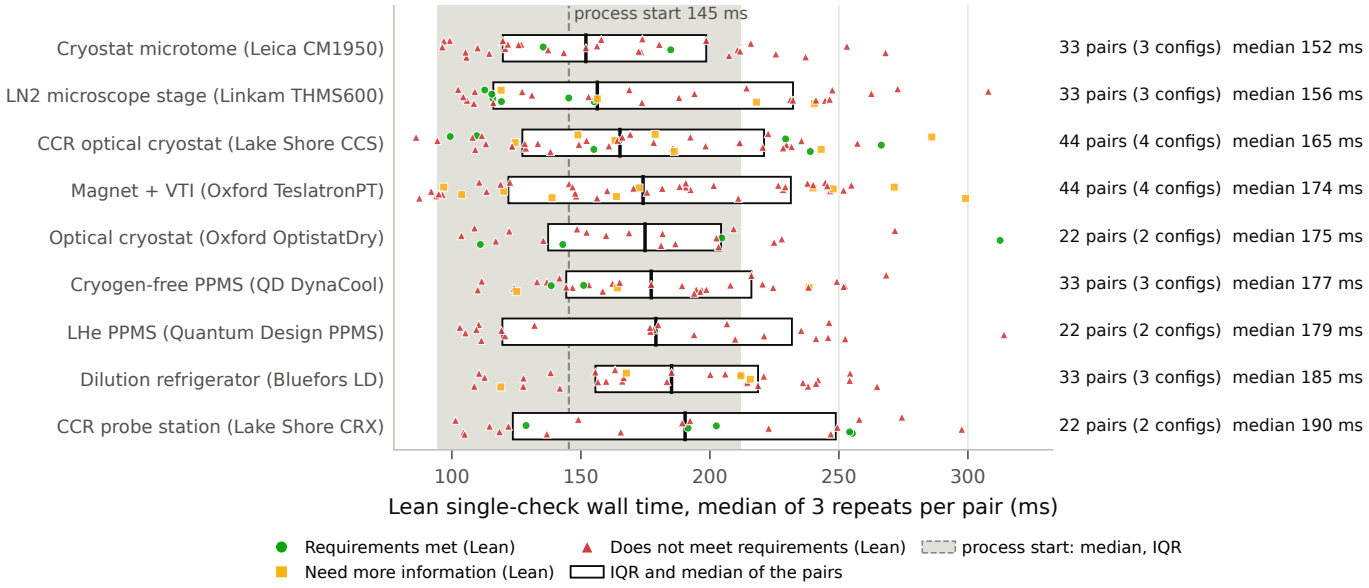
process start 145 ms
Cryostat microtome (Leica CM1950)
LN2 microscope stage (Linkam THMS600)
CCR optical cryostat (Lake Shore CCS)
Magnet + VTI (Oxford TeslatronPT)
Optical cryostat (Oxford OptistatDry)
Cryogen-free PPMS (QD DynaCool)
LHe PPMS (Quantum Design PPMS)
Dilution refrigerator (Bluefors LD)
CCR probe station (Lake Shore CRX)
33 pairs (3 configs) median 152 ms
33 pairs (3 configs) median 156 ms
44 pairs (4 configs) median 165 ms
44 pairs (4 configs) median 174 ms
22 pairs (2 configs) median 175 ms
33 pairs (3 configs) median 177 ms
22 pairs (2 configs) median 179 ms
33 pairs (3 configs) median 185 ms
22 pairs (2 configs) median 190 ms
100
150
200
250
300
Lean single-check wall time, median of 3 repeats per pair (ms)
Requirements met (Lean)
Does not meet requirements (Lean)
process start: median, IQR
Need more information (Lean)
IQR and median of the pairs