


수문조사시설 설치기준(제5조 관련)

1. 강수량관측소

- 가. 강수량계는 「자동기상관측장비의 표준규격」에 따라 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 나. 강수량계 수수구의 높이는 지면 바닥면에서 30cm 이상이어야 한다.
- 다. 수수구는 반드시 수평으로 설치한다.
- 라. 강수량계는 주변 장애물로부터 수수구와 장애물 높이 차이의 최소 2배 이상 떨어진 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 마. 강수량계 주위에 바람 보호막을 설치하는 것을 권장한다.
- 바. 강수량계는 동절기 강설에 대한 측정이 가능하도록 관련 설비를 설치하여야 한다.

2. 수위·유량·유사량관측소

- 가. 영점표고검정수준점의 표식은 수위관측소 인근에 설치하고, 10년 주기로 수준측량을 통해 확인하여야 하며, 지반침하 등으로 변동이 있다고 판단되는 경우에는 즉시 재확인 하여야 한다.
- 나. 수위관측소에는 영점표고검정수준점으로부터 영점표고를 정한 기준수위표를 반드시 설치하여야 한다.
- 다. 기준수위표의 영점과 최고눈금은 아래의 사항을 준수하여 설정한다.
 - 1) 기준수위표의 영점은 저수로 하상의 값 또는 최저수위보다 1m 이상의 값 중 높은 값을 설정하여 음(-)의 수위가 발생하지 않도록 한다.
 - 2) 기준수위표의 최고눈금은 제방이 있는 경우 제방보다 50cm 이상 높게, 제방이 없는 경우 계획홍수위 또는 기왕최고수위보다 1m 이상 높게 설정한다.

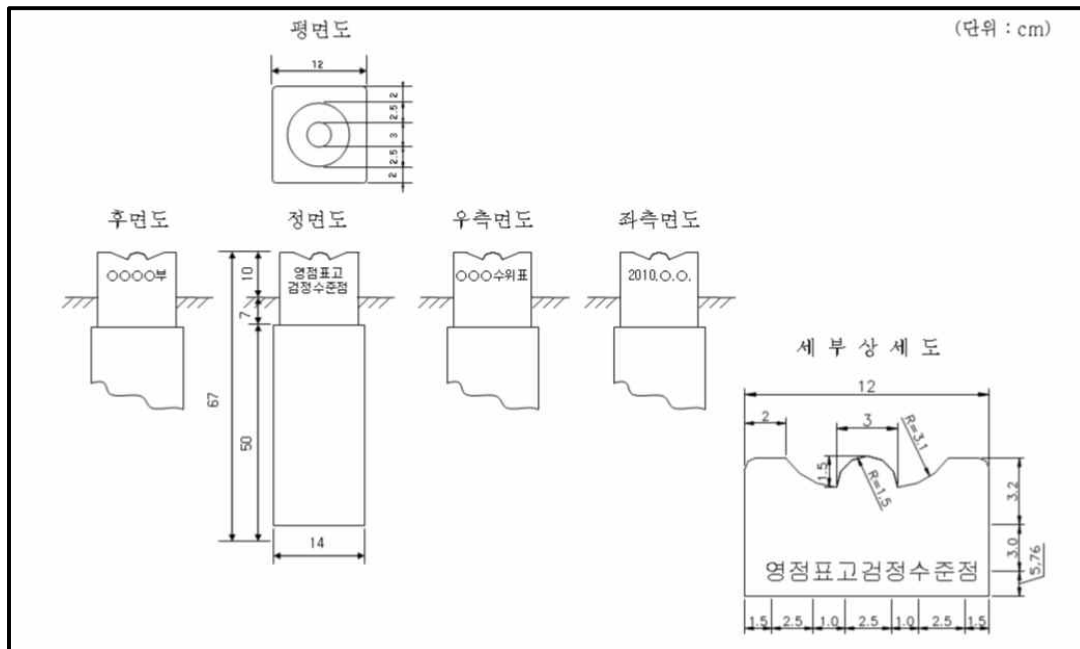

< 영점표고검정수준점 표준규격 >

라. 기준수위표의 규격은 폭 150mm 이상으로 하며, 표기 방법은 아래와 같다.

- 1) 최소눈금은 1cm 간격으로 표기(특수목적에 따라 1cm 이하 가능)
- 2) 10cm 간격으로 구분하고 숫자 표기(해당 수위범위 내에 숫자 표기)


예 : 5m 10cm를 표기할 때 → 5m 10cm 눈금의 바로 상단에 숫자 10을 검정색으로 표기

- 3) 1m 간격으로 구분하고 숫자 표기(m 단위는 적색 눈금 및 글자)

예 : 5m를 표기할 때 → 5m 눈금의 바로 상단에 숫자 5를 적색으로 표기

- 4) 수위표 바탕은 흰색을 원칙으로 한다. 다만, 야간에 시인성(視認性)을 확보하기 위하여 야광처리를 하거나 부식방지를 위하여 부식방지 처리를 한 경우에는 수위표의 눈금, 바탕, 숫자의 색은 다른 색을 사용할 수 있다.

마. 기준수위표의 훼손 등으로 교체하거나 지반 침하 등으로 인하여 기준수위표 영점표고의 변동이 있다고 판단될 경우에는 영점표고검정수준점으로부터 영점표고를 재확인하여야 한다.

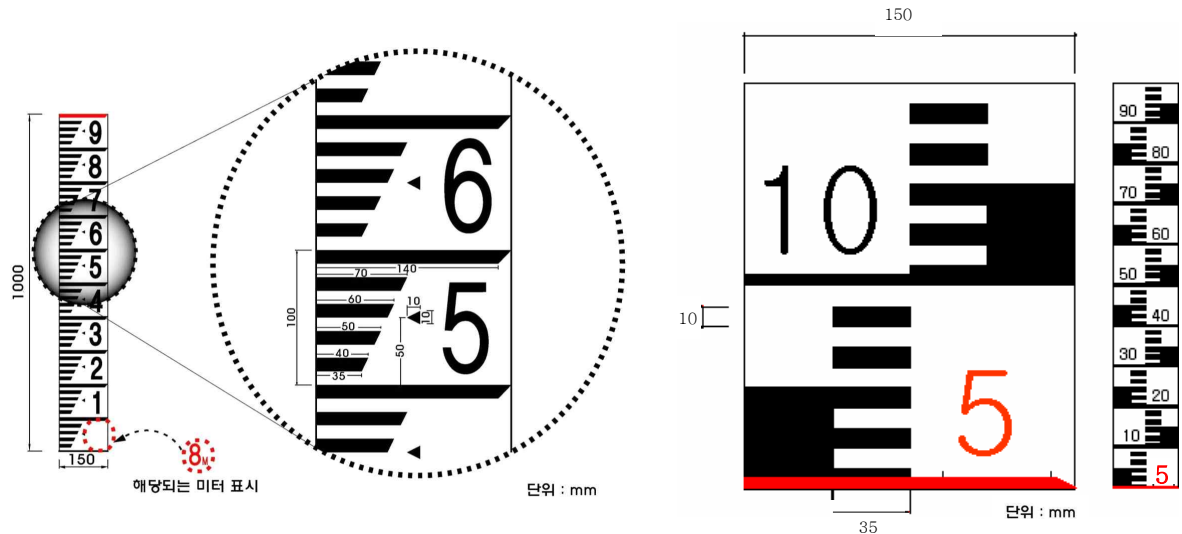

바. 영점표고 및 영점표고검정수준점은 "가"목 및 "마"목에 따라 설치하거나 변동사항이 있을 경우 설치기록과 변동기록을 별지 제1호서식과 별지 제2호서식에 따라 작성·보관하여야 한다.

사. 영점표고검정수준점과 기준수위표 영점표고의 최소 단위는 1mm로 한다.

아. 수위계에 의한 관측 수위값은 기준수위표에서 읽는 수위값과 동일하여야 한다.

자. 수위계 및 기준수위표의 최소눈금 단위표준은 1cm로 하며, 1cm 이하의 최소 눈금 단위를 사용할 경우에는 1cm 간격으로 수위를 관측할 수 있도록 한다.

3. 증발산량관측소

증발량 및 증발산량 관측을 위한 관측기기의 설치 조건은 「기상관측표준화법」을 따른다.

4. 토양수분량관측소

가. 표본추출기 또는 원격탐사나 다른 특정한 원리를 이용하여 토양수분량을 관측하는 경우에는 관측지점의 특성에 적합한 관측기기를 사용하여야 한다.

나. 관측기기는 자료의 동질성을 위하여 동일 관측지점에서는 가능한 한 통일된 장비를 사용할 것을 권장한다.

5. 공통사항

수문관측자료를 실시간 자동수집하기 위하여 통신시설을 설치할 경우에는 다음의 사항을 고려하여야 한다.

가. 통신망의 확보 가능 여부

나. 전원공급 및 접지 등의 보호시설 확보 가능 여부

다. 악기상에서의 안정성 확보 가능 여부

라. 통신시설의 경제성·신속성·효율성 등의 확보 가능 여부

마. 관련 통신시설과의 접속성·호환성·확장성 등의 확보 가능 여부

바. 통신시설의 유지·관리 용이성 등