

[별표 3] 가속노화시험에서의 상대습도의 사용

1. 많은 재질에 있어서 노화의 가속은 상대습도가 높은 환경에서 일어난다. 습도 수준을 사용할 때는 주의를 기울여야 하며, 온도가 결합된 경우에는 자연조건에서는 일어나지 않는 실제성이 떨어지므로 재질(물이 포함된 라미네이트나 공압출재질이 얇은 층으로 벗겨짐)의 비자연적인 물성변화를 가져올 수 있다.
2. 습도가 가속노화시험의 요건이 되는 경우,
 - 가. 상대습도 값은 수분함유량과 동등하게 결정되어야 하며, 또는
 - 나. 절대습도 값은 시험온도와 멸균보호시스템의 제품 사용기간(유효기간)의 실제 환경에서의 온도 사이에서 선택되어야 한다.주. 표1에서는 상대습도와 여러 온도 값에서의 수분함유량의 관계를 보여주고 있다,
3. 그림 2는 여러 온도에서의 상대습도 값에 따른 동등한 수분 함유량의 값을 결정할 때 사용할 수 있다.

표 1 상대습도와 다양한 온도에서의 일정 함수량의 관계

상승온도(°C)	상대습도(%)	함수량(ppm)
23	50.0	13,750
40	19.1	13,750
50	11.4	13,750
55	9.0	13,750
60	7.1	13,750

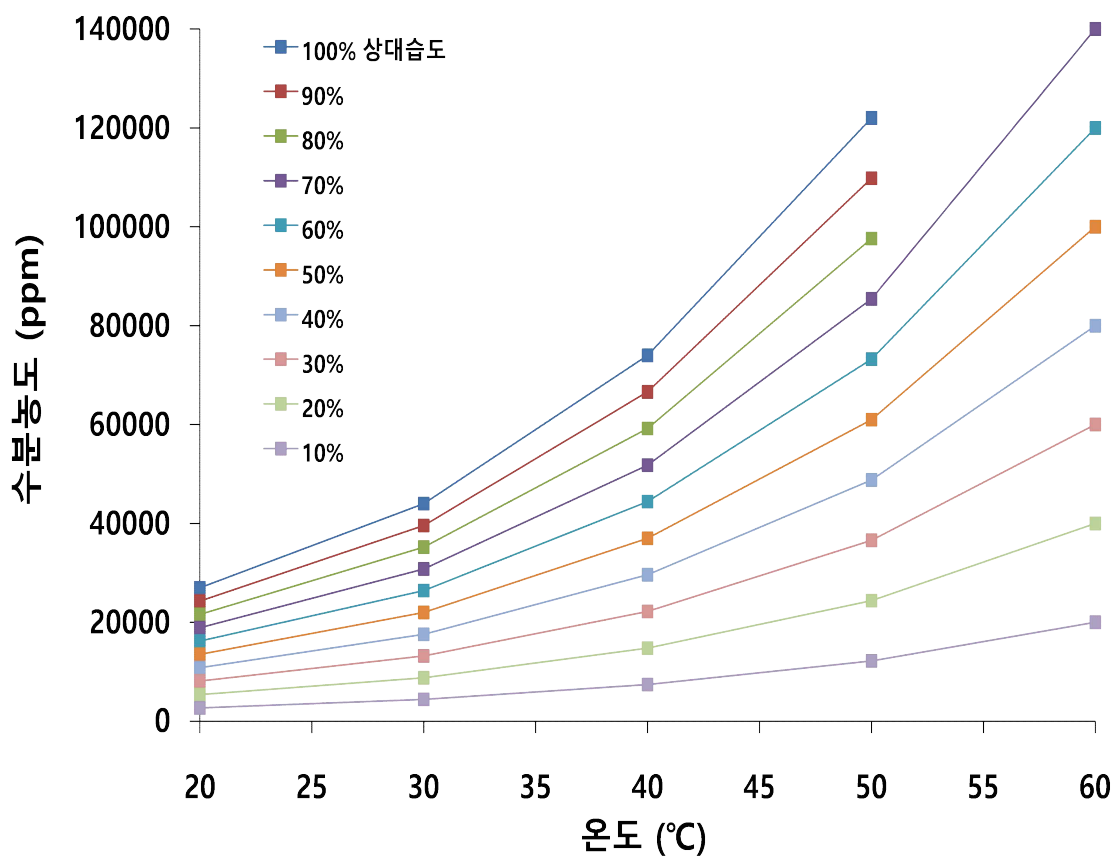


그림 2. 온도 및 상대습도에 따른 공기 중 수분 농도량