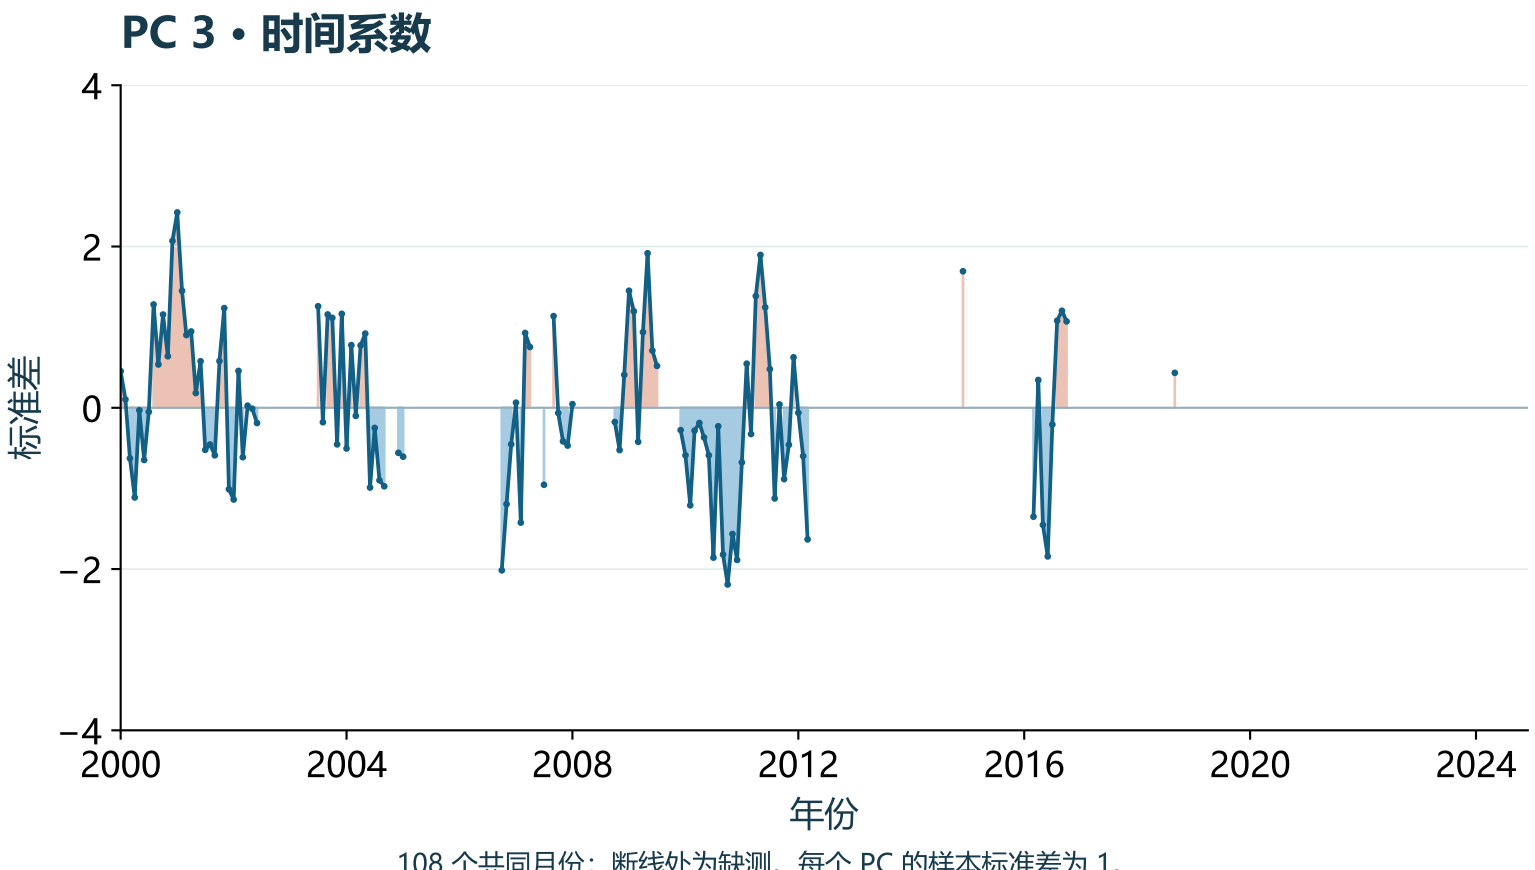

108 个共同月份；断线处为缺测。每个 PC 的样本标准差为 1。