

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n. IT-069-24-2213

Revision 0

Revisione

Issued in accordance with the Directive 2014/32/EU of the European Parliament and Council of February 26, 2014 on measuring instruments (MID) and with the Italian decree n° 22/2007 as modified by decree n. 84/2016 of 2016 May 19, which implements the Directive 2014/32/EU (MID) and 2015/13/EU.

Emesso in accordo con la Direttiva 2014/32/EU dell'Unione del Parlamento e del Concilio Europeo del 26 Febbraio 2014 sugli strumenti di misura (MID) e in accordo al decreto legislativo 8 Italiano n. 22/2007 come modificato dal decreto n. 84/2016 del 19 Maggio 2016 che recepisce la Direttiva 2014/32/EU (MID) a 2015/13/EU

Issued by:
Emesso da

Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale Srl
 Via Casilina Nord 246 km 68 03013 – Ferentino (FR) Italy

Issued to:
Emesso a

Shenzhen CalinMeter Co. Ltd
 Floor 6, Block A, Qiaode Tech Park, No.7 Guangming High-tech Zone, Tianliao
 Community, Yutang Sub-district, Guangming District, Shenzhen, China

Type of instrument:
Strumento

Diaphragm Gas Meter/Contatore del gas a membrana

Type designation:
Modelli

CA768 class G4 - G2.5 - G1.6

Measurand/ Misurando	Volume/Volume
Accuracy Class/Classe di accuratezza	1,5
Environmental Class/Classe Ambientale	M2 / E1
Location/Installazione	Closed / Al chiuso
Temperature Range/Intervallo di temperatura	(-25 / +55) °C
Cyclic volume /Volume ciclico	0,9 dm ³ / 1,2 dm ³
Applicable essential requirements Requisiti essenziali applicabili	Annex I and Annex III (MI-002)
Reference standards/ Norma di Riferimento	EN 1359:2017

Measurement range/ Campo di misura	Q _{min} /(m ³ /h)	Q _t /(m ³ /h)	Q _{max} /(m ³ /h)
G4	0,040	0,6	6,0
G2,5	0,025	0,4	4,0
G1,6	0,016	0,25	2,5

Date of initial issue:
Data di emissione del certificato

2025-06-27

Date of issue of this revision:
Data di emissione di questa revisione del
certificato

2025-06-27

Certificate valid until:
Certificato valido fino al

2035-04-28

On behalf of the Chief Executive Officer
 Per il rappresentante legale dell'ON 2213
 prof. Paolo Vigo

Digitally signed document in accordance with current legislation
 Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Mod-36 rev.03 issued on 2019-02-08

Pa.L.Mer. società consortile a r.l.

Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale
 Cap. Soc. € 685.020,00 – C.F. e P.IVA 01695130599
info@parcopalmer.it – Pec: palmer@legalmail.it
www.parcopalmer.it

Sede Legale

Via Carrara, 12/A – 04100 Latina (LT)
 Tel. 0773.40.36.16 – Fax 0773.63.02.02

Sede Amministrativa

Via Casilina Nord, 246 (km. 68,200) – 03013 Ferentino (FR)
 Tel. 0775.24.00.13 – Fax 0775.24.51.90

CLAUSES

The principal characteristics and the approval conditions are set out in the following appendix, which forms a part of the approval documents and consists of 4 pages. Partial publication or distribution of this report is forbidden without written approval of PA.L.MER. In accordance with the European Directive 2014/32/EU (MID), the manufacturer has to inform Pa.L.Mer. about any modifications, even if not significant, made or planned to be made to the above mentioned product. Any modifications made to the model without Pa.L.Mer. approval could invalidate the certificate. In case of new revisions of the certificate the latter version supersedes and reply the previous version. This certificate is a bilingual version. In case of official interpretation the reference part is the English version.

CLAUSOLE/

Le caratteristiche principali e le condizioni di approvazione sono riportate nella seguente appendice, che fa parte dei documenti di approvazione e si compone di 4 pagine. La pubblicazione o la distribuzione parziale di questo certificato è vietata senza l'approvazione scritta di PA.L.MER. In conformità con la Direttiva Europea 2014/32/UE (MID), il produttore deve informare Pa.L.Mer. di eventuali modifiche, anche se non significative, apportate o programmate da apportare al suddetto prodotto. Eventuali modifiche apportate al modello senza approvazione scritta di Pa.L.Mer. potrebbero invalidare il certificato. In caso di nuove revisioni del certificato, quest'ultima versione annulla e sostituisce la versione precedente. Questo certificato è una versione bilingue. In caso di interpretazione ufficiale la parte di riferimento è quella in inglese.

Space intentionally left blank
Spazio lasciato vuoto intenzionalmente

Pa.L.Mer. società consortile a r.l.

Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale
Cap. Soc. € 685.020,00 – C.F. e P.IVA 01695130599
info@parcopalmer.it – Pec: palmer@legalmail.it
www.parcopalmer.it

Sede Legale

Via Carrara, 12/A – 04100 Latina (LT)
Tel. 0773.40.36.16 – Fax 0773.63.02.02

Sede Amministrativa

Via Casilina Nord, 246 (km. 68,200) – 03013 Ferentino (FR)
Tel. 0775.24.00.13 – Fax 0775.24.51.90



1. Design of the instrument

Descrizione dello strumento

1.1. Construction, sensors and indication of the measurement results

Progettazione, sensore ed indicazione dei risultati della misura

The membrane gas meter undergoing the current EU approval route consists of a mechanical unit with a deformable-walled measuring chamber. The cyclic movement of the walls determines the measurement of the gas flowing inside. The cyclic movement is connected to an analog type mechanical roller metering system. This certificate is issued in piggy-back agreement between the rider Zhejiang Juhong Metering Solution Co.,Ltd and the carrier Shenzhen CalinMeter Co. Ltd. The certificate number headed the rider is IT-066-24-2213 rev.1. Any kind of revision or updating of the rider's certificate does not imply the updating of this certificate. All the properties of the gas meter, whether mentioned or not, shall not be in conflict with the legislation.

Il contatore del gas a membrana, sottoposto all'attuale percorso di omologazione UE è costituito da un'unità meccanica con una camera di misura a pareti deformabili. Il movimento ciclico delle pareti determina la misura del gas che fluisce all'interno. Il movimento ciclico è collegato ad un sistema di contabilizzazione meccanica a rulli di tipo analogico. Il presente certificato è rilasciato in accordo di piggy-back tra Zhejiang Juhong Metering Solution Co.,Ltd e il vettore Shenzhen CalinMeter Co. Ltd. Il numero del certificato intestato al rider è IT-066-24-2213 rev.1. Qualsiasi tipo di revisione o aggiornamento del certificato del rider non implica l'aggiornamento del presente certificato. Tutte le proprietà del contatore del gas, se menzionate o meno, non devono essere in conflitto con la legislazione.



Figure 1 –Example of diaphragm gas meter
Figura 1 – Esempio di misuratore del gas a membrana



The essential parts of the meter are as follows:

Le parti essenziali del contatore sono le seguenti

Description <i>Descrizione</i>	Material <i>Materiale</i>	Manufacturer <i>Costruttore</i>
Case Construction: <i>Involucro</i>	Painted sheet <i>Lamina metallica verniciata</i>	Zhejiang JuHong Metering Solution Co., Ltd.
Diaphragm: <i>Diaframma</i>	Synthetic fabric <i>Tessuto sintetico</i>	Fengcheng Yizhan Instrument Technology Co., LTD

1.2. Technical documentation folder

Faldone tecnico di Progetto

Technical Description of the meter: <i>Descrizione Tecnica</i>	Instruction manual issued on 11-03-2025
Installation and operation instructions: <i>Installazione ed istruzioni operative</i>	
Sealing Plan: <i>Piano di legalizzazione-Sigilli</i>	Legalization plan issued on 11-03-2025
Drawing of the meter and dimension of the housing: <i>Disegni del misuratore e dimensioni</i>	Instruction manual issued on 11-03-2025

2. Technical data

Dati Tecnici

Measurement of: <i>Misura di</i>	Gas volume/Volume di gas		
MID Accuracy Class: <i>Classe di accuratezza MID</i>	1,5		
Environment Class: <i>Classe ambientale</i>	M2 / E1		
Operating Temperature Range[°C]: <i>Intervallo di temperatura operativo</i>	-25 / +55		
Gas meter model: <i>Modello</i>	G1,6	G2,5	G4
Q_{min} [m ³ /h]:	0,016	0,025	0,040
Q_t [m ³ /h]:	0,25	0,4	0,6
Q_{max} [m ³ /h]:	2,5	4	6
Material: <i>materiale</i>	Steel Aluminum	Steel Aluminum	Steel
Cyclic volume V [dm ³]: <i>Volume ciclico</i>	0,9/1,2		



Max. admissible working pressure: <i>Massima pressione ammissibile in esercizio</i>	0,5 bar		
Display unit and resolution[dm ³]: <i>Unità di misura e risoluzione del display</i>	1,0		
Maximum totalizing volume[m ³]: <i>Massimo volume visualizzabile</i>	99999.999		
Standard connections: <i>Connessioni meccaniche</i>	M30X2 NPT 3/4 1" ¼ gas	M30X2 NPT 3/4 1" ¼ gas	1" ¼ gas
Distance between connections[mm]: <i>interasse</i>	110-130		110-130- 152,4

3. Security sealing

Piano di legalizzazione

The following items of the meters are sealed (Figure 2):

I seguenti elementi del contatore sono sigillati come mostrato in Figura 2

1. Volume totalizer/ *Totalizzatore Volume*
2. Meter case/ *Involucro del misuratore*

The meter is legally sealed by applying three red seals to the front cover of the meter. The measuring body of the meter is joined to the clockwork in such a way that the meter cannot be opened without breaking the seals

Il contatore viene sigillato legalmente applicando tre sigilli rossi sulla cover anteriore del misuratore. Il corpo di misura del contatore è unito all'orologeria in modo tale che non sia possibile aprire il contatore senza rompere i sigilli

4.



Figure 2 – Example of meter before seal process
Figura 2 – Esempio di contatore prima della sigillatura



Figure 3 – Example of meter sealed
Figura 3 – Esempio di contatore dopo la sigillatura



Figure 4 - Metrological seal with trademark
Figura 4 – Sigillo metrologico con marchio

5.

6. Labeling and inscriptions

Etichetta ed iscrizioni

The label contains the following MID requested inscriptions, as shown in Figure 3:

L'etichetta contiene le seguenti indicazioni come previsto dalla direttiva MID (Figura 3)

- Name of the manufacturer, and his trade mark/ *Nome del fabbricante e suo logo*
- Gas meter model/ *Modello*
- MID Accuracy Class/ *Classe di accuratezza MID*
- Operating Temperature Range/ *Campo di temperatura*
- Q_{min}
- Q_t
- Q_{max}
- V
- t_{sp}
- t_b
- EU Type Certification/ *Numero di certificato UE del tipo*



- Identification number of the notified body for module D
Numero di identificazione dell'Organismo Notificato per il modulo D
- Max. admissible working pressure/*Massima pressione di esercizio*

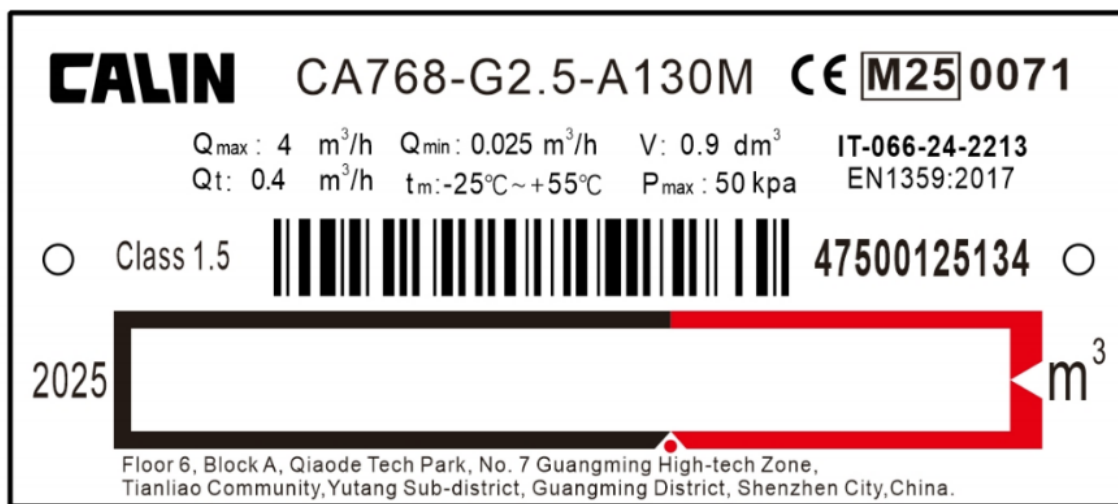


Figure 4 –Example of metrological label for all the models
Figura 4 – Esempio di etichetta metrologica per tutti i modelli

7. Certificate revisions

Revisioni del Certificato

Revision No <i>Revisione N°</i>	Issued on <i>Emessa in data</i>	Revision description <i>Descrizione della revisione</i>
0	2025-06-27	First Issue <i>Prima emissione</i>