INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN

Código de equipo	ECOGRAF-8425VS5	Fecha de revisión	22/09/2026
Marca	General Electric	Sede	Nordelta
Modelo	VIVID S5	Sector	Ecografía
Número de serie	8425VS5	Ubicación	Nordelta-Consult-Cons21

LIMPIEZA DE FILTROS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Filtros	Revisar y limpiar filtros	Pasó	Con un filtro faltante, ya reportado en el preventivo anterior

BASE DE DATOS

Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Memoria	Realizar limpieza de base de datos	Falló	A pesar de mostrar solo un 3.8% de almacenamiento ocupado, cuenta con 606 estudios en cola que no es posible eliminar

EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO

Resultado final
Falló

Observaciones:

El equipo se encuentra parcialmente operativo. Los estudios en cola que no permite eliminar afectan el funcionamiento del equipo. A su vez, no almacena la fecha y hora al configurarlo correctamente.

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	SANATORIO LAS LOMAS
	ECOGRAFO	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Filtros



Figura 2: rackball

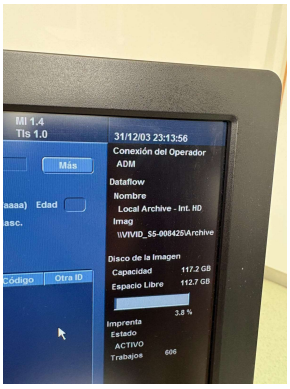


Figura 3: Almacenamiento/Fecha y hora

Técnico responsable: Milagros Casademunt	Supervisa: Carlos Joaquin Perez