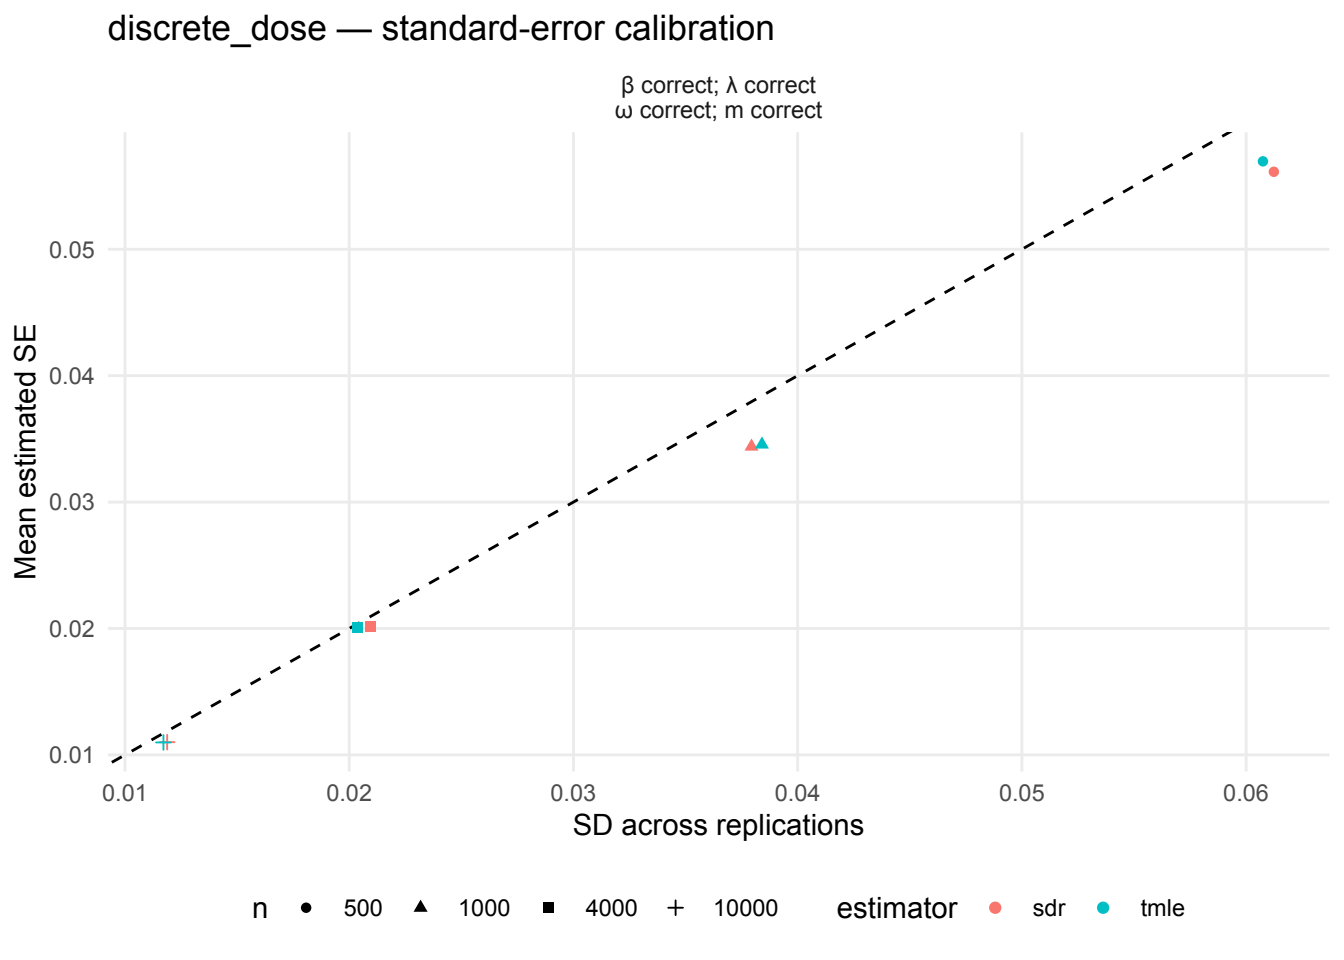
discrete_dose — standard-error calibration
β correct; λ correct
ω correct; m correct
Mean estimated SE
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
SD across replications
n
500
1000
4000
10000
estimator
sdr
tmle