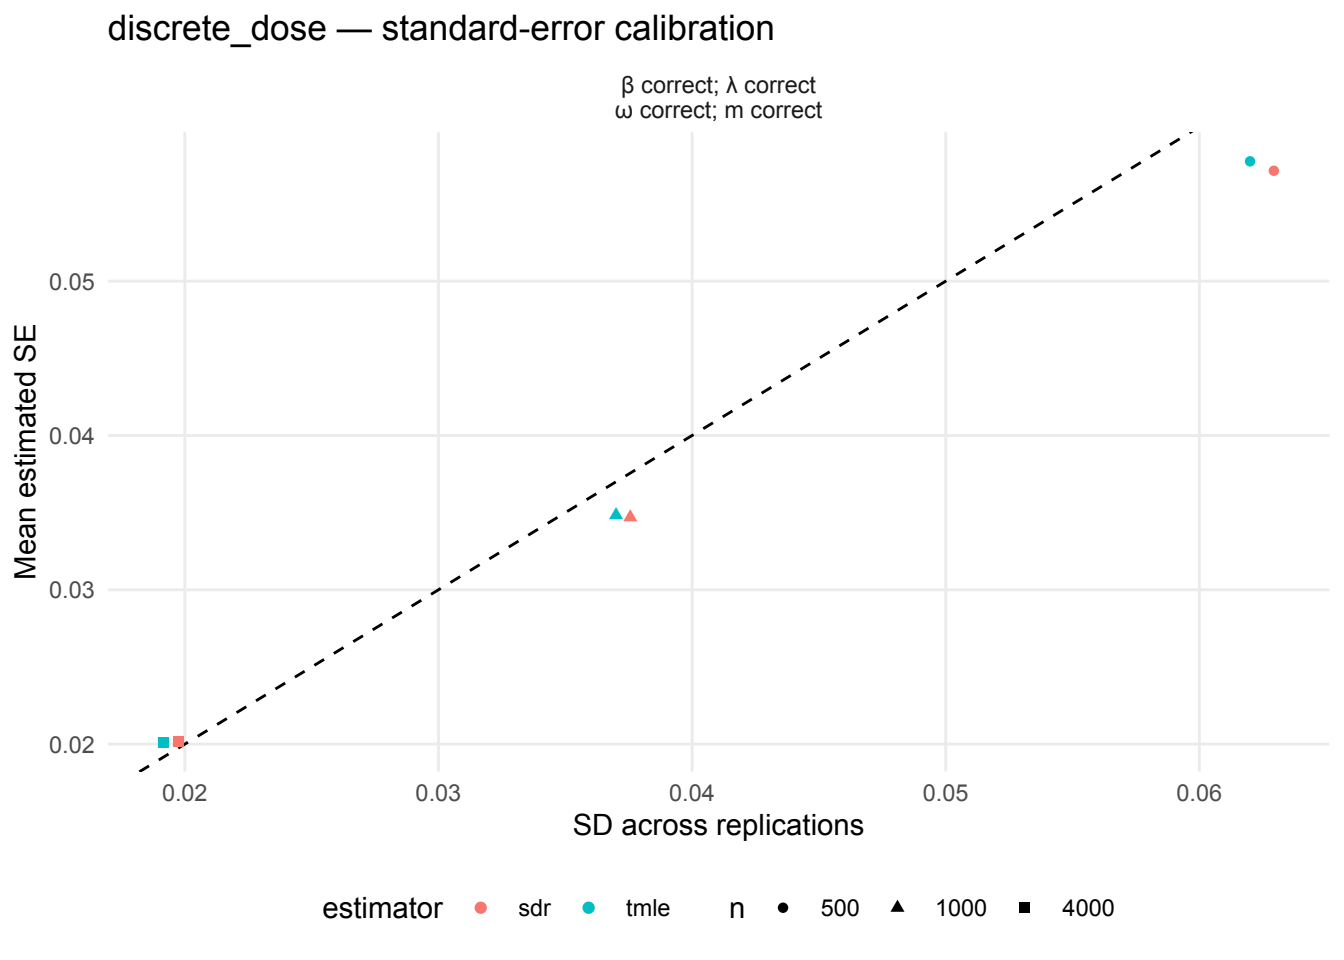
discrete_dose — standard-error calibration
β correct; λ correct
ω correct; m correct
Mean estimated SE
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
SD across replications
estimator
sdr
tmle
n
500
1000
4000