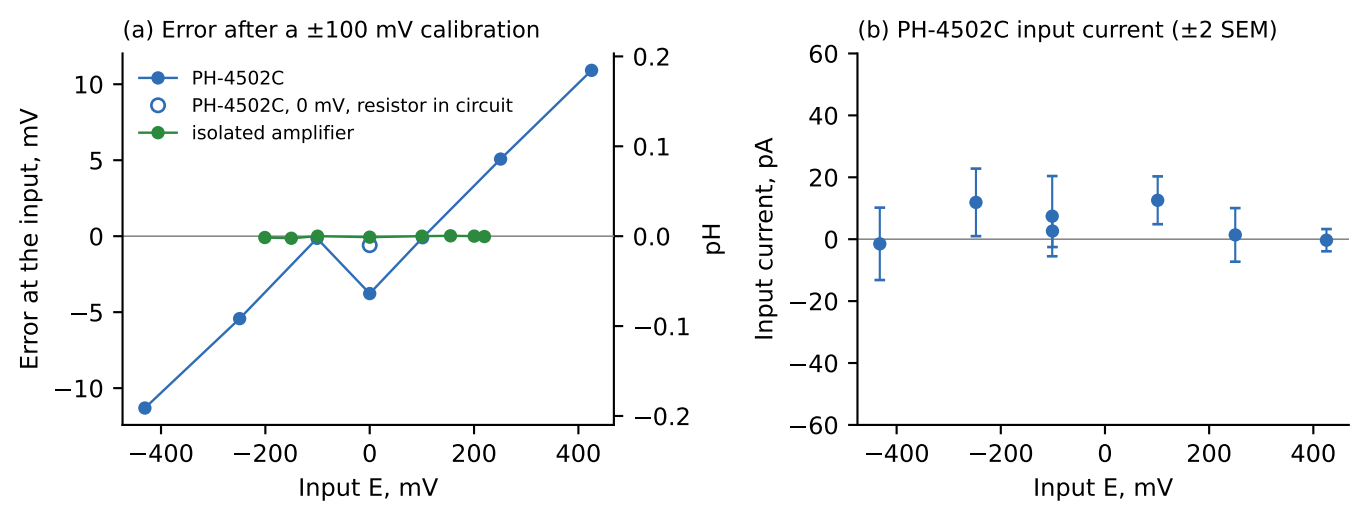
(a) Error after a ±100 mV calibration
PH-4502C
PH-4502C, 0 mV, resistor in circuit
isolated amplifier
Error at the input, mV
pH
Input E, mV
10
5
0
−5
−10
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−400
−200
0
200
400
(b) PH-4502C input current (±2 SEM)
Input current, pA
Input E, mV
60
40
20
0
−20
−40
−60