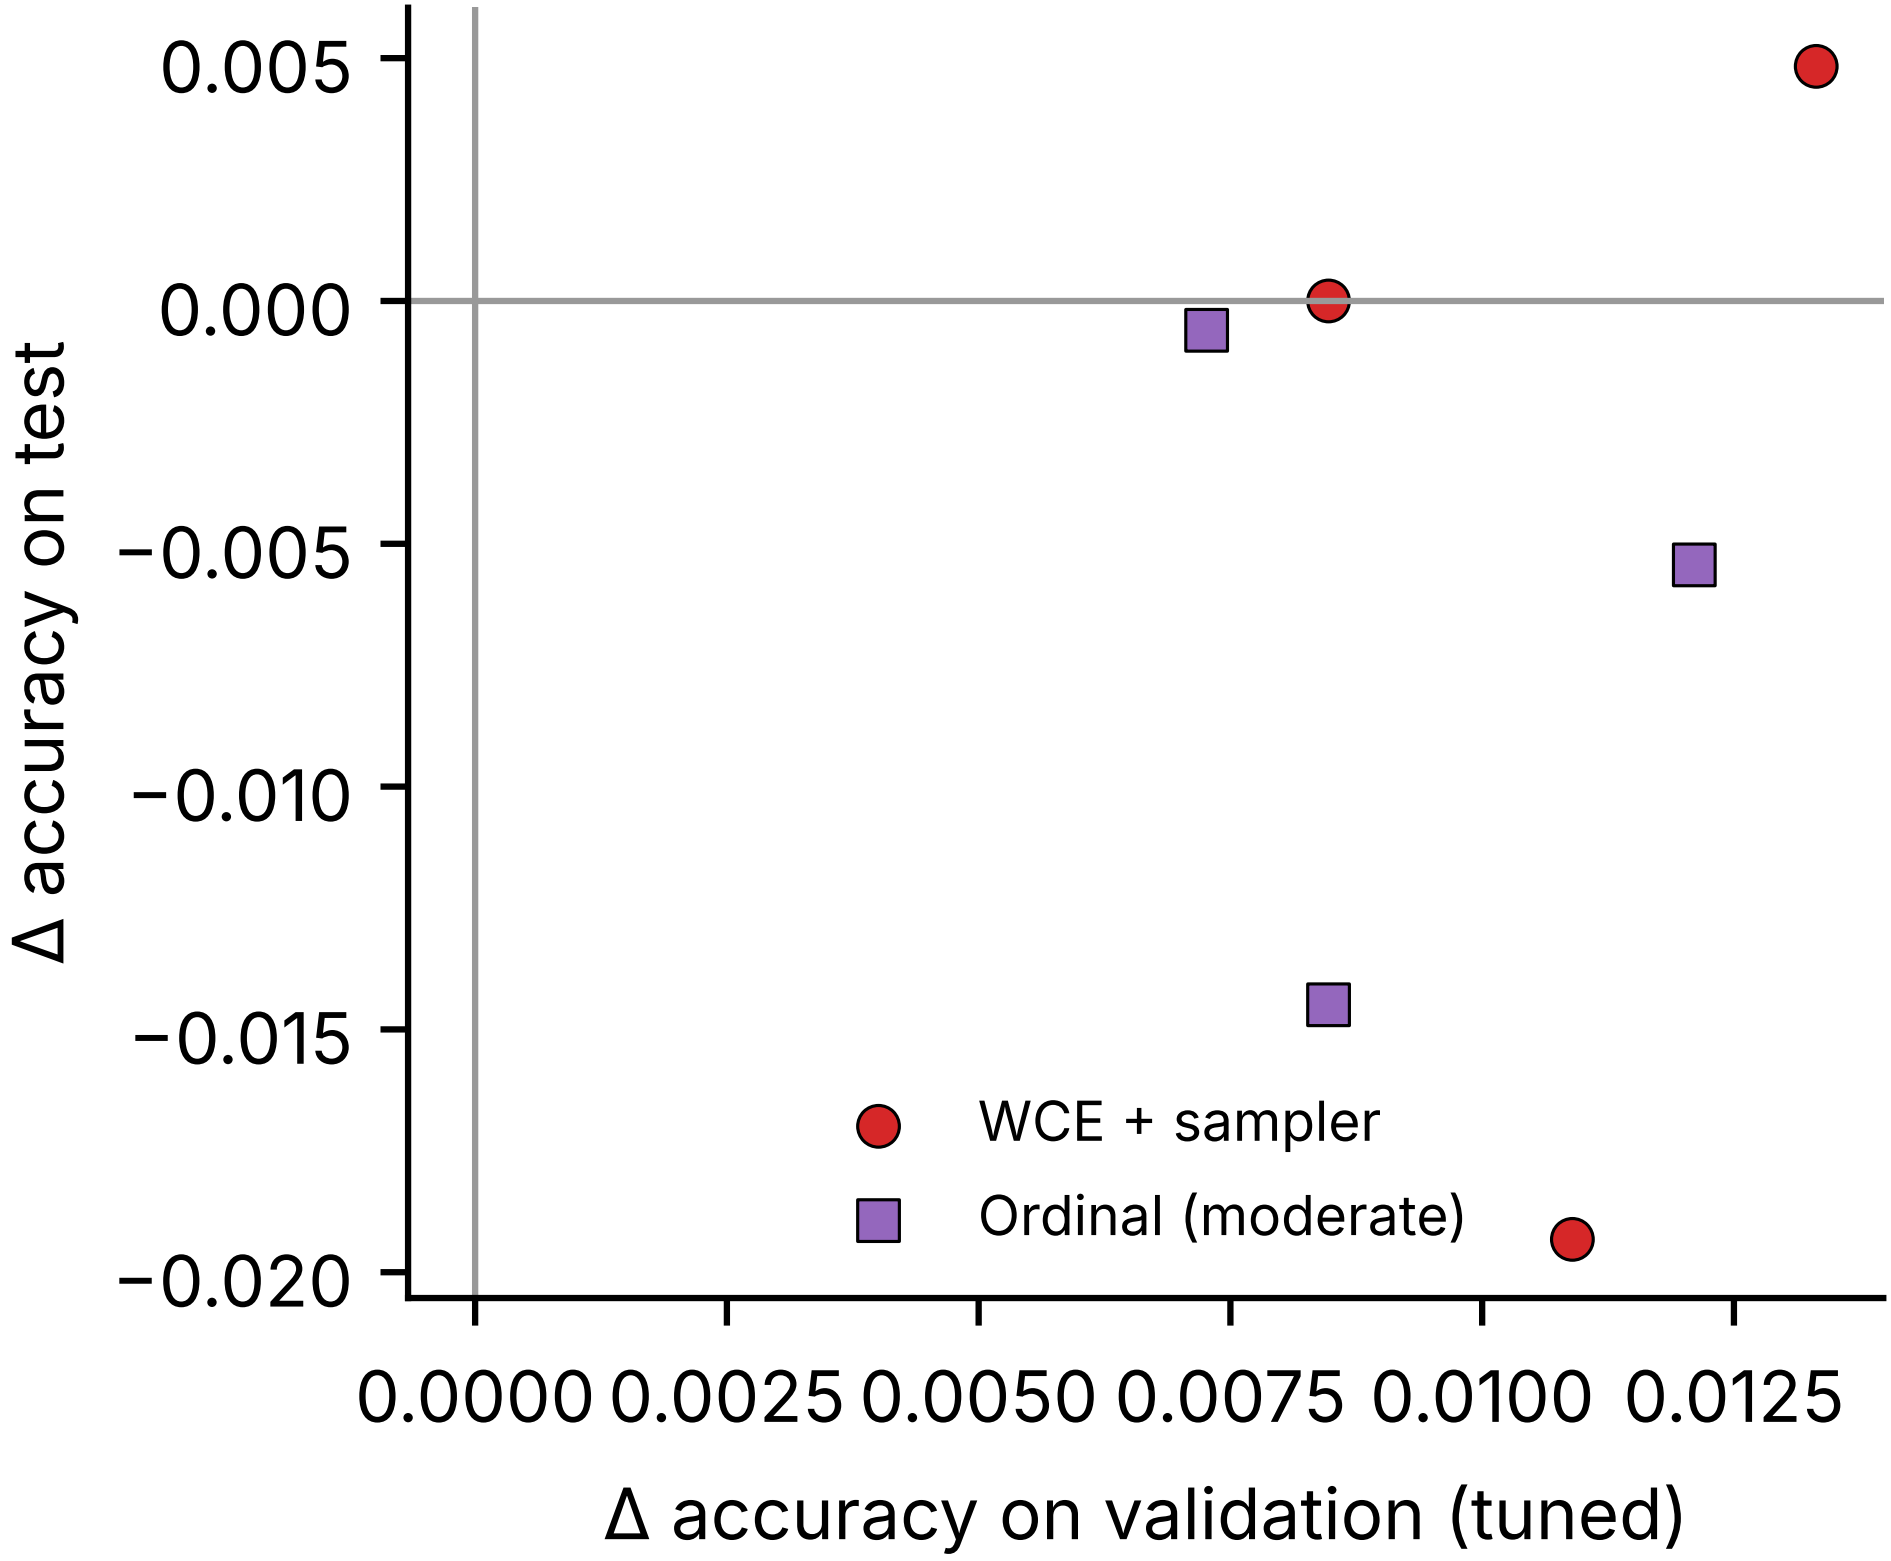
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
Δ accuracy on test
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
0.0125
Δ accuracy on validation (tuned)
WCE + sampler
Ordinal (moderate)