

Tontura em Foco


NONAMEIER SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA - 30.925.688/0001-81

Pág: 1

WinAudio (#WAUD9301694)	Avaliação Audiológica	Emissão: 30/07/2026
Paciente: PAULO DOS SANTOS VIEIRA	Sexo: Masculino	
Data de Nascimento: 23/04/1953	Idade: 73 anos e 3 mes(es)	Data do Exame: 30/07/2026
Tipo Consulta: Particular	Audiômetro: VIBRASOM (Calibração: 10/05/2026)	


AUDIOMETRIA TONAL

ORELHA DIREITA

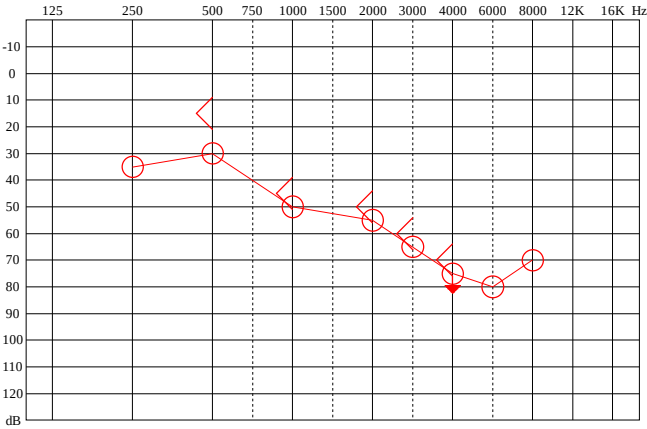

LRF: 45 dB
LDV:

ORELHA ESQUERDA

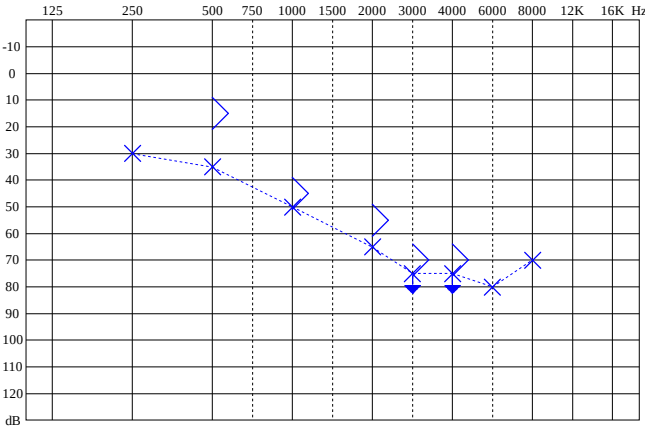

LRF: 50 dB
LDV:

Índice Percentual de Reconhecimento de Fala

	Intensid	Monossil	Dissil	Trissil
Pal. Faladas	—	25	25	25
OD	85 dB	60 %	76 %	
OE	90 dB	64 %	72 %	

Mascaramento (em dB)

	VA		VO		LOGO
	Min	Max	Min	Max	Quant
OD					
OE					

PARECER AUDIOLÓGICO

PERDA AUDITIVA NEUROSENSORIAL DE GRAU MODERADO COM COMPONENTE MISTO EM AMBAS AS ORELHAS

**IRF REALIZADO COM GRAVAÇÃO -CD DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL


Tontura em Foco

NONAMEIER SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA - 30.925.688/0001-81

Pág: 2

WinAudio (#WAUD9301694)	Avaliação Audiológica	Emissão: 30/07/2026
Paciente: PAULO DOS SANTOS VIEIRA	Sexo: Masculino	
Data de Nascimento: 23/04/1953	Idade: 73 anos e 3 mes(es)	Data do Exame: 30/07/2026
Tipo Consulta: Particular	Audiômetro: VIBRASOM (Calibração: 10/05/2026)	

IMITÂNCIA ACÚSTICA - Sonda: 226 Hz

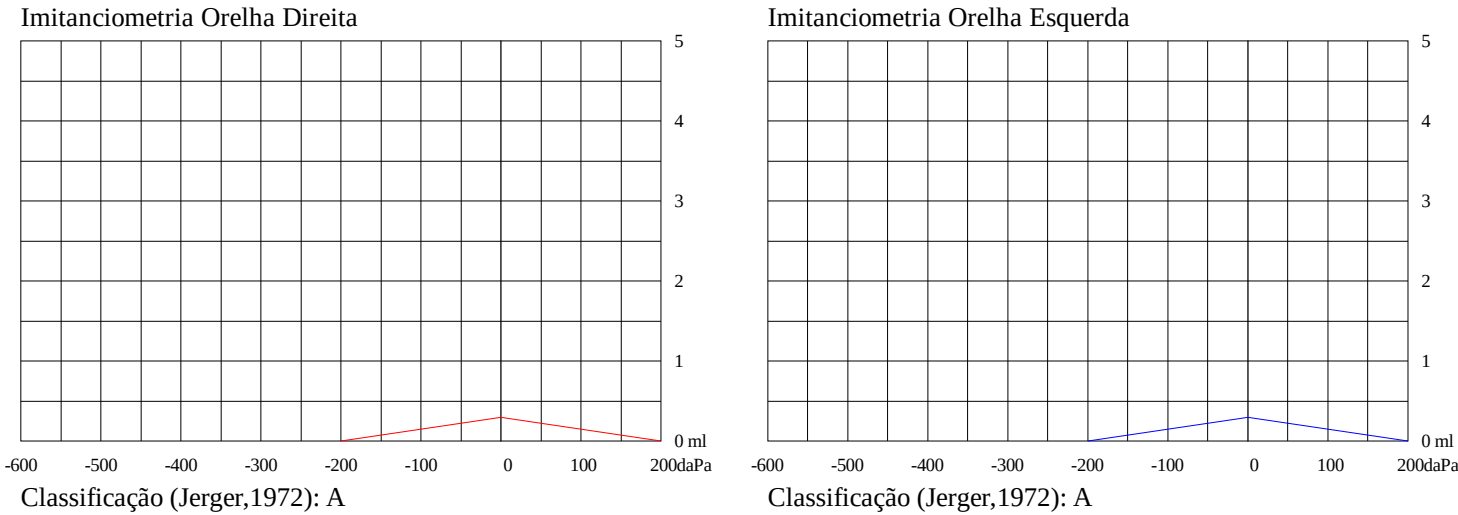

Reflexo Acústico

Orelha Direita

Hz	Limiar	Contra OD	Diferença	IPSI
500	30	AUS		AUS
1000	50	AUS		AUS
2000	55	AUS		AUS
4000	75	AUS		AUS

Orelha Esquerda

Hz	Limiar	Contra OE	Diferença	IPSI
500	35	AUS		AUS
1000	50	AUS		AUS
2000	65	AUS		AUS
4000	75	AUS		AUS