


Measurement Details	Measurement Details
Benutzername mastersizer	Analyse Datum Zeit 08.05.2025 16:04:04
Probenname HD Powder WILO	Messung Datum Uhrzeit 08.05.2025 16:04:04
SOP Dateiname AeroS.cfg	Ergebnis Quelle Messung
Analysis	Result
Partikelname NdFeB non magnetic	Konzentration 0,0070 %
Partikel Brechungsindex 1,300	Breite 1,552
Partikel Absorptionswert 0,500	Gleichförmigkeit 0,474
Name Dispergiermedium Dry dispersion	Spezifische Oberfläche 5,308 m²/kg
Brechungsindex Dispergiermedium 1,000	D [3;2] 149 µm
Streuungsmodell Mie	D [4;3] 244 µm
Analyse-Modell Universal	Dv (10) 87,0 µm
Gewichtete Abweichung 0,72 %	Dv (50) 223 µm
Laserabschattung 0,37 %	Dv (90) 433 µm

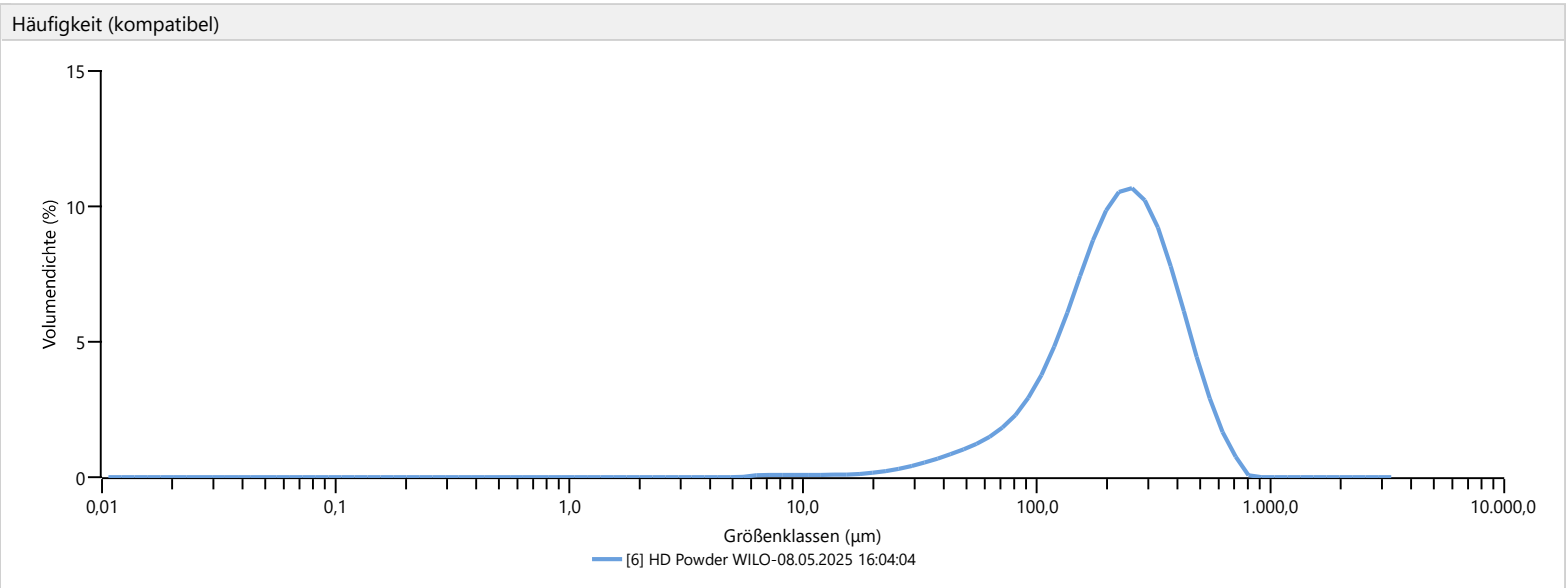

Ergebnis													
Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In	Größe (µm)	% Volumen In
0,0100	0,00	0,0597	0,00	0,357	0,00	2,13	0,00	12,7	0,07	76,0	1,90	454	3,69
0,0114	0,00	0,0679	0,00	0,405	0,00	2,42	0,00	14,5	0,08	86,4	2,43	516	2,41
0,0129	0,00	0,0771	0,00	0,460	0,00	2,75	0,00	16,4	0,10	98,1	3,12	586	1,37
0,0147	0,00	0,0876	0,00	0,523	0,00	3,12	0,00	18,7	0,13	111	4,01	666	0,62
0,0167	0,00	0,0995	0,00	0,594	0,00	3,55	0,00	21,2	0,18	127	5,06	756	0,00
0,0189	0,00	0,113	0,00	0,675	0,00	4,03	0,00	24,1	0,25	144	6,20	859	0,00
0,0215	0,00	0,128	0,00	0,767	0,00	4,58	0,00	27,4	0,34	163	7,31	976	0,00
0,0244	0,00	0,146	0,00	0,872	0,00	5,21	0,00	31,1	0,45	186	8,24	1110	0,00
0,0278	0,00	0,166	0,00	0,991	0,00	5,92	0,06	35,3	0,57	211	8,82	1260	0,00
0,0315	0,00	0,188	0,00	1,13	0,00	6,72	0,07	40,1	0,71	240	8,94	1430	0,00
0,0358	0,00	0,214	0,00	1,28	0,00	7,64	0,07	45,6	0,86	272	8,56	1630	0,00
0,0407	0,00	0,243	0,00	1,45	0,00	8,68	0,07	51,8	1,03	310	7,72	1850	0,00
0,0463	0,00	0,276	0,00	1,65	0,00	9,86	0,07	58,9	1,24	352	6,51	2100	0,00
0,0526	0,00	0,314	0,00	1,88	0,00	11,2	0,07	66,9	1,52	400	5,11	2390	0,00