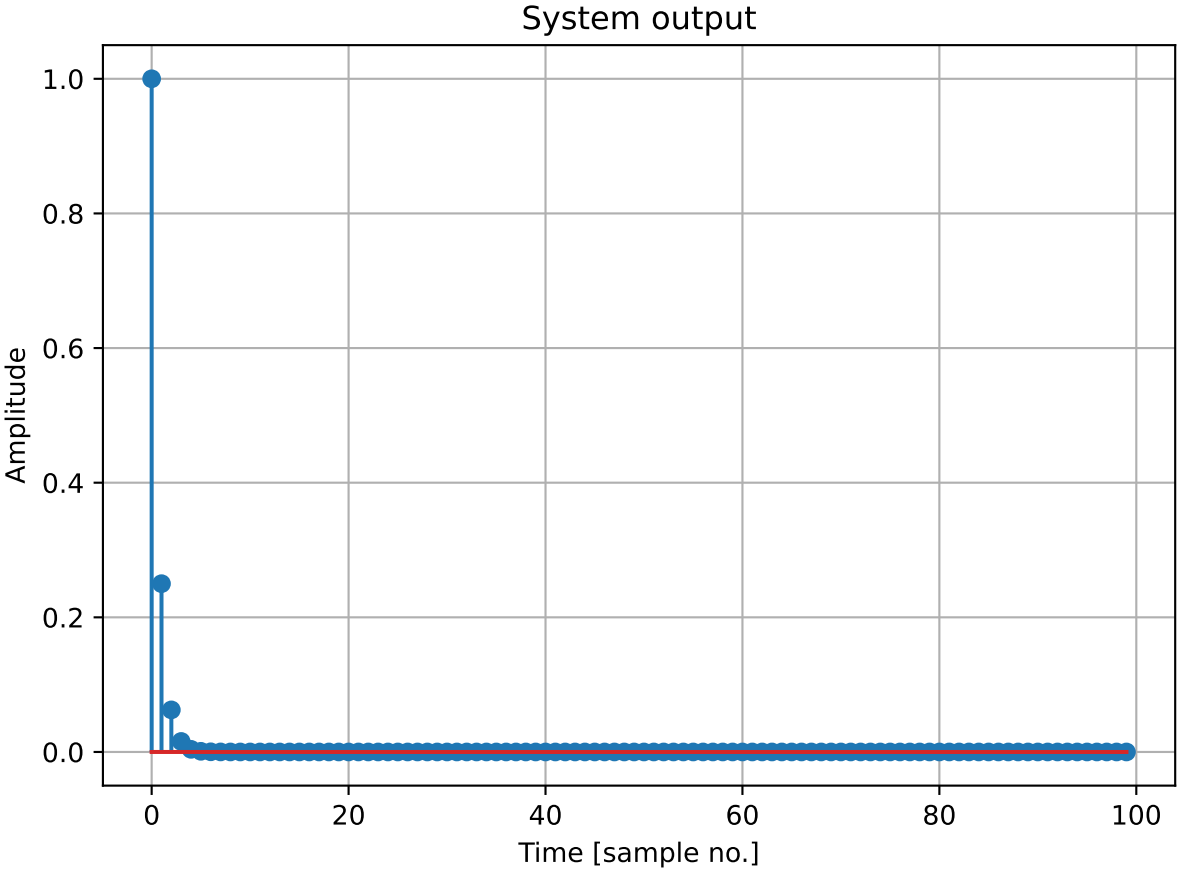
System output
Amplitude
Time [sample no.]
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100